

Vedligeholdelse

- Hold måleren ren og tør.
- Sæt beskyttelseshætten på efter brug.

Udskiftning af batterier

- Udskift de 4 batterier (LR44), når batteriindikatoren begynder at blinke.
- Skru hætten af fra toppen af måleren.
- Fjern forsigtigt batteriholderen fra måleren.
- Udskift de 4 batterier (LR44), sæt batteriholderen tilbage og skru hætten tilbage på toppen af måleren.

Udskiftning af elektroder

- Hvis elektroderne er beskadigede, kan du nemt udskifte dem.
- Skru den nederste blå ring af.
- Træk forsigtigt den nederste del (elektrodedelen) af måleren.
- Udskift den nye elektrodel korrekt, så den forbinder og skru den blå ring tilbage på måleren.
- Kalibrer måleren.

Garanti

- Du har 1 års producentgaranti.
- Skader på grund af forkert brug (batterilækage, vandskade) er ikke dækket.
- Opbevar altid dit købsbevis – uden købsbevis bortfalder garantien!
- De medfølgende batterier har en levetid på 1 år. Skulle de være tomme på købstidspunktet, skal du selv udskifte dem.



SUPER KOI
HAVEDAMCENTER
KOLDEKILDEVEJ 15
4000 ROSKILDE
INFO@SUPERKOI.DK
TLF.: 46756595

SUPERKOI.DK

Brugervejledning



DigiTest
4-in-1




Måleren giver en nøjagtig og hurtig digital måling af dit vand i havedammen

Du får 4 resultater i én måling:

- Ledningsevnen (EC) fra 0-9999 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 2\%$
- Total opløste faste stoffer (TDS) fra 0-9999 ppm $\pm 2\%$
- Surhedsgrad (pH) fra 0,00-14,00 med en nøjagtighed på 0,05 enheder
- Temperatur i Celsius ($^{\circ}\text{C}$) og Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)
- Måleren har en automatisk 3-punkts pH kalibreringsfunktion (4,00 - 9,18 - 6,86).
- Kalibreringsposer (3 stk) er vedlagt
- Måleren har en automatisk funktion for temperatur kompensation
- Måleren slukker automatisk efter 5 min

Sådan bruger du den digitale måler

- Fjern beskyttelseshætten før brug.
- Tryk på tænd/sluk-knappen.
- Dyp spidsen af måleren i vandet op til "markeringen". Måleren er IKKE vandtæt, dyp aldrig måleren længere ned i vandet end nedsænkingslinjen.
- Vent ca. 30 sekunder, indtil målingen viser numrene på displayet
- Tryk på HOLD/TEMP for at gemme/logge testresultaterne.

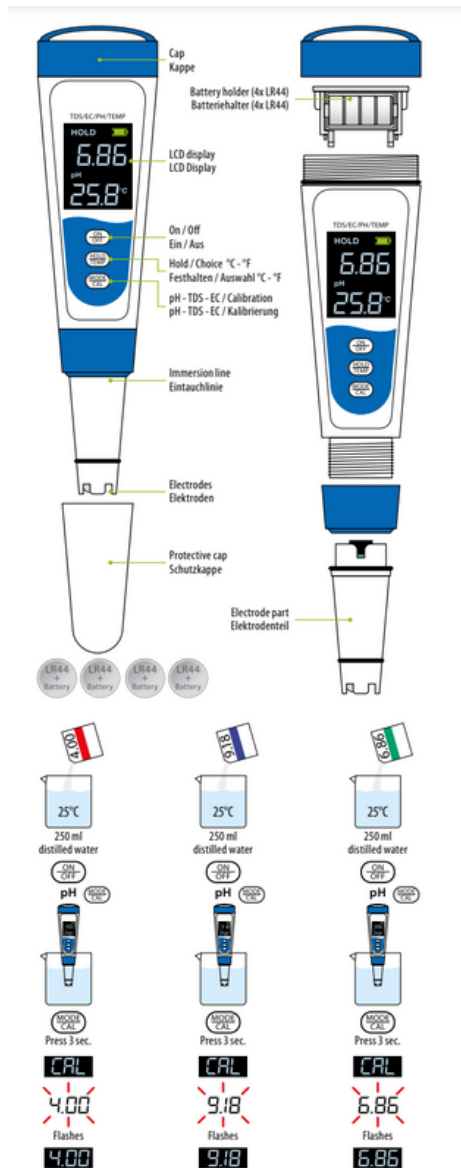

Sådan kalibrerer du måleren

3-punkts pH-kalibrering 4,00, 9,18 og 6,86

- Opløs de vedlagte pulverposer i hver sin kop med 250 ml destilleret vand, som er 25°C . (pH 4,00, pH 9,18 og pH 6,86).
- Tænd for apparatet og tryk på MODE/CAL, så pH-værdien vises.
- Dyp måleren i vandet med pH 4,00-opløsningen og vent til omkring 30 sek.
- Tryk og hold MODE/CAL nede i 3 sek.
- CAL vises kort på displayet.
- 4.00 blinker på displayet flere gange.
- Når 4.00 holder op med at blinke, er dette trin blevet udført korrekt.
- Skyl elektroden med destilleret vand og dup den tør.
- Gentag trinene ovenfor i pH 9,18 opløsningen og derefter i 6,86.
- Måleren er nu pH-kalibreret
- Skyl elektroden med destilleret vand, tør med en serviet og sæt beskyttelseshætten på igen.

Du skal gen-kalibrere måleren:

- Hvis du ikke har brugt den i længere tid
- Hvis du ved et uheld trykkede på MODE/CAL i 3 sek. mens måleren ikke er i (den korrekte) kalibreringsvæske. I dette tilfælde vil ERR blinke på displayet
- Hvis du har nulstillet måleren ved at trykke på HOLD/TEMP og MODE/CAL knapper samtidigt i 3 sek.
- Hvis du har udskiftet elektroderne.