

Coronavirus Antibody Test


Instructions for Use
+ Návod k použití + Gebrauchsanweisung + Brugsanvisning
+ Instrucciones de uso + Mode d'emploi + Istruzioni per l'uso
+ Gebruiksaanwijzing + Bruskanvisning
+ Användaransvarningar

Manufacturer:
cerascreen GmbH
Güterbahnhofstrasse 16
19059 Schwerin
Germany


cerascreen®

SKU: 99090758
CRS3-CoronaAB_INT_004
Valid from October 2022

Supplier | Lieferant | Leverandør | Proveedor | Fournisseur | Fornitore | Leverancier | Leverandør | Leverantör:
B: PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 8952 Heidenheim, Germany C: Achtstrom-Munkjøy Germany GmbH, Niederschlesia 1, 09471 Bärenstein, Germany D: Bechtendorf Dickinson GmbH, Tullastrasse 8-12, Postfach 101629, 6900 Heidelberg, Germany

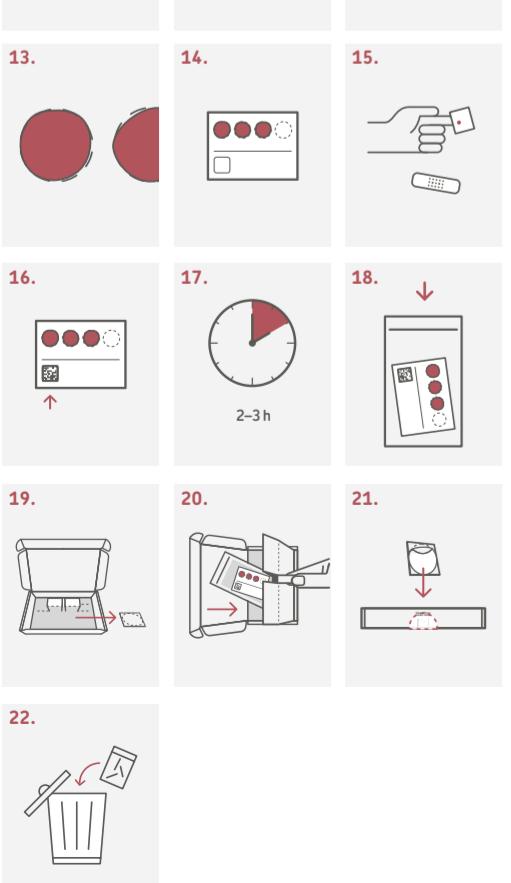

Your test kit contains

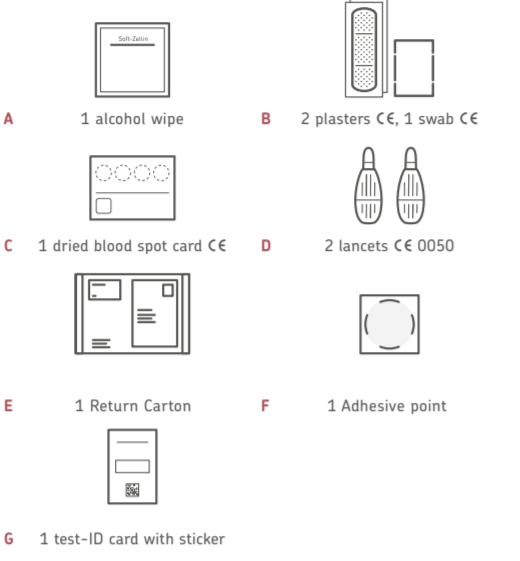

Information and tips

Read the instructions for use carefully before you begin and follow the listed steps.

IMPORTANT

- The sample should only be taken between Sunday and Tuesday (at the latest) and sent off on the same day. Please take into account any public holidays.
- Please enter your test ID to activate the test before sending us your sample. Our laboratory needs this in order to identify your sample and send you the test result. You will find more detailed information in step 2.
- Perform the test no earlier than 14 to 21 days after vaccination or coronavirus infection.

GENERAL INFORMATION

- Read the instructions for use carefully before you begin and follow the listed steps.
- Do not take a blood sample immediately after strenuous physical activity.
- The product is for single use only.
- Do not touch the dried blood spot card within the markings and keep it dry free.
- The test kit should be stored between 2 °C and 30 °C.

CONTAGIOUS ILLNESSES

Do not use this kit if you suffer from a blood-borne contagious illness such as hepatitis or HIV.

RISKS AND SIDE EFFECTS

- After taking a sample of your blood, pressure sores may occur around the wound for a few days and/or a bruise may form at the injection site. Additionally, the puncture site may be visible for a few days.
- Note: Any serious incident related to the product should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user is established.

WARNINGS

- Store this kit out of reach of children.
- The kit may only be used by adults aged 18 and older.
- If you are pregnant or are breastfeeding, use the kit only after consultation with your medical professional or pharmacist.
- If you suffer from a congenital or acquired blood-clotting disorder or are taking anticoagulant medication, use the kit only after consultation with your medical professional.
- Use the lancets only as described in the instructions for use.
- If you have problems with the sight of blood or blood sampling, take the sample only in the presence of another person or contact your medical professional or pharmacist.

If you have any questions, please visit our help website: help.cerascreen.com

Directions for Use

- Check that all conditions are fulfilled for sample taking. Please read the section "Information and tips" carefully.
- If you are a new customer, create your user account on my.cerascreen.com or in the my cerascreen® App. In our "Frequently Asked Questions" in help.cerascreen.com you will find a guide for that. To create your result report, log in via the my cerascreen® App (Android, iOS) or on my.cerascreen.com. Insert your six-digit ID-number according to your test-ID card under "Activate Test" and follow the instructions.
- Place all contents of the test kit on a clean surface. Before you begin, choose a spot for the prick. **TIP:** the middle or ring finger of the left hand usually work best.
- Wash your hands with soap and warm water. Hold your preferred hand under warm water for at least 15 seconds to stimulate blood circulation. Dry your hand carefully with a clean towel.
- Swing your preferred arm around in a circle 5 to 10 times, fully extended if possible, in large movements to stimulate blood circulation.
- Remove the alcohol wipe from its film and use it to disinfect the tip of the preferred finger. Wait until the finger is dry again (15 sec).

- Take the lancet. (1) Rotate the protective cover once around its axis. (2) Carefully remove the protective cover. **CAUTION:** Do not use a lancet with a loose or missing protective cover.
- Place your hand on a firm surface. Place the lancet diagonally on the tip of your finger as shown in the illustration. Only use the side of finger tip pad as the puncture site to minimize discomfort. Press the lancet firmly against the finger until it releases. **CAUTION:** The lancet can only be released once!
- Press the thumb of your other hand below the sampling spot and pull back on the skin slightly.
- Encourage blood flow by standing up and holding your hand below the heart. Gently massage your finger from the palm of your hand to your fingertip until a drop of blood forms.
- Before you start collecting the blood, take the swab (**NOT the alcohol wipe!**) and wipe off the first drop of blood. Wait until a big drop has formed again.
- Let a large blood drop fall onto the marked circle on the dried blood spot card. In case the drop doesn't fall on its own from your finger, hold the dried blood spot card carefully against the drop without touching the paper to your finger.

- For the best evaluation of the sample, the largest possible drop of blood is required. The blood drop should cover the circle inside the marking completely.
- Repeat this process until you have completed three circles. If you fill up more than three circles, your sample will be evaluated, as well.
- After taking the blood, use the swab and plaster to clean and cover the wound.
- Remove the square code sticker from the test-ID card and stick it on the dried blood spot card in the area intended for the test-ID sticker.
- Allow the dried blood spot card to dry for 2 to 3 hours at room temperature. Ensure to place it flat on a dry surface, protected from direct sunlight.
- Wait until the blood has dried completely. Place the dried blood card back into the plastic bag so that the Test ID is visible (see picture).
- Open the included return mailer box and set the clear plastic sticker aside.
- Pull on one of the three safety latches in the center to lift the inlay tray. Place the dried blood card in the bottom of the box and replace the inlay tray over it.
- Close the box and seal it using the clear plastic sticker included. The spot for the sticker is denoted with: "affix here." For return shipping with UPS, please go to: <https://www.cerascreen.com/return>
- Please check if the test has been activated and dispose of the used parts of the test kit in the transparent plastic bag in the household waste.

CS Test na Prolilátky proti Koronavírusu

- Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® se skladuje zestavy po odběru krve tím, že se postavíte a budeste držet rukou pod srdcem. Jen si promasírujte prst po dlaní ruky až ke špičce prstu, dokud se nevýtvorí kapka krve. 11. Před začátkem odběru krve vám se změní tep na ruce, až do té doby, než se znovu vytvoří velká kapka krve. Počkejte, než se znovu vytvoří velká kapka krve. 12. Nechte krve sámovolně odkapnout do vyznačeného kroužku na kartě pro odběr suché krevní kapky. Pokud kapke nedokápnou z prstu samovolně, přiložte kartu pro odběr suché krevní kapky opatrně k ruce. Dbejte přitom na to, abyste se prstem nedotkli papíru.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-2019). Vzorek je analyzován v našem specializovaném partnerském diagnostickém laboratoři cerascreen®.

Test na Prolilátky proti Koronavírusu cerascreen® slouží k prokázání infekce SARS-CoV-2 – nejdříve k výskytu protitoku proti SARS-CoV-2. Nechte si výsledek svého krvního výskytu proti tektonu nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19 (Coronavirus-Disease-

y como muestra la ilustración. Utilice solo un lado de la yema del dedo para realizar la punción de modo que dure la menos. Presione la lanceta con firmeza contra el dedo hasta que realice la punción. **PRECAUCIÓN:** Solo podrá punzar con la lanceta una única vez!

9. Haga presión con el dedo pulgar de su otra mano debajo del punto de muestra y retire un poco la piel.

10. Facilite la extracción de sangre poniéndole de pie y poniendo la mano debajo del corazón. Masaje suavemente el dedo desde la palma a la mano hasta la punta, hasta que se forme una gota de sangre.

11. Antes de comenzar a recoger la sangre, coja el frotis y límpie la primera gota de sangre. Espere hasta que se vuelva a formar una gota grande.

12. Deje que caiga una gota grande de sangre dentro del círculo marcado en la tarjeta para muestras de sangre. Si esta no cae de su dedo por sí sola, aplique cuidadosamente el punto de sangre seca de la tarjeta contra la gota sin tocar el papel con el dedo.

13. Para que la evaluación de la muestra sea óptima, se requiere una muestra de sangre lo más grande posible. La gota de sangre debería cubrir el círculo marcado completamente.

14. Repita este proceso hasta que ha llenado los tres círculos. Si llena más del nivel necesario, su prueba será también analizada.

15. Después de tomar la sangre, utilice el frotis y el parche para tratar la herida.

16. Retire el adhesivo cuadrado con el código de la tarjeta ID de la prueba y péguelo sobre la tarjeta de muestras de sangre en la zona prevista para ello.

17. Deje que las tarjetas de manchas de sangre secas se sequen durante 2 o 3 horas a temperatura ambiente. Asegúrese de colocarla en plano sobre una superficie seca, protegida de la luz solar directa.

18. Espere a que la sangre se seque por completo. Luego, coloque la muestra de sangre seca en la bolsa de plástico para que la identificación de la prueba sea visible desde el exterior (ver la imagen).

19. Abra la caja de devolución adjunta y deje a un lado el punto adhesivo que contiene.

20. Inserte las tres pestanas de retención centrales (pestillos) en la caja de devolución, tire de la pestana central y abra la parte inferior central. Coloque la muestra de sangre seca en el fondo intermedio y vuelva a cerrarla.

21. Cierre la caja de cartón y péguela con el punto adhesivo proporcionado. El espacio para el punto adhesivo está marcado con la escritura "pegar aquí". Para envío de devolución con UPS, vaya a: <https://www.cerascreen.com/return>

22. Por favor, verifique que la prueba se ha activado y elimine todos los componentes individuales en una bolsa transparente en los residuos domésticos.

FR Test des Anticorps Coronavirus

Le test sérologique des Anticorps Coronavirus de cerascreen® a pour but de détecter une infection SARS-CoV-2 déjà terminée, et n'est pas approprié pour le dépistage d'une infection aiguë. En cas d'une nouvelle déterioration de votre état général de santé, comme par exemple une fièvre élevée, des problèmes respiratoires ou une forte toux, adressez-vous à votre PLATTEPHONE ou par e-mail au service compétent de votre région - souvent, le service de santé - ou à votre médecin généraliste. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000. Dans le cas d'une urgence (détresse respiratoire), contactez directement le service des urgences.

Votre coffret de test contient

A 1 tampon imbibé d'alcool, B 2 sparadraps €, 1 écouillon €, C 1 carte portant une tache de sang séché €, D 2 lancettes € 0050, E 1 carton de retour, F 1 point adhésif, G carte d'identification du test avec autocollant

Informations et instructions

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de commencer, puis suivre les étapes indiquées.

IMPORTANT

+ Avant d'envoyer votre prélevement, activez votre test en saisissant votre code d'identification de test. Ce n'est qu'ainsi que le laboratoire peut assigner votre prélevement et que vous pourrez obtenir les résultats de votre test. Vous en saurez plus dans l'étape 2.
+ Les échantillons doivent être prélevés exclusivement entre le dimanche et le mardi (au plus tard) et envoyés le jour même. Veuillez tenir compte des jours fériés.
+ Veuillez faire le test après 14-21 jours suivant la vaccination ou une infection de coronavirus.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

+ Ne pas prélever d'échantillon sanguin immédiatement après avoir effectué une activité physique intense.
+ Si vous avez des difficultés à prélever l'échantillon sanguin ou si le coffret est incomplet, veuillez contacter notre service client, qui traitera ce sujet de manière confidentielle. (help.cerascreen.com)
+ Produit à usage unique

+ Veuillez ne pas toucher la carte portant la tache de sang séché à l'intérieur des marques, et la conserver à l'abri de la poussière.
+ Il n'est malheureusement pas possible d'analyser les échantillons sanguins qui contiennent une quantité insuffisante de sang.

MALADIES CONTAGIEUSES

+ Ne pas utiliser ce coffret si vous présentez une maladie contagieuse transmissible par le sang, par exemple une hépatite ou une infection par le VIH.

RISQUES ET EFFETS SECONDAIRES

+ La prise de sang peut favoriser l'apparition d'escarres autour de la blessure pendant quelques jours et/ou des hématomes dans le site d'injection. En outre, la piqûre peut être visible pendant quelques jours.

IT Test Sierologico Coronavirus

Il test sierologico Coronavirus cerascreen® è stato realizzato per verificare una infezione da SARS-CoV-2 verificatasi in passato e non può essere utilizzato per verificare l'infezione attuale. Se le vostre condizioni generali peggiorano, o se avete febbre alta, difficoltà a respirare o una tessa forte, CHIAMATE e inviate un'e-mail all'autorità responsabile - che spesso è l'autorità sanitaria locale - nella vostra zona o chiamate il vostro medico. In caso di emergenza (difficoltà respiratoria) contattate subito il 112 o il 113.

Il kit per il test contiene

A 1 batuffolo imbevuto di alcool, B 2 cerotti €, 1 tampone €, C 1 cartina per sangue secco €, D 2 lancette € 0050, E 1 scatola di ritorno, F 1 chiusura adesiva, G 1 scheda con ID del test munita di adesivo

Informazioni e note

Leggere le Istruzioni per l'uso attentamente prima di iniziare e seguire i passaggi indicati.

Instructions d'utilisation

1. Vérifier si les conditions requises sont satisfaites pour effectuer le test. Veuillez lire avec attention le chapitre « Informations et instructions ».
2. Si vous êtes un nouveau client, veuillez créer un compte sur my.cerascreen.com ou sur l'application [my.cerascreen](https://my.cerascreen.com). Consultez notre rubrique FAQ sur help.cerascreen.com pour plus d'informations. Pour créer votre compte rendu de résultat, connectez-vous par l'application [my.cerascreen](https://my.cerascreen.com) (Android, iOS) ou sur le site my.cerascreen.com. Indiquez votre numéro d'identification à six chiffres figurant sur votre carte d'identification du test sous la mention « activer le test » et suivez les instructions.
3. Placer les différents éléments du coffret de test sur une surface propre. Avant de commencer, choisissez l'endroit du prélevement. CONSEIL : le majeur et l'annulaire de la main gauche sont généralement les doigts qui fonctionnent le mieux.
4. Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon. Placez votre main que vous avez choisie dans l'eau chaude pendant au moins 15 secondes pour stimuler la circulation sanguine. Séchez soigneusement votre main avec un linge propre.
5. Faites tourner le bras que vous avez choisi de façon circulaire cinq à dix fois en faisant de larges mouvements et en le maintenant tendu si possible, afin de stimuler la circulation sanguine.
6. Retirez le tampon d'alcool de son film, et utilisez-le pour désinfecter l'extrémité du doigt que vous avez choisi. Attendez jusqu'à ce que le doigt soit de nouveau sec (15 secondes).
7. Prenez la lancette. (1) Tournez le capuchon protecteur une fois autour de son axe. (2) Retirez le capuchon protecteur avec soin. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser une lancette dont le capuchon protecteur est mal fixé ou manquant.
8. Placez votre main sur une surface solide. Placez la lancette diagonalement sur l'extrémité de votre doigt, comme le montre l'illustration. Pour moins d'inconfort, utilisez uniquement le côté du doigt comme site de prélevement. Appuyez fermement la lancette contre le doigt jusqu'à ce qu'elle soit libérée. AVERTISSEMENT : La lancette ne peut être libérée qu'une seule fois !
9. Appuyez le pouce de l'autre main sous l'endroit du prélevement et tirez légèrement la peau.

10. Vous pouvez faciliter le prélevement de sang en vous tenant votre main au-dessous du cœur. Massez doucement votre doigt, en allant de la paume de votre main vers le bout de votre doigt, jusqu'à ce qu'une goutte de sang se forme.

11. Avant de commencer à prélever la sang, prenez l'écouillon et essuyez la première goutte de sang. Attendez qu'une autre grosse goutte se forme.

12. Laissez tomber une grosse goutte de sang dans le cercle marqué se trouvant sur la carte portant la tache de sang séché. Si la goutte ne tombe pas d'elle-même du doigt, amenez la carte portant la tache de sang séché avec soin au contact de la goutte, sans toucher le papier avec votre doigt.

13. Pour la meilleure évaluation de l'échantillon, la goutte de sang doit être la plus importante possible. La goutte de sang doit recouvrir complètement le cercle à l'intérieur de la marquise.

14. Répétez l'opération jusqu'à ce que trois champs circulaires soient remplis. Le test sera analysé même au cas vous dépasser la quantité de prélevement prévu.

15. Après avoir prélevé le sang, utilisez l'écouillon et le pansement pour traiter la plaie.

16. Retirez l'autocollant Carré portant le code de la carte d'identification du test et collez-le sur la carte portant la tache de sang séché à l'endroit prévu pour l'autocollant d'identification du test.

17. Laissez tomber les cartes de taches de sang séchées sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Veillez à les placer à plat sur une surface sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil.

18. Attendez que le sang se soit complètement séché. Posez par la suite l'échantillon de sang séché dans l'enveloppe en plastique de manière que l'ID du test soit visible des dehors.

19. Ouvrez la boîte de réexpédition et mettez côte à côte les deux cartes de taches de sang séchées. Si la goutte de sang n'a pas été libérée, placez la carte portant la tache de sang séché avec soin au contact de la goutte, sans toucher le papier avec votre doigt.

20. Pour la meilleure évaluation de l'échantillon, la goutte de sang doit être la plus importante possible. La goutte de sang doit recouvrir complètement le cercle à l'intérieur de la marquise.

21. Répétez l'opération jusqu'à ce que trois champs circulaires soient remplis. Le test sera analysé même au cas vous dépasser la quantité de prélevement prévu.

22. Après avoir prélevé le sang, utilisez l'écouillon et le pansement pour traiter la plaie.

23. Retirez l'autocollant Carré portant le code de la carte d'identification du test et collez-le sur la carte portant la tache de sang séché à l'endroit prévu pour l'autocollant d'identification du test.

24. Laissez tomber les cartes de taches de sang séchées sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Veillez à les placer à plat sur une surface sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil.

25. Attendez que le sang se soit complètement séché. Posez par la suite l'échantillon de sang séché dans l'enveloppe en plastique de manière que l'ID du test soit visible des dehors.

26. Ouvrez la boîte de réexpédition et mettez côte à côte les deux cartes de taches de sang séchées. Si la goutte de sang n'a pas été libérée, placez la carte portant la tache de sang séché avec soin au contact de la goutte, sans toucher le papier avec votre doigt.

27. Pour la meilleure évaluation de l'échantillon, la goutte de sang doit être la plus importante possible. La goutte de sang doit recouvrir complètement le cercle à l'intérieur de la marquise.

28. Répétez l'opération jusqu'à ce que trois champs circulaires soient remplis. Le test sera analysé même au cas vous dépasser la quantité de prélevement prévu.

29. Après avoir prélevé le sang, utilisez l'écouillon et le pansement pour traiter la plaie.

30. Retirez l'autocollant Carré portant le code de la carte d'identification du test et collez-le sur la carte portant la tache de sang séché à l'endroit prévu pour l'autocollant d'identification du test.

31. Laissez tomber les cartes de taches de sang séchées sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Veillez à les placer à plat sur une surface sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil.

32. Attendez que le sang se soit complètement séché. Posez par la suite l'échantillon de sang séché dans l'enveloppe en plastique de manière que l'ID du test soit visible des dehors.

33. Ouvrez la boîte de réexpédition et mettez côte à côte les deux cartes de taches de sang séchées. Si la goutte de sang n'a pas été libérée, placez la carte portant la tache de sang séché avec soin au contact de la goutte, sans toucher le papier avec votre doigt.

34. Pour la meilleure évaluation de l'échantillon, la goutte de sang doit être la plus importante possible. La goutte de sang doit recouvrir complètement le cercle à l'intérieur de la marquise.

35. Répétez l'opération jusqu'à ce que trois champs circulaires soient remplis. Le test sera analysé même au cas vous dépasser la quantité de prélevement prévu.

36. Après avoir prélevé le sang, utilisez l'écouillon et le pansement pour traiter la plaie.

37. Retirez l'autocollant Carré portant le code de la carte d'identification du test et collez-le sur la carte portant la tache de sang séché à l'endroit prévu pour l'autocollant d'identification du test.

38. Laissez tomber les cartes de taches de sang séchées sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Veillez à les placer à plat sur une surface sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil.

39. Attendez que le sang se soit complètement séché. Posez par la suite l'échantillon de sang séché dans l'enveloppe en plastique de manière que l'ID du test soit visible des dehors.

40. Ouvrez la boîte de réexpédition et mettez côte à côte les deux cartes de taches de sang séchées. Si la goutte de sang n'a pas été libérée, placez la carte portant la tache de sang séché avec soin au contact de la goutte, sans toucher le papier avec votre doigt.

41. Pour la meilleure évaluation de l'échantillon, la goutte de sang doit être la plus importante possible. La goutte de sang doit recouvrir complètement le cercle à l'intérieur de la marquise.

42. Répétez l'opération jusqu'à ce que trois champs circulaires soient remplis. Le test sera analysé même au cas vous dépasser la quantité de prélevement prévu.

43. Après avoir prélevé le sang, utilisez l'écouillon et le pansement pour traiter la plaie.

44. Retirez l'autocollant Carré portant le code de la carte d'identification du test et collez-le sur la carte portant la tache de sang séché à l'endroit prévu pour l'autocollant d'identification du test.

45. Laissez tomber les cartes de taches de sang séchées sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Veillez à les placer à plat sur une surface sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil.

46. Attendez que le sang se soit complètement séché. Posez par la suite l'échantillon de sang séché dans l'enveloppe en plastique de manière que l'ID du test soit visible des dehors.

47. Ouvrez la boîte de réexpédition et mettez côte à côte les deux cartes de taches de sang séchées. Si la goutte de sang n'a pas été libérée, placez la carte portant la tache de sang séché avec soin au contact de la goutte, sans toucher le papier avec votre doigt.

48. Pour la meilleure évaluation de l'échantillon, la goutte de sang doit être la plus importante possible. La goutte de sang doit recouvrir complètement le cercle à l'intérieur de la marquise.

49. Répétez l'opération jusqu'à ce que trois champs circulaires soient remplis. Le test sera analysé même au cas vous dépasser la quantité de prélevement prévu.

50. Après avoir prélevé le sang, utilisez l'écouillon et le pansement pour traiter la plaie.

51. Retirez l'autocollant Carré portant le code de la carte d'identification du test et collez-le sur la carte portant la tache de sang séché à l'endroit prévu pour l'autocollant d'identification du test.

52. Laissez tomber les cartes de taches de sang séchées sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Veillez à les placer à plat sur une surface sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil.

53. Attendez que le sang se soit complètement séché. Posez par la suite l'échantillon de sang séché dans l'enveloppe en plastique de manière que l'ID du test soit visible des dehors.

54. Ouvrez la boîte de réexpédition et mettez côte à côte les deux cartes de taches de sang séchées. Si la goutte de sang n'a pas été libérée, placez la carte portant la tache de sang séché avec soin au contact de la goutte, sans toucher le papier avec votre doigt.

55. Pour la meilleure évaluation de l'échantillon, la goutte de sang doit être la plus importante possible. La goutte de sang doit recouvrir complètement le cerc