



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0668

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report




TTTS-FH22000936



第1页 共4页

Page 1 of 4

客户提供信息及要求 Information Provided by Client	委托单位/地址 Applicant	温州康盾医疗科技有限公司 Wenzhou Kangdun Medical Technology Co.,Ltd 浙江省温州市龙港市新城高科路87-159号 (浙江东达实业有限公司厂房内9#车间) No.87-159, Xincheng Gaoke Road, Longgang City, Wenzhou, Zhejiang, China (No.9 Workshop In Zhejiang Dongda Industrial Co., Ltd.)			送样人: Contact	/
	生产单位/地址 Manufacturer	温州康盾医疗科技有限公司 Wenzhou Kangdun Medical Technology Co.,Ltd 浙江省温州市龙港市新城高科路87-159号 (浙江东达实业有限公司厂房内9#车间) No.87-159, Xincheng Gaoke Road, Longgang City, Wenzhou, Zhejiang, China (No.9 Workshop In Zhejiang Dongda Industrial Co., Ltd.)				
	样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name	KN95防护口罩 (小号) (非医用) KN95 Protective Mask (small size) (non-medical)	商标: Trademark	/	
		样品总数: Sample Count	60个 60Piece(s)	号型规格: Size or Specification	KD-S02	颜色: Colour
		质量等级: Quality Grade	/	安全类别: Safety Category	/	
		产品款号或货号: Style No. or Order No.	/			
	判定标准: Test Standards	GB 2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 Respiratory protection-Non-powered air-purifying particle respirator				
	样品描述 Test Part Description	1# 黑色口罩 Black Mask 2# 宝蓝色口罩 Royal Blue Mask				
	检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品接收日期 Date of Submission	2022-04-16	报告发出日期 Date of Checking	2022-04-22
	检验日期 Test Date	2022-04-16		到 To	2022-04-22	
	执行标准 Test Standards	见附页 See next page(s)				
	检验结论 Conclusion	检验结果及符合性见附页。 Test results and compliance refer to next page(s). 检验单位盖章 Stamp of Inspection Unit				(6)
	备注 Remarks	/				

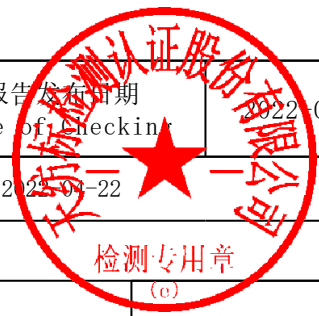

批准:
Approver

方倩

审核:
Checker

苏丽

编制:
Editor

刘亚娟



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0668

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

第2页 共4页

Page 2 of 4

TTTS-FH22000936

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	执行标准/备注 Test Method/ Remarks
1# 黑色口罩 Black Mask						
呼吸阻力 Respiratory Resistance (KN95)	呼气阻力 Expiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 150 2: 129 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 143 2: 140	符合 Pass	GB 2626-2019
	吸气阻力 Inspiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 156 2: 138 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 152 2: 147		
过滤效率 Filtration Efficiency (KN95)	氯化钠颗粒物 NaCl Particle	%	≥95.0	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 99.61 2: 99.64 3: 99.67 4: 99.83 5: 99.73 6: 99.63 7: 99.87 8: 99.64 9: 99.69 10: 99.78 11: 99.67 12: 99.85 13: 99.85 14: 99.84 15: 99.86 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 99.48 2: 99.30 3: 99.32 4: 99.45 5: 99.36	符合 Pass	GB 2626-2019
2# 宝蓝色口罩 Royal Blue Mask						





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

第3页 共4页

Page 3 of 4

TTTS-FH22000936

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	执行标准/备注 Test Method/ Remarks
过滤效率 Filtration Efficiency (KN95)	氯化钠颗粒物 NaCl Particle	%	≥95.0	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 99.65 2: 99.54 3: 99.75 4: 99.55 5: 99.79 6: 99.88 7: 99.82 8: 99.61 9: 99.83 10: 99.68 11: 99.69 12: 99.63 13: 99.66 14: 99.64 15: 99.72 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 99.40 2: 99.40 3: 99.31 4: 99.39 5: 99.51	符合 Pass	GB 2626-2019





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

第4页 共4页

Page 4 of 4

TTTS-FH22000936

样 品 Sample

