

SEATA ROLLATOR



Ergonomic Rollator
Ergonomischer Rollator



Instructions for use Gebrauchsanweisung

English: Instructions for use 3

Deutsch: Gebrauchsanweisung..... 21

Contents

1	Introduction	5
2	Safety instructions	5
2.1	Safety instructions for use	5
2.2	Safety instructions – prevent tipping	6
2.3	Transportation in motor vehicles	7
3	General information	7
3.1	Signs and symbols.....	7
3.2	Intended purpose	7
3.3	Indications for use	7
3.4	Contraindications	8
3.5	Service life	8
3.6	Responsibility.....	8
3.7	Declaration of conformity	8
4	Product description	9
4.1	Scope of supply.....	9
4.2	Labelling.....	9
4.3	Overview.....	10
5	Adjustments.....	10
5.1	Adjusting the push handles	11
5.2	Adjusting the backrest.....	11
5.3	Adjusting the brakes.....	12
6	Handling.....	12
6.1	Unfolding the rollator	12
6.2	Folding the rollator	13
6.3	Attaching the rollator bag.....	13
6.4	Using the running brakes.....	14
6.5	Using the locking brakes.....	14
6.6	Sitting on the rollator	14
6.7	Walking with the rollator.....	15
6.8	Getting over curbs and obstacles	15

7	Maintenance and service.....	15
7.1	Check prior to each use	15
7.2	Monthly checks.....	16
7.3	Replacing parts	16
7.4	Spare parts and accessories.....	16
7.5	Cleaning and disinfecting.....	16
7.6	Storing the rollator	16
7.7	Disposal	16
7.8	Re-using the rollator.....	17
8	Warranty / Legal Claims.....	17
9	Technical specifications	18
10	Specialist repairs and servicing	19

1 Introduction

We would like to thank you for the trust you have placed in us in purchasing this rollator. By opting for the **Seata Rollator by Strongback Mobility** with its revolutionary STRONGBACK system, you have chosen a top-quality, ergonomic rollator that has been specially designed to ensure your standing and sitting position are both comfortable and ergonomically designed.

A rollator is a medical device and a technical aid, so it is essential that you know how to use it correctly, as improper use may be dangerous. Please read these instructions carefully before using the rollator for the first time. They contain important safety information and valuable tips on using and looking after your rollator.

2 Safety instructions

- Ensure that any defects are immediately checked and repaired by a qualified technician.
- Do not make any modifications to the rollator yourself. Contact your dealer to arrange for any such modifications to be made. Any improper changes or modifications to the rollator may result in the rollator not functioning properly and increase the risk of accident.
- Only use original parts and accessories approved by *Strongback Mobility*.
- All moveable parts should be serviced periodically in order to ensure that the rollator is working properly and can be used safely.
- Exposure to water or high levels of humidity may result in the rollator becoming rusty. Do not use the rollator in the shower or swimming pool and store it away from potentially damp spaces such as the bathroom. If the rollator encounters water, ensure it is dried as quickly as possible.
- Please note that padded or upholstered areas may become hot if exposed to direct sunlight and may cause injuries to the skin if touched. Therefore, it is important to ensure that these parts are kept covered or that the rollator is kept out of direct sunlight.
- This product has not been tested in accordance with ISO 8191-1 und 8191-2 and is therefore not deemed to be fire resistant. It is vital to ensure that any padded, upholstered or attached parts are not exposed to sources of fire such as cigarettes, cigarette lighters or other open flames.
- In case of any serious incident that has occurred in relation to the device please report it to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which you are established.

2.1 Safety instructions for use

- If you are unsure about your rollator operation or any of the instructions given in this user manual, please arrange for a specialist to show you how to use the rollator before using it for the first time. Please contact the dealer where you purchased the rollator.

- Practice using your new rollator on a flat, manageable surface to avoid potential falls and dangerous situations. It is recommended to have someone with you while you are practicing.
- Before you start using your rollator, please make sure that all attached parts have been properly secured.
- Please ensure that you comply with the **maximum load capacity of 260 lbs. / 118 kg**. In doing so, it is important to take additional weight into account, such as bags or rucksacks.
- Ensure the rollator is completely unfolded before use.
- Ensure that the height adjustment handles are locked tight.
- Never use the rollator while under the influence of alcohol or other substances that may affect your concentration or physical and mental abilities.
- When the rollator is stationary, the locking brakes **MUST** be locked.
- Be careful not to hurt your fingers while folding and unfolding the rollator.
- Keep hands and fingers away from all moving parts. Be aware that parts of the body or clothing can be entangled by moving parts if not careful.
- Wear sturdy footwear to avoid falling and injuries.
- Never use the rollator on an escalator or on stairs.
- Do not use the rollator as a transport device for heavy items or individuals.
- Use caution while on slanting or steep terrain.
- Do not use the rollator on slippery surfaces. Be aware that the brakes won't be as effective under wet circumstances as they would be under dry ones.
- Use the running brakes to slow down the rollator and use the locking brake before sitting on the rollator.
- Do not climb on the rollator.
- Do not leave the rollator unattended while not in use; ensure that it is stationary, and the parking brake is engaged after you use it to avoid rolling away.

2.2 Safety instructions – prevent tipping

- The dynamic stability of the rollator on slopes is dependent on the configuration of the rollator itself and the skills and handling style of the user. Therefore, it cannot be specified in advance.
- Avoid shifts in weight that could lead to the rollator tipping over, for example:
 - Attach a rucksack or bag (max. weight **11 lbs. / 5 kg**) only to the location indicated in this manual.
 - Do not hang bags etc. on the handles. This changes the center of gravity and increases the probability of tipping.
- Maintain an even weight distribution on the rollator. Avoid leaning excessively on one side or tilting the rollator too much sideways.
- If an object is beyond your reach while sitting in the rollator, please ask a companion for assistance, or use a tool to help you reach the object.
- Do not hesitate to ask for assistance or have a caregiver or companion nearby if you're concerned about stability.

- There is an increased risk of tipping over when walking on poor quality paths or roads (e.g., coarse gravel, potholes, etc.) or moving over drops (e.g., curbs, etc.).
- Use caution while loading on one handgrip or twisting the frame in the opposite direction, resulting in the castor lifting from the ground; this can trap the tire within a gutter or a drain.

2.3 Transportation in motor vehicles

The rollator should be transported in the folded and locked position (see section unfolding/folding). Be careful when loading the rollator into a vehicle, with attention to securing it. This rollator is not intended to be an alternative to a car seat.

3 General information

These instructions for use are designed to help you familiarize yourself with the use and handling of the rollator. They are an integral and necessary component of the rollator. Ensure that you always have these instructions on hand and make sure that you include them with the rollator when you transfer it to another owner.

Please read all the instructions carefully before using the rollator for the first time.

3.1 Signs and symbols



Caution!

It is important to follow all the instructions in the sections marked with this symbol to avoid potential injury to yourself or people in your vicinity.

3.2 Intended purpose

The **Seata Rollator by Strongback Mobility** is designed for patients with reduced mobility that require stable support and assistance while walking. It has been designed for both indoor and outdoor use.

The rollator has been designed to accommodate a **maximum load of 260 lbs. / 118 kg.** Liability can only be accepted if the product is used under the prescribed conditions and for its intended purposes.

3.3 Indications for use

Seata Rollator by Strongback Mobility is designed to provide support and assistance to those unable to or lack the confidence to walk without some level of support.

- Users with a height between 155 cm to 195 cm.
- Users who are restricted to short walking distances without assistance (approx. < 500 m).
- Users who need to rest more often while walking.
- Users with limb defect / deformity.
- Users with lower limbs (knee, ankle) contractures or damage.

- Users with illnesses that enable them to walk but require support with stability and balance.

3.4 Contraindications

The rollator is unsuitable for use in cases of:

- Users who are advised not to carry weight above 22 lbs. / 10 kgs (weight of the rollator).
- Users without walking abilities (cannot perform step overstep – walking).
- Users without cognitive ability of making use of a rollator.
- Upper limb amputee (without ability to grip the device).
- Users with impaired or insufficient vision.
- Individuals with limited hand/arm function (unable to operate the device as intended).

3.5 Service life

If used properly and if the safety, maintenance, and service instructions are followed correctly, the service life of the rollator is up to 5 years. If the rollator is maintained in an orderly state, it may be possible to continue using the rollator beyond this time.

3.6 Responsibility

As a manufacturer, we can only assume responsibility for the safety, reliability, and usability of the rollator in so far as any modifications, extensions, repairs, or servicing are carried out exclusively by persons who are authorized by us to do so and in so far as the rollator has been used in accordance with all instructions for use.

3.7 Declaration of conformity

As the manufacturer of the product, *Strongback Mobility AG* hereby declares that the **Seata Rollator by Strongback Mobility** fully conforms to the requirements of European Regulation (EU) 2017/745 and the US FDA requirements of 21 CFR.

4 Product description

The **Seata Rollator by Strongback Mobility** is an ergonomic folding rollator, it is pre-assembled and delivered in a cardboard box. After unpacking, if possible, keep the cardboard box and other packing materials, as they may be required for storing the rollator later.

Please check the contents of the package upon receipt to ensure that all parts have been included and are undamaged. Do not use the product if any of the parts are damaged. Inform your specialist retailer of any damage without delay.

4.1 Scope of supply

The contents of the *Strongback Mobility* box should include:


- 1 rollator, pre-assembled and folded
- 1 bag
- 1 set of instructions for use

If the rollator is delivered by parcel post or carrier, the contents should be checked for any damage suffered in transit immediately and in the presence of the delivery person(s). If there is any damage, please proceed as follows:

- Make a note of the damage
- Write a declaration of assignment; all claims arising because of the damage are assigned to the deliverer
- Send the record of damage, consignment note and declaration of assignment to the company where you purchased the rollator

4.2 Labelling

The product identification plate is located on the inside of the lower side frame tube. This plate includes the serial number (SN), model's name and other technical details. If you need to contact your dealer about repairs, replacement parts, warranty claims or damage to the rollator suffered in transit, please ensure that you have the following details on hand: the rollator's exact model name and number, month of manufacture, lot number and serial number.

 Strongback Mobility AG Firststrasse 3A CH-8835 Feusisberg +41 43 541 52 54	 Strongback Mobility Europe GmbH Erkrather Str. 401 DE-40231 Düsseldorf		 
Patents: sbm.care/patents Designed and developed in Switzerland Made in China	Imported to USA by: Strongback Mobility USA LLC US-Virginia Beach, VA		Weight Capacity: 260 lb/118 kg
Model No.: XXXX Model: XXXXXXXXX	 XXXX-XX  XXXX	 XXXX	S019/10.23

4.3 Overview



- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Hand grip | 7. Rear wheel |
| 2. Brake lever | 8. Tipping assist lever |
| 3. Push handle with adjustable height scale | 9. Backrest release hinge |
| 4. Height adjustment bracket | 10. Castor |
| 5. Seat | 11. Brake |
| 6. Bag | |

5 Adjustments

The adjustments described below should be carried out in consultation with your specialist medical device aid supplier. You may also be able to make these adjustments yourself if you have sufficient previous knowledge and have been given clear instructions from the supplier.




Caution!

Complete these adjustments before the user sits in the rollator in order to avoid potential injury.

5.1 Adjusting the push handles

The rollator has an additional clamp which prevents movement of the push handles. To adjust the push handles, open the clamp (1), press the height adjustment blue bracket button to release the push handles (2) and adjust the push handles to a suitable height, until you hear a locking sound, then close the clamp (3). Adjust both push handles to the same height by comparing the number scale on each side (4). It is recommended that the push handles are adjusted to the same height as your wrist when your arms are hanging alongside your body.

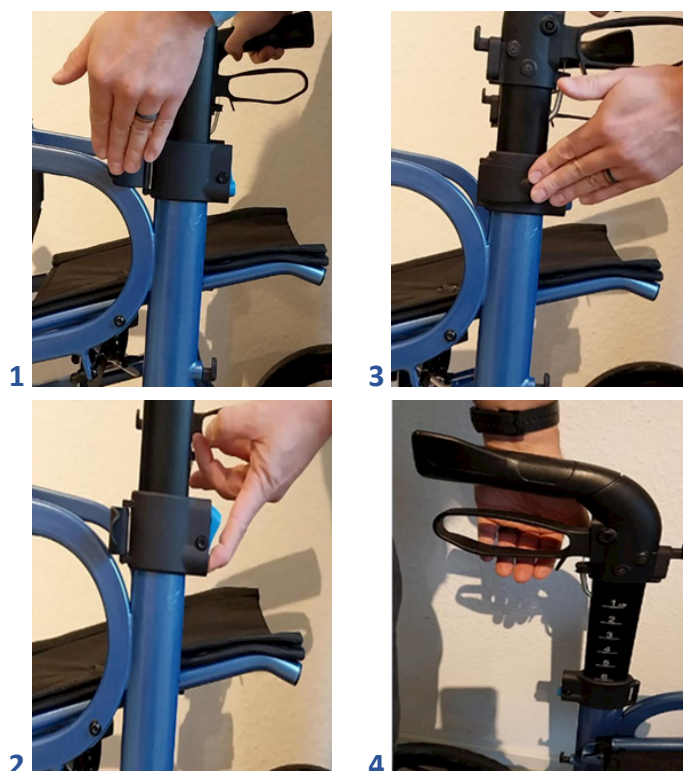

5.2 Adjusting the backrest

The backrest is set in a predefined position during manufacture and is likely to be suitable for most users. However, it can be individually adjusted by opening the Velcro fasteners and loosening or tightening them in accordance with the user's needs before closing them again. After each adjustment, it is important to ensure that the Velcro fasteners are firmly attached to each other so that they do not open accidentally.

Some possible adjustments are listed below.



- To adjust the support for the lower spine to a higher position, tighten the middle fasteners (2) and loosen the lower fasteners (3, 4)
- To adjust the support for the lower spine to a lower position, tighten the lower fasteners (3, 4) and loosen the middle fasteners (2)
- To increase the area of support for the lower spine, tighten both the middle fasteners (2) and the lower fasteners (3, 4)
- To decrease the size of the posture support for the lower spine, loosen both the middle fasteners (2) and the lower fasteners (3, 4)

- To alter the posture support for the upper back and so change the backrest angle, tighten the upper fasteners (1) to provide a higher level of support, or loosen them to provide a lower level of support

Tip: Before making any of these adjustments, half close the rollator in order to take the tension out of the backrest.

5.3 Adjusting the brakes.

The brakes are adjusted correctly during manufacture and should not require further adjustment. Over time of use, however, it may be required to re-adjust the brakes to ensure proper function. In any case, if you feel that the brakes are not tight enough, adjust them immediately as follows.

To adjust the brakes, pull the flexible star screw found next to the brake pad and wind with your fingers. Turn right to tighten the brakes and left to loosen the brake. This changes the distance between the brake pad and the tire. The distance is typically between 0.04 inch/1 mm and 0.08 inch/2 mm. The braking function works perfectly if the wheels stop entirely.



6 Handling

6.1 Unfolding the rollator

Unfold the frame of the rollator by pushing down evenly on the outer edges of the seat using both hands (1) until the seat is fully extended (2). Raise the upper half of the backrest by pulling both push handles backwards and upwards until the folding back releases hinge snaps into the locked position (3).



1



2



3



Caution!

Be careful while handling this to avoid potential injury due to finger trapping.

6.2 Folding the rollator

Fold the backrest down by using both hands (1) to press the black plastic levers on the folding back release hinges against the frame (2). Pull the seat strap upwards (3), the seat is unlocked and folded, and the two outer frames are pushed together (4).



Caution!


Do not hold the sides of the seat while pushing down. You could trap your fingers! Hands and fingers must remain on top of the seat while pushing down.



1



2

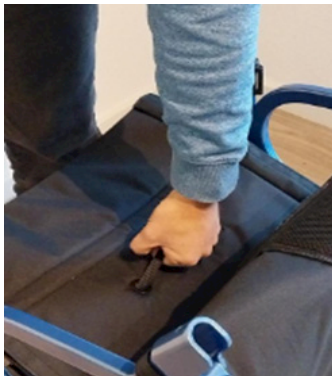

3



4

6.3 Attaching the rollator bag

The bag takes up to **11 lbs. / 5 kg** and can be used in two positions. Below the seat (1) and on top (2), on the small hook on the frame. While taking walks, attaching the bag on top is more convenient, attaching the bag below the seat is more convenient while seated.



1



2

6.4 Using the running brakes

The running brakes slows down the rollator and temporarily stop the rollator's movement. To use the running brakes, squeeze both brakes upwards, which applies pressure and prevents the rollator's movement, unsqueeze to release both brakes, and resume the rollator's motion.



6.5 Using the locking brakes

To use the locking brake, push both brake levers downwards to lock, the brakes are securely engaged. To unlock, pull the brake levers upwards. Do not push or use the rollator while the brakes are engaged.



Caution!

Check the proper operation of the brakes before each ride, especially before the first use. Brake failure or operating errors can result in serious injury to the user.

6.6 Sitting on the rollator

The rollator has a convenient seat that can be used while taking breaks during walks. The parking brakes must be engaged while using the seat. Push both brake levers downwards to lock and keep them engaged until you get up and want to start walking with the rollator again. Sit in an upright position with your back on the backrest.



6.7 Walking with the rollator

- To encourage the use of rollator in an ergonomic and comfortable manner, walk straight between the handles.
- Stand upright between the handles while using the rollators.



6.8 Getting over curbs and obstacles

When the need for curb climbing arises, place the foot on the tipping assist lever and push down with the foot while slowly pulling back on the handles (do NOT push down on handles).

7 Maintenance and service

As the user, you are likely to be the first to notice any damage to the rollator. Check the condition of your rollator regularly. If you discover a problem, consult an expert without delay. The rollator should be serviced by a specialist at least once a year.

Before using the rollator for the first time and after every service or adjustment it is essential to check the following:

- Handles, wheels, adjustment buttons, nuts, screws, bolts, seat, and accessories are properly tightened and in firm position.
- Check that the brakes are working properly.
- Are there any signs of damage or wear and tear?
- Are all the settings, correct?

7.1 Check prior to each use

We recommend that you check the following each time you use the rollator:

- Check that the brakes are working properly.
- Check that the wheels are functioning properly by testing whether the rollator travels in a straight line.
- Check that all removable parts are securely fixed in place, e.g. bag
- Check the rollator for visible signs of damage, e.g. damage to the frame, backrest, seat and backrest upholstery, wheels, etc.
- Check the seat and backrest for material defects, tears or loss of tension in the material.

7.2 Monthly checks

- Check that all moving parts, including the folding mechanism, move freely and quietly. Squeaking sounds suggest there may be damage and the rollator should be checked over by a specialist retailer.
- Check the proper operation of the brakes. If you suspect that the wheel lock or the running brakes are not working properly or need to be adjusted, take the rollator to the dealer where you bought your rollator.

7.3 Replacing parts

Please contact your specialist retailer to have parts replaced.

7.4 Spare parts and accessories

Your specialist retailer will have all the necessary information relating to replacement parts. You can also find out more about recommended and available accessories on our website.

7.5 Cleaning and disinfecting

Clean the rollator using a soft cloth and soapy water. The wheels can be cleaned using water and a brush with plastic bristles (do not use a wire brush!). Do not use any corrosive cleaning agents as they could harm material and cause damage. Ensure that the rollator is thoroughly dried after cleaning. Never use a hose, high-pressure cleaner, or similar devices to clean the rollator as the frame could become rusty. Approved sprays or disinfecting tissues can be used to disinfect the rollator.

7.6 Storing the rollator

- The rollator should be kept or stored in a dry, dust-free place at normal room temperature.
- Do not put heavy items on the rollator during storage.
- Store the rollator in an upright position, if stored outdoors, it must be under a cover to protect it.

7.7 Disposal

Please contact your specialist retailer if your rollator is no longer in use and requires disposal. If you wish to dispose of the rollator yourself, contact your local waste disposal operators in accordance with the local waste disposal regulations. Below is a description of the materials used in the rollator to assist with the process of disposal or recycling. There may be specific local regulations pertaining to disposal or recycling and these must be complied with when disposing of the rollator (this may include cleaning or decontaminating the rollator prior to disposal.)

- Steel: Axles, hinges, bolts and screws, studs, and pins
- Aluminum: Frame (chassis)
- Plastics: Handles, wheels
- Padding and upholstery: Polyester fabric with PVC coating and foam material

7.8 Re-using the rollator.

The **Seata Rollator by Strongback Mobility** is suitable for re-use by another user. The rollator should be thoroughly cleaned and disinfected in accordance with the care and hygiene instructions included here. All technical documents on how to use the rollator safely should be included when the rollator is passed on to the new user. The rollator should first be checked by an authorized dealer in accordance with the maintenance and inspection protocol (see the maintenance and inspection requirements in Chapter 8) and passed on to the new owner in perfect working order.

8 Warranty / Legal Claims

The frame of your **Seata Rollator by Strongback Mobility** is covered by Strongback Mobility's two-year manufacturer's warranty against material and manufacturing defects from the date of purchase. The seat and all other parts are warranted for 12 months from the date of purchase. If the legal warranty in your country is more extensive, then this applies.

To make a claim under the warranty, please contact your dealer.

Please keep the original packaging for later shipment for maintenance or repair.

For the US:

Jurisdiction: Any disputes, claims, or legal actions arising shall be subject to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located within the Commonwealth of Virginia.

9 Technical specifications

Model	<i>Seata Rollator by Strongback Mobility</i>
Seat width	19" / 48 cm
Effective seat depth (seat upholstery + distance to the back upholstery)	15" / 38 cm
Seat height at front edge	19" / 48 cm
Overall length	30" / 77 cm
Overall width	27" / 68 cm
Total height (depending on adjustable push handles height)	30"-39"/79-99 cm
Length when folded	30" / 77 cm
Width when folded	10" / 25 cm
Height when folded	31" / 80 cm
Width between push handles	17" / 44 cm
Total weight/without the bag	20 lbs. / 9.3 kg
Weight of the bag	1 lbs. / 0.4 kg
Front wheel (diameter)	9" / 23 cm
Rear wheel (diameter)	12" / 29 cm
Seat angle	12°
Backrest support height	19" / 48 cm
Backrest support angle	25°
Maximum safe working load bag	11 lbs. / 5 kg

All values are approximate.

10 Specialist repairs and servicing

We recommend that you have your **Seata Rollator by Strongback Mobility** inspected by your specialist retailer at least once a year. In the event of malfunctions or defects, the rollator should be returned to the dealer for immediate rectification / repair.

Upon request, you should provide the dealer with all the necessary information and documents for carrying out the repairs and maintenance.

Please use the following as a service record for your rollator:

Serial No.:	Date repairs / servicing carried out				
General					
The rollator opens and folds easily.					
The rollator travels in a straight line.					
Push handles set at all positions					
Brakes					
Parking brake functional					
Brakes does not touch the tire when not engaged					
The brakes are easy to apply.					
Running brakes can stop wheel rotation when fully engaged					
The brakes have no play in them.					
Alignment					
All four wheels are in contact with the ground.					
Rear wheels					
No significant lateral play when spinning freely.					
Check condition of braking pads					
Check condition of anti-friction bearings					
Check solid rubber tires for cracks / tears					
Front wheels					
Check condition of fork mounting					
Check condition of anti-friction bearings					
Check that the forks turn freely					
Check solid rubber tires for wears and tears/ cracks					
Seat and backrest upholstery					
The Backrest upholstery is undamaged.					
The Seat upholstery is undamaged.					

(C=checked RP=replaced, R=repaired)

Servicing carried out by:

Notes:

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	23
2	Sicherheitshinweise	23
2.1	Sicherheitshinweise zur Benutzung	23
2.2	Sicherheitshinweise bezüglich Kippgefahr	24
2.3	Transport in Motorfahrzeugen	25
3	Allgemeine Hinweise	25
3.1	Zeichen und Symbole	25
3.2	Verwendungszweck	25
3.3	Indikationen	25
3.4	Kontraindikationen	26
3.5	Nutzungsdauer	26
3.6	Verantwortlichkeiten	26
3.7	Konformitätserklärung	26
4	Produktebeschreibung	27
4.1	Lieferumfang	27
4.2	Kennzeichnung	27
4.3	Übersicht	28
5	Anpassungen	28
5.1	Anpassung der höhenverstellbaren Griffe	29
5.2	Anpassung der Rückenlehne	29
5.3	Einstellung der Bremse	30
6	Handhabung	30
6.1	Aufklappen des Rollators	30
6.2	Zusammenfalten des Rollators	31
6.3	Montieren der Tasche	32
6.4	Verwendung der Bremse	32
6.5	Verwendung der Feststellbremse	32
6.6	Sitzen im Rollator	33
6.7	Gehen mit Rollator	33
6.8	Überwinden von Bordsteinen und Hindernissen	33

7	Wartung und Service	34
7.1	Überprüfung vor jedem Fahrtantritt	34
7.2	Überprüfungen einmal im Monat.....	34
7.3	Austausch von Teilen.....	34
7.4	Ersatzteile und Zubehör.....	34
7.5	Reinigung und Desinfektion.....	34
7.6	Lagerung	35
7.7	Entsorgung.....	35
7.8	Wiedereinsatz des Rollators	35
8	Garantie / Rechtsansprüche	35
9	Technische Daten.....	36
10	Reparatur und Wartung durch Fachpersonal	37

1 Einleitung

Wir möchten uns bei Ihnen für das Vertrauen bedanken, das Sie in uns gesetzt haben, indem Sie diesen Rollator erworben haben. Indem Sie sich für den **Seata Rollator by Strongback Mobility** mit seinem revolutionären STRONGBACK-System entschieden haben, haben Sie einen Rollator von höchster Qualität und Ergonomie gewählt, der speziell darauf ausgelegt ist, sicherzustellen, dass Ihre Steh- und Sitzposition sowohl bequem als auch ergonomisch gestaltet sind.

Ein Rollator ist ein Medizinprodukt und ein technisches Hilfsmittel. Es ist erklärungsbedürftig und birgt bei unsachgemäßem Gebrauch Gefahren in sich. Bitte lesen Sie deshalb diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie Ihren neuen Rollator zum ersten Mal benutzen. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps für die richtige Benutzung und Pflege des Rollators.

2 Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Defekte immer sofort von einer fachkundigen Person reparieren.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Rollator vor. Kontaktieren Sie dafür Ihren Händler. Unsachgemäße Veränderungen am Rollator können zu Fehlfunktionen und einem erhöhten Unfallrisiko führen.
- Verwenden Sie nur von *Strongback Mobility* zugelassenes Zubehör und Originalteile.
- Alle beweglichen Teile müssen periodisch gewartet werden, um sicherzustellen, dass der Rollator einwandfrei und ohne Gefahr benutzt werden kann.
- Kontakt mit Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit kann zum Rosten des Rollators führen. Vermeiden Sie daher die Nutzung z.B. in der Dusche, im Schwimmbad als auch die Aufbewahrung z.B. im Badezimmer. Sollte der Rollator dennoch in Kontakt mit Wasser gelangen, trocknen Sie ihn so schnell wie möglich ab.
- Bitte beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung.
- Das Produkt wurde nicht nach ISO 8191-1 und 8191-2 getestet und gilt deswegen nicht als schwer entflammbar. Schützen Sie Polster und Anbauteile unbedingt vor Flammquellen wie Zigaretten, Feuerzeugen und offenen Flammen.
- Falls es zu einem schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt kommt, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der Behörde in dem Land, in dem Sie wohnhaft sind.

2.1 Sicherheitshinweise zur Benutzung

- Falls Sie unsicher bezüglich der Benutzung des Rollators oder Informationen in dieser Gebrauchsanleitung sind, lassen Sie sich bitte von einer Fachperson schulen. Bitte kontaktieren Sie hierzu die Verkaufsstelle, bei der Sie den Rollator gekauft haben.
- Um Stürze und gefährliche Situationen zu vermeiden, sollte der Umgang mit Ihrem neuen Rollator erst auf ebenem, überschaubarem Gelände geübt werden. Eine Begleitperson wird in diesem Fall empfohlen.

- Vor der Verwendung des Rollators kontrollieren Sie bitte, ob alle angebauten Teile ordentlich befestigt sind.
- Bitte beachten Sie die angegebene **maximale Nutzlast von 260 lbs. / 118 kg**. Rechnen Sie dabei zusätzliche Gewichte ein, wie z.B. Taschen oder Rucksäcke.
- Entfalten Sie den Rollator immer vollständig, bevor Sie ihn verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Höhenverstellgriffe gesichert sind.
- Benutzen Sie den Rollator niemals unter Einfluss von Alkohol oder anderen Mitteln, die die Aufmerksamkeit bzw. die körperliche und geistige Wahrnehmungsfähigkeit beeinflussen.
- Wenn der Rollator steht, ziehen Sie immer die Feststellbremse an.
- Seien Sie vorsichtig, sich beim Zusammenklappen und Auseinanderklappen des Rollators nicht die Finger zu verletzen.
- Halten Sie Hände und Finger möglichst von allen beweglichen Teilen fern. Körperteile oder Kleidung können durch bewegliche Teile verwickelt werden.
- Tragen Sie festes Schuhwerk, um Stürze zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Rollator nie auf einer Rolltreppe oder einer Treppe.
- Verwenden Sie den Rollator nie als Transportmittel für schwere Lasten oder Personen.
- Seien Sie vorsichtig auf schrägem oder steilem Gelände.
- Verwenden Sie den Rollator nicht auf rutschigen Oberflächen. Beachten Sie, dass die Bremsen unter feuchten Bedingungen nicht so effektiv bremsen wie unter trockenen.
- Verwenden Sie die Bremsen, um den Rollator abzubremsen, und ziehen Sie die Feststellbremse an, bevor Sie sich auf den Rollator setzen.
- Klettern Sie nicht auf den Rollator.
- Lassen Sie den Rollator nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn er nicht in Gebrauch ist. Stellen Sie sicher, dass wenn er steht, die Feststellbremsen eingerastet sind, um ein Wegrollen zu verhindern.

2.2 Sicherheitshinweise bezüglich Kippgefahr

- Die dynamische Stabilität an Gefällen hängt von der Konfiguration des Rollators, den Fertigkeiten und dem Fahrstil des Benutzers ab und kann deshalb nicht im Voraus angegeben werden.
- Vermeiden Sie Gewichtsverlagerungen, die zu einem Umkippen führen könnten, z.B.:
 - Befestigung eines Rucksacks oder einer Tasche (max. 11 lbs. / 5 kg) nur an den in dieser Anleitung angegebenen Stellen.
 - Hängen Sie keine Taschen oder ähnliches an die Schiebegriffe. Dies verändert den Schwerpunkt und erhöht die Kippwahrscheinlichkeit.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf dem Rollator. Vermeiden Sie übermäßiges Lehnen auf einer Seite oder ein zu starkes seitliches Kippen des Rollators.
- Sollte sich ein Gegenstand, den Sie erreichen möchten, außerhalb Ihrer Reichweite befinden, bitten Sie um Hilfe oder benutzen Sie andere Hilfsmittel, um den Gegenstand zu erreichen.
- Zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten oder fragen Sie einen Pfleger oder Begleiter in der Nähe zu bleiben, wenn Sie Bedenken bezüglich der Stabilität haben
- Beim Befahren von schlechten Wegen (z.B. grober Schotter, Schlaglöcher, etc.) oder Absätzen (z.B. Bordsteinkanten etc.) besteht erhöhte Kippgefahr.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Handgriff belasten oder den Rahmen in die entgegengesetzte Richtung verdrehen, was dazu führen kann, dass das Rad vom Boden abhebt; dies kann dazu führen, dass der Reifen in einer Rinne oder einem Abfluss stecken bleibt

2.3 Transport in Motorfahrzeugen

Der Rollator sollte im gefaltet und verriegelten Zustand transportiert werden (siehe Kapitel Aufklappen/Zusammenfalten). Seien Sie beim Verladen des Rollators in ein Fahrzeug vorsichtig und achten Sie darauf, ihn sicher zu befestigen. Dieser Rollator ist nicht als Alternative zu einem Autositz gedacht.

3 Allgemeine Hinweise

Die Ihnen vorliegende Gebrauchsanweisung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Rollators besser vertraut zu machen. Diese ist ein fester und notwendiger Bestandteil des Rollators. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Rollators mit.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung komplett durch, bevor Sie Ihre erste Fahrt unternehmen.

3.1 Zeichen und Symbole



Achtung!

Sie müssen die Anweisungen in den so markierten Abschnitten zwingend befolgen, um sowohl Verletzungen Ihrer eigenen Person als auch von Personen in Ihrer Umgebung zu vermeiden!

3.2 Verwendungszweck

Der **Seata Rollator by Strongback Mobility** ist vorgesehen zur Mobilitätssteigerung für Personen mit reduzierter Mobilität, welche Stabilitätsunterstützung während dem Gehen benötigen. Er ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert.

Der Rollator ist auf eine **maximale Belastung von 260 lbs / 118 kg** ausgelegt.

Eine Gewähr kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

3.3 Indikationen

Seata Rollator by Strongback Mobility wurde entwickelt, um Personen Unterstützung und Hilfe zu bieten, die nicht in der Lage sind oder denen es an Selbstvertrauen fehlt, ohne ein gewisses Maß an Unterstützung zu gehen.

- Personen mit einer Größe zwischen 155 cm und 195 cm.
- Personen, die nur kurze Strecken ohne Hilfe gehen können (ca. < 500 m)
- Personen, die sich beim Gehen häufiger ausruhen müssen.
- Personen, mit Gliedmaßendefekten/-deformitäten.
- Personen, mit Kontrakturen oder Schäden an den unteren Gliedmaßen (Knie, Knöchel).

- Personen, mit Krankheiten, die ihnen das Gehen ermöglichen, aber Unterstützung bei Stabilität und Gleichgewicht benötigen.

3.4 Kontraindikationen

Die Verwendung des Rollators ist ungeeignet für:

- Personen, denen empfohlen wird, kein Gewicht über 22 lbs. / 10 kg (Rollatorgewicht) zu tragen.
- Personen ohne Gehfähigkeit.
- Personen ohne kognitive Fähigkeit, einen Rollator zu benutzen.
- Personen mit Armaputationen (ohne Greiffähigkeit).
- Personen mit eingeschränktem oder unzureichendem Sehvermögen.
- Personen mit eingeschränkter Hand-/Armfunktion (können das Gerät nicht wie vorgesehen bedienen).

3.5 Nutzungsdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des Rollators beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis zu 5 Jahren. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Rollator, sofern er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, weiterverwendet werden.

3.6 Verantwortlichkeiten

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Rollators verantwortlich betrachten, wenn Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden und der Rollator unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wird.

3.7 Konformitätserklärung

Die *Strongback Mobility AG* erklärt als Hersteller des Produkts, dass der **Seata Rollator by Strongback Mobility** vollständig den Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745 entspricht den Amerikanischen FDA-Anforderungen des 21 CFR entspricht.

4 Produktebeschreibung

Der **Seata Rollator by Strongback Mobility** ist ein faltbarer ergonomischer Rollator. Er wird fertig montiert in einem Karton geliefert. Nach dem Entpacken bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit zur späteren Einlagerung auf.

Prüfen Sie den Lieferungsinhalt nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Im Falle von Beschädigungen benutzen Sie das Produkt noch nicht. Informieren Sie zunächst Ihren Fachhändler.

4.1 Lieferumfang

Zur Lieferung im eigenen *Strongback Mobility* Karton gehören:









- 1 Rollator, vormontiert und gefaltet
- 1 Tasche
- 1 Gebrauchsanweisung

Bei Paketversand oder Lieferung per Spedition ist die Ware im Beisein des Überbringers sofort auf Transportschäden zu kontrollieren. Sollte ein Schaden vorliegen, so ist folgendes zu beachten:

- Aufnahme des Tatbestandes
- Erstellung einer Abtretungserklärung; Alle Forderungen aus dem Schaden werden an den Überbringer abgetreten.
- Rücksendungen der Tatbestandsaufnahme, des Frachtbriefs sowie der Abtretungserklärung an die Firma bei der Sie den Rollator gekauft haben.

4.2 Kennzeichnung

Das Typenschild befindet sich auf der unteren Innenseite des Rahmens. Auf diesem sind die Seriennummer (SN), das Modell und andere technische Daten angegeben. Wenn Sie Ihren Händler bezüglich Reparatur, Ersatzteilen oder der Inanspruchnahme von Garantieleistungen oder Transportschäden kontaktieren, halten Sie bitte die exakte Modellbezeichnung und -nummer, den Herstellungsmonat und die Seriennummer des Rollators bereit.

 Strongback Mobility AG Firststrasse 3A CH-8835 Feusisberg +41 43 541 52 54	 Strongback Mobility Europe GmbH Erkrather Str. 401 DE-40231 Düsseldorf		 
Patents: sbm.care/patents Designed and developed in Switzerland Made in China	Imported to USA by: Strongback Mobility USA LLC US-Virginia Beach, VA		Weight Capacity: 260 lb/118 kg
Model No.: XXXX Model: XXXXXXXXX	 XXXX-XX  XXXX	 XXXX	S019/10.23

4.3 Übersicht



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Schiebegriff | 7. Hinterrad |
| 2. Bremsgriff | 8. Antikipphilfe |
| 3. Höhenverstellbarer Schiebegriff | 9. Faltgelenkt der Rückenlehne |
| 4. Höhenverstellmechanismus | 10. Vorderrad |
| 5. Sitz | 11. Bremse |
| 6. Tasche | |

5 Anpassungen

Folgende Anpassungen sollten durch eine fachkundige Person durchgeführt werden. Mit ausreichendem Fachwissen und genügend Einweisung von dieser können Sie auch von Ihnen selbst vorgenommen werden.




Achtung!

Um mögliche Unfälle zu vermeiden, dürfen diese Anpassungen nur durchgeführt werden, niemand auf dem Rollator sitzt.


5.1 Anpassung der höhenverstellbaren Griffe

Der Rollator ist mit einer zusätzlichen Klemme ausgestattet, der die Schiebegriffe sichert. Um die Schiebegriffe einzustellen, öffnen Sie die Klemme (1) und drücken den blauen Knopf des Höhenverstellmechanismus, um die Schiebegriffe freizugeben (2). Stellen Sie die Schiebegriffe auf die geeignete Höhe ein. Sobald Sie ein Einrastgeräusch hören, schließen Sie die Klemme (3). Stellen Sie beide Schiebegriffe auf dieselbe Höhe ein, indem Sie die Zahlenskala auf beiden Seiten (4) vergleichen. Es wird empfohlen, die Schiebegriffe auf die Höhe wie Ihr Handgelenk einzustellen, wenn Ihre Arme neben Ihrem Körper lose herunterhängen.

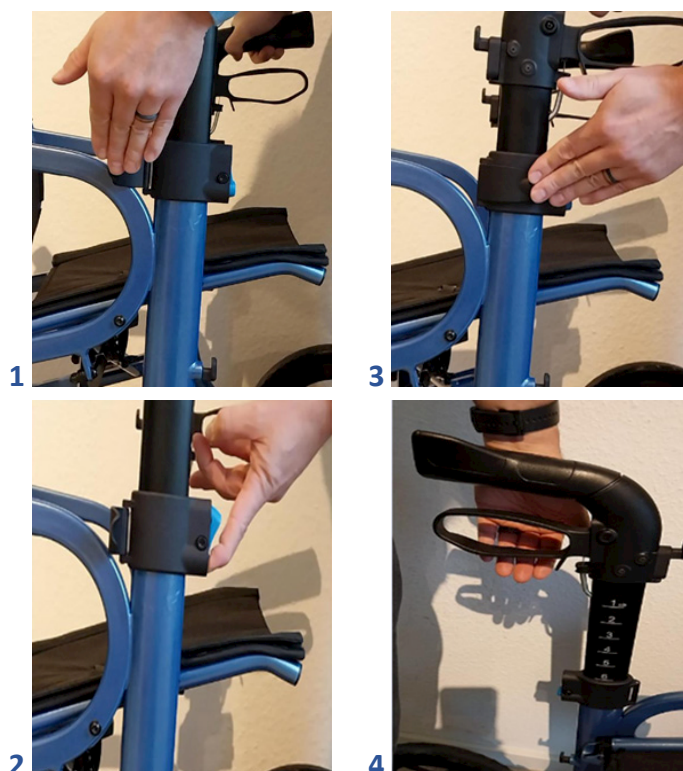

5.2 Anpassung der Rückenlehne

Die Rückenlehne wird in der Produktion voreingestellt und ist so für die meisten anwendenden Personen richtig eingestellt. Sie kann dennoch individuell angepasst werden, indem die Klettverschlüsse geöffnet und je nach Wunsch enger oder weiter wieder geschlossen werden. Nach jeder Anpassung muss sichergestellt werden, dass die Klettverschlüsse wieder gut aneinanderhaften, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

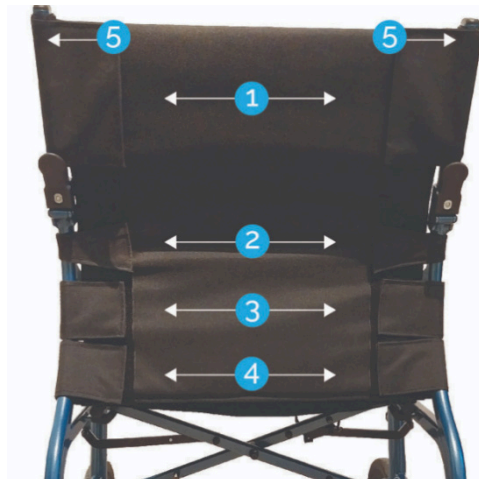

Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge, wie die Einstellungen verändert werden können.

- Um die Unterstützung der Lendenwirbelsäule höher zu stellen, die mittleren Verschlüsse (2) enger anziehen und die unteren Verschlüsse (3, 4) lockern
- Um die Unterstützung der Lendenwirbelsäule tiefer zu stellen, die unteren Verschlüsse (3, 4) enger anziehen und die mittleren Verschlüsse (2) lockern.
- Um die Unterstützung der Lendenwirbelsäule zu vergrößern, die mittleren Verschlüsse (2) und unteren Verschlüsse (3, 4) fester anziehen

- Um die Unterstützung der Lendenwirbelsäule zu verringern, die mittleren Verschlüsse (2) und unteren Verschlüsse (3, 4) lockern.
- Um die Unterstützung des oberen Rückens und damit auch den Rückenwinkel zu verändern, die oberen Verschlüsse (1) fester anziehen für eine größere Unterstützung oder lockern für eine schwächere Unterstützung.

Tipp: Für alle Anpassungen zunächst den Rollator halb schließen, um die Spannung aus der Rückenlehne zu nehmen.

5.3 Einstellung der Bremse

Die Bremsen sind ab Werk korrekt eingestellt und sollten zunächst keiner weiteren Einstellung bedürfen. Nach einiger Zeit der Nutzung kann es jedoch erforderlich sein, die Bremsen neu einzustellen, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Bremsen nicht fest genug sind, sollten Sie in jedem Fall die Bremsen wie folgt einstellen. Um die Bremsen einzustellen, ziehen Sie die flexible Sternschraube neben dem Bremsbelag zurück und drehen Sie diese mit den Fingern. Drehen Sie die Schraube nach rechts, um die Bremsen festzuziehen, und nach links, um die Bremse zu lösen. Dadurch wird der Abstand zwischen dem Bremsbelag und dem Reifen verändert. Der Abstand liegt normalerweise zwischen 0,04 Zoll/1 mm und 0,08 Zoll/2 mm. Die Bremsfunktion funktioniert perfekt, wenn die Räder vollständig zum Stillstand kommen.



6 Handhabung

6.1 Aufklappen des Rollators

Klappen Sie den Rahmen des Rollators auf, indem Sie mit beiden Händen gleichmäßig auf die Außenkanten des Sitzes drücken (1), bis der Sitz vollständig ausgefahren ist (2). Heben Sie die obere Hälfte der Rückenlehne an, indem Sie beide Schiebegriffe nach hinten und oben ziehen, bis das Scharnier der klappbaren Rückenlehne in der verriegelten Position einrastet (3)



Achtung!

Die Sitzfläche beim Herunterdrücken nicht seitlich umfassen. Klemmgefahr! Hände und Finger müssen sich beim Herunterdrücken vollständig oberhalb der Sitzfläche befinden.



1



2



3

6.2 Zusammenfallen des Rollators

Die Rückenlehne einklappen, indem mit beiden Händen (1) die schwarzen Kunststoffhebel an den Rückenfaltgelenken gegen den Rahmen gedrückt werden (2). Ziehen Sie das Band nach oben (3), der Sitz wird entriegelt und klappt zusammen, anschließend die beiden äußeren Rahmen zusammenschieben (4).



Achtung!


Seien Sie bei der Handhabung vorsichtig, um mögliche Verletzungen durch Einklemmen der Finger zu vermeiden.



1



2

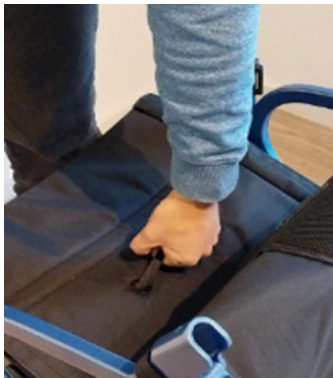

3



4

6.3 Montieren der Tasche

Die Tasche hat eine Traglast von bis zu **11 lbs. / 5 kg** und kann an zwei Positionen verwendet werden. Sie kann an den kleinen Haken am Rahmen unterhalb des Sitzes (1) oder oberhalb des Sitzes (2) befestigt werden. Beim Spaziergehen ist es bequemer, die Tasche oben zu befestigen, beim Sitzen ist es bequemer, die Tasche unter dem Sitz zu befestigen.



1



2

6.4 Verwendung der Bremse

Die Bremsen verlangsamen den Rollator und stoppen vorübergehend seine Bewegung. Um die Bremsen zu benutzen, ziehen Sie beide Bremsgriffe nach oben, wodurch Druck ausgeübt wird, und die Bewegung des Rollators verhindert wird. Lassen Sie beide Bremsen los, um die Fahrt des Rollators fortzuführen.



6.5 Verwendung der Feststellbremse

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie beide Bremsgriffe zum Feststellen nach unten; die Bremsen sind nun sicher eingerastet. Zum Entriegeln ziehen Sie die Feststellbremsen nach oben. Schieben oder benutzen Sie den Rollator nicht, wenn die Bremsen angezogen sind.



Achtung!

Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Bremsen vor jeder Fahrt, insbesondere vor der ersten Benutzung. Versagen der Bremse oder Bedienfehler können zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.

6.6 Sitzen im Rollator

Der Rollator verfügt über einen bequemen Sitz, der für Pausen bei Spaziergängen genutzt werden kann. Die Feststellbremsen müssen während der Benutzung des Sitzes angezogen sein. Drücken Sie beide Bremsgriffe nach unten, um sie zu arretieren, und lassen Sie sie so lange angezogen, bis Sie aufstehen und wieder mit dem Rollator laufen wollen. Setzen Sie sich in einer aufrechten Position mit dem Rücken auf die Rückenlehne.



6.7 Gehen mit Rollator

- Um die ergonomische und bequeme Benutzung des Rollators zu fördern, gehen Sie gerade zwischen den Schiebegriffen.
- Stehen Sie beim Benutzen des Rollators aufrecht zwischen den Griffen.



6.8 Überwinden von Bordsteinen und Hindernissen

Um ein Hindernis zu überwinden, mit dem Fuß auf der Ankipphilfe vorsichtig Gewicht bringen. Dabei den Rollator an den Handgriffen nach hinten ziehen (NICHT die Handgriffe nach unten drücken).

7 Wartung und Service

Als anwendende Person bemerken Sie mögliche Schäden als Erstes. Überprüfen Sie den Zustand Ihres Rollators regelmäßig. Sollten Sie ein Problem entdecken, lassen Sie es sofort von einer fachkundigen Person beheben.

Mindestens einmal pro Jahr sollte der Rollator von einer Fachperson gewartet werden.

- Griffe, Räder, Einstellknöpfe, Muttern, Schrauben, Bolzen, Sitz und Zubehörteile sind richtig angezogen und sitzen fest.
- Prüfen Sie, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.
- Gibt es Anzeichen für Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen?
- Sind alle Einstellungen korrekt?

7.1 Überprüfung vor jedem Fahrtantritt

Wir empfehlen, dass Sie vor jeder Benutzung die folgenden Punkte überprüfen:

- Überprüfen Sie, dass die Bremsen richtig funktionieren.
- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Räder, indem Sie testen, ob der Rollator geradeaus läuft.
- Überprüfen Sie, ob alle abnehmbaren Teile sicher befestigt sind, z.B. Tasche
- Überprüfen Sie den Rollator auf sichtbare Schäden, z.B. an Rahmen, Rückenlehne, Sitz- und Rückenbespannung, Rädern, usw.
- Überprüfen Sie den Sitz und die Rückenlehne auf Materialschäden, Risse oder Spannungsverlust im Stoff.

7.2 Überprüfungen einmal im Monat

- Alle beweglichen Teile inklusive des Faltmechanismus auf Leichtgängigkeit und geräuscharme Funktion prüfen. Quietschgeräusche deuten auf Beschädigungen hin und sollten vom Fachhändler überprüft werden.
- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Bremsen. Wenn Sie vermuten, dass die Bremse oder die Feststellbremse nicht ordnungsgemäß funktionieren oder eingestellt werden müssen, bringen Sie den Rollator zum Fachhändler.

7.3 Austausch von Teilen

Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um die Teile zu ersetzen.

7.4 Ersatzteile und Zubehör

Informationen zu Ersatzteilen für Ihren Rollator finden Sie im Fachhandel. Verfügbares und empfohlenes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

7.5 Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie den Rollator mit einem weichen Lappen und Seifenwasser. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (keine Drahtbürste verwenden!). Benutzen Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, da dies das Material angreifen

und beschädigen könnte. Trocknen Sie den Rollator unbedingt direkt nach der Reinigung. Benutzen Sie nie einen Schlauch, Hochdruckreiniger oder ähnliches zum Reinigen des Rollators, da der Rahmen rosten könnte. Zum Desinfizieren können geeignete und zugelassene Sprühmittel und Desinfektionstücher benutzt werden

7.6 Lagerung

- Der Rollator sollte an einem trockenen, staubfreien Ort bei normaler Raumtemperatur aufbewahrt oder gelagert werden.
- Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Rollator.
- Lagern Sie den Rollator in aufrechter Position. Wenn er im Freien gelagert wird, muss er durch eine Abdeckung geschützt werden.

7.7 Entsorgung

Wenn Ihr Rollator nicht mehr verwendet wird und entsorgt, werden soll, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wenn Sie die Entsorgung selbst übernehmen möchten, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach den Entsorgungsvorschriften Ihres Wohnorts. Im Folgenden werden die Materialien beschrieben, die für den Rollator verwendet wurden im Hinblick auf Entsorgung oder Recycling. Besondere Vorschriften bezüglich der Entsorgung oder dem Recycling können vor Ort gelten und diese müssen bei der Veranlassung der Entsorgung berücksichtigt werden. (Dazu gehören etwa die Reinigung oder Dekontaminierung des Rollators vor der Entsorgung.)

- Stahl: Achsen, Gelenke, Schrauben, Nieten und Stifte
- Aluminium: Rahmen (Fahrgestell)
- Kunststoff: Handgriffe, Rohrstopfen, Räder
- Polsterung: Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung und Schaumstoff

7.8 Wiedereinsatz des Rollators

Der **Seata Rollator by Strongback Mobility** ist für den Wiedereinsatz geeignet. Der Rollator ist zunächst gemäß den beiliegenden Pflege- und Hygienehinweisen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Bei der Weitergabe des Rollators müssen sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen der neuen anwendenden Person übergeben werden. Der Rollator muss gemäß Wartungsprotokoll (siehe Wartungsliste im Kapitel 10) von einer autorisierten Fachperson überprüft und einwandfrei übergeben werden.

8 Garantie / Rechtsansprüche

Für den Rahmen Ihres **Seata Rollator by Strongback Mobility** gewährt *Strongback Mobility* eine zweijährige Herstellergewährleistung gegen Material- und Fabrikationsfehler ab dem Kaufdatum. Auf den Sitz und alle anderen Teile wird eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gewährt. Sollte die gesetzliche Gewährleistung in Ihrem Land umfangreicher geregelt sein, dann gelten diese.

Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Originalverpackung für späteres Versenden zwecks Wartung oder Reparatur aufbewahren.

USA:

Gerichtsstand: Alle Streitigkeiten, Ansprüche oder rechtlichen Maßnahmen, die sich ergeben, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der staatlichen und bundesstaatlichen Gerichte im Commonwealth von Virginia.

9 Technische Daten

Model	Seata Rollator by Strongback Mobility
Sitzbreite	19" / 48 cm
Effektive Sitztiefe (Polster + Distanz zur Rückenlehne)	15" / 38 cm
Sitzhöhe (vordere Kante)	19" / 48 cm
Gesamtlänge	30" / 77 cm
Gesamtbreite	27" / 68 cm
Gesamthöhe (abhängig von den höhenverstellbaren Griffen)	30"-39"/79-99 cm
Länge (gefaltet)	30" / 77 cm
Breite (gefaltet)	10" / 25 cm
Höhe (gefaltet)	31" / 80 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	17" / 44 cm
Gesamtgewicht (ohne Tasche)	20 lbs. / 9,3 kg
Gewicht der Tasche	1 lbs. / 0,4 kg
Vorderrad Durchmesser	9" / 23 cm
Hinterrad Durchmesser	12" / 29 cm
Sitzwinkel	12°
Höhe Rückenlehne	19" / 48 cm
Winkel Rückenlehne	25°
Max. Traglast Tasche	11 lbs. / 5 kg

Alle Angaben sind ungefähre Werte.

10 Reparatur und Wartung durch Fachpersonal

Es wird empfohlen, den **Seata Rollator by Strongback Mobility** mindestens einmal im Jahr einer Inspektion durch den Fachhändler zu unterziehen. Bei Störungen oder Defekten am Rollator ist dieser unverzüglich dem Fachhändler zur Instandsetzung zu übergeben. Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

Bitte folgende Wartungsliste verwenden, um den Wartungsstatus des Rollators im Überblick zu behalten.

Seriennummer:	Durchgeführte Wartungen				
Allgemein					
Der Rollator lässt sich leicht öffnen und zusammenklappen.					
Der Rollator bewegt sich in einer geraden Linie.					
Schiebegriffe in allen Positionen einstellbar					
Bremsen					
Feststellbremse funktionsfähig					
Die Bremsen berühren den Reifen nicht, wenn sie nicht angezogen sind.					
Die Bremsen sind leicht zu betätigen.					
Bremsen können die Raddrehung stoppen, wenn sie vollständig angezogen sind					
Die Bremsen haben kein Spiel.					
Ausrichtung					
Alle vier Räder sind in Kontakt mit dem Boden.					
Hinterräder					
Kein nennenswertes seitliches Spiel bei freier Drehung.					
Zustand der Bremsklötze prüfen					
Zustand der Lager prüfen					
Vollgummireifen auf Risse überprüfen					
Vorderräder					
Zustand der Gabelbefestigung prüfen					
Zustand der Lager prüfen					
Prüfen, ob sich die Gabeln frei drehen lassen					
Vollgummireifen auf Risse überprüfen					
Sitz- und Rückpolster					
Der Bezug der Rückenlehne ist unbeschädigt.					
Der Bezug der Sitzfläche ist unbeschädigt.					

(G=geprüft, E=ersetzt, R=repariert)

Wartungen wurden durchgeführt von:

Notizen:



Retailer/Fachhändler:

International

Strongback Mobility AG
Firststrasse 3a
8835 Feusisberg / Switzerland
+41 43 5415254
info@strongbackmobility.com
int.strongbackmobility.com

Europe

Strongback Mobility Europe GmbH
Erkrather Straße 401
40231 Düsseldorf / Germany
+49 211-97633839
info@strongbackmobility.com
int.strongbackmobility.de

United States of America

Strongback Mobility USA
1317 Conrad Lane
Virginia Beach, VA 23454 / USA
+ 1 (757)349-7790
usa@strongbackmobility.com
www.strongbackmobility.com