



Motion Renew™



---

# Owner's Manual

Actual product appearance and functionality may vary from photographs, illustrations and descriptions included in this manual.



# table of contents

Safety Precautions and Usage Statements .....	1-4
Parts List .....	5
Base Overview / Quick Reference Guide .....	6-7
Installation Guide .....	8-9
Remote Control .....	10-12
Syncing Two Bases .....	13
Connecting Straps .....	14
Emergency Battery Backup Strap .....	15
Headboard Brackets .....	16
Troubleshooting .....	17
Español .....	18-24
Français .....	25-32

# safety precautions and usage statements

## Attention: Important Safety Disclaimers

Read all instructions before using your adjustable base. Save these instructions.

### WARNING

Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source.

#### SAFETY:

##### TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY:

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (strongly recommended). Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces. Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, it is not working properly, or it has been exposed to water. Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets. Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

### WARNING

- Keep bed in a flat position when not in use.
- Stay clear of moving parts while in motion.
- Before adjusting, make sure children and pets are clear of moving parts and are not under bed base.
- Do not allow children to operate bed base without adult supervision

#### SAFETY FEATURES:

Manual operation – If something gets caught in the platform when flattened, you can manually raise the platform up by lifting at both the head and foot to relieve pressure and allow for release.

Child-lockout – This remote control is programmed with a child-lock safety feature. Information on activation and deactivation of this feature can be found on the Remote Control page(s).

Emergency stop – Stop the motion of the platform by pressing any button on the remote control.

Power outage – Use the “Emergency Battery Backup Strap” as a temporary power source to get the base to a desired position. Instructions on how to operate the Battery Backup Strap are on the Emergency Battery Backup page(s).

#### CHILDREN AND PETS:

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on or under the bed. Children should not operate the bed base without adult supervision.

# safety precautions and usage statements

## WARNING

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a grounded wall outlet or surge protector (strongly recommended). Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified Electrician to install a suitable outlet.

### **PACEMAKERS:**

Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with devices such as pacemakers, ICD's and any other device sensitive to magnetic fields. It is **STRONGLY** recommended that owners of such medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium MAGNETS. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any product that creates a vibrating movement and may affect the pacemaker. Please consult your physician before using the massage feature.

### **IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS:**

Ergomotion adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

### **ADDITIONAL SAFETY FEATURES**

Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

### **ACOUSTICS**

### **LIFTING/LOWERING MECHANISMS**

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This

is normal. During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This contact may result in metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position. In normal base operation, the wheels which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

### **MATERIALS**

Ergomotion adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create an audible sound.

### **MESSAGE OPERATION AND LOCATION ENVIRONMENT**

The massage feature will emit a tone during operation. This is normal. As the massage intensity level is increased, the tone will intensify. The volume of this tone is directly related to the location environment. For example, when demonstrated in a show room, the surrounding environmental noise will cover some of the massage noise. However, when installed in a home setting with wooden floors, carpeted or not, the massage volume will be more noticeable. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base. It is possible to experience vibration or noise from the exterior bed frame, headboard brackets, headboards or footboards if mounting bolts are not firmly tightened.

Levels 1-3 of massage intensity represent the revolutions of the motor per minute. Level 3 provides the maximum number of RPMs. However, this does not mean that the feeling of vibration is the strongest. Depending on the mattress material, thickness, and positioning of the user, the feeling of vibrations will differ. We encourage the user to find the massage intensity setting that suits them best. It is important to understand the physics of vibrations. Just as an engine may run rough during idle, as the RPMs increase, the vibrations change concurrently.


# safety precautions and usage statements

## TOLERANCE

All Ergomotion adjustable foundations, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure bases will operate within these standards during normal operating use. Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 120kg distributed load. The angle (designated “ $\alpha$ ” in figure 1) between the back section and the flat section for various configurations of the mattress support platform shall be  $\pm 3^\circ$ , which translates to a tolerance of up to  $1\frac{1}{2}^\circ$ .

The angle (designated “ $\beta$ ” in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress support platform shall be  $\pm 3^\circ$ , which translates to a tolerance of up to  $\frac{3}{4}^\circ$ .

Any adjustable foundation deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer’s quality control standards.

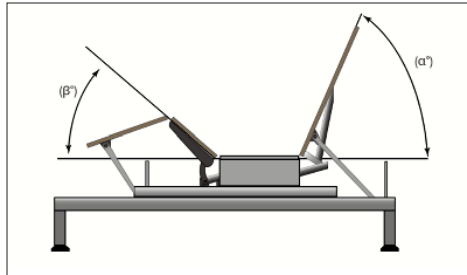

## THAT “NEW PRODUCT” SMELL:

Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this can come from our material manufacturing process. This smell is normal and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the environment.

## BREAK IN PERIOD:

You can speed up the break-in period by simply spending time in the adjustable bed through activities such as reading, watching TV or playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature changes. Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components

are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

## PAIRED OPERATION:

When operating a “paired” split base setup there may be a time latency up to 1.5 seconds between each bases articulation.

## WEAR AND TEAR:

Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.

## FABRIC CARE:

To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30cm (12 inches) away from direct heat sources. For a deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

## PRODUCT RATINGS:

The lift motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty. The massage motors are not designed to operate continuously for more than 30 minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for 30 minutes after automatic massage shut off before restarting.

## WEIGHT LIMITS:

This product is not rated to support weights exceeding 750 pounds. This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support

# safety precautions and usage statements

or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

## IMPORTANT DO'S AND DON'TS

### DO:

- Plug your adjustable base into a power surge protector.
- Evenly distribute weight when sleeping in a split setup. Uneven distribution of weight can cause the base to raise unevenly.
- Call Customer Service for any technical issues. Do not try to force the base down, this can damage the motors or frame.
- Use mild soap and water to clean your adjustable base if staining occurs.
- Keep in mind that adjustable bases are recommended to be used with adjustable friendly mattresses
- Lower to the flat (horizontal) position after use and in between presets.
- Register your warranty as soon as your adjustable base has been delivered.

### DON'T

- Sit on corners/edges of base, this may warp the frame, struts or foam.
- Tilt the base on its side. This can damage the legs and/or leg screws.
- Stand or jump on the adjustable base at any time, this can damage the frame and motors.
- Drag the base to move it. Dragging the base could damage the frame, strip the nut/bolts or break the legs. Purchase castors if you plan on moving your base routinely.
- Enter and exit the adjustable base with the head and/or foot in the articulated position. Enter or exit your adjustable in the flat (horizontal) position.
- Tinker with or modify base. This will void the warranty.
- Press down on the head or foot while actuated can damage frame and motors.

### FCC Compliance:

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

# parts list

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for.








**All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.**

- A) Wireless Remote Control and (3) AAA Batteries
- B) Legs (6)
- C) Mattress Retainer Bar (2)\*
- D) Power Cord
- E) Power Supply
- F) Power Down Strap (9 volt alkaline batteries not included)
- G) Sync Cord ‡
- H) Connecting Strap †\*


**Misc. Parts (not included):**  
 Surge Protector  
 9 Volt Alkaline Batteries

\* These items are attached to the base for shipping purposes. Carefully remove from base and set aside.

‡ Only included in Twin Long and Cal King Split bases.

A) 	B) 	C)* 
D) 	E) 	F) 
G)‡ 	H)†* 	
<b>MISC (NOT INCLUDED)</b>		
		

# base overview

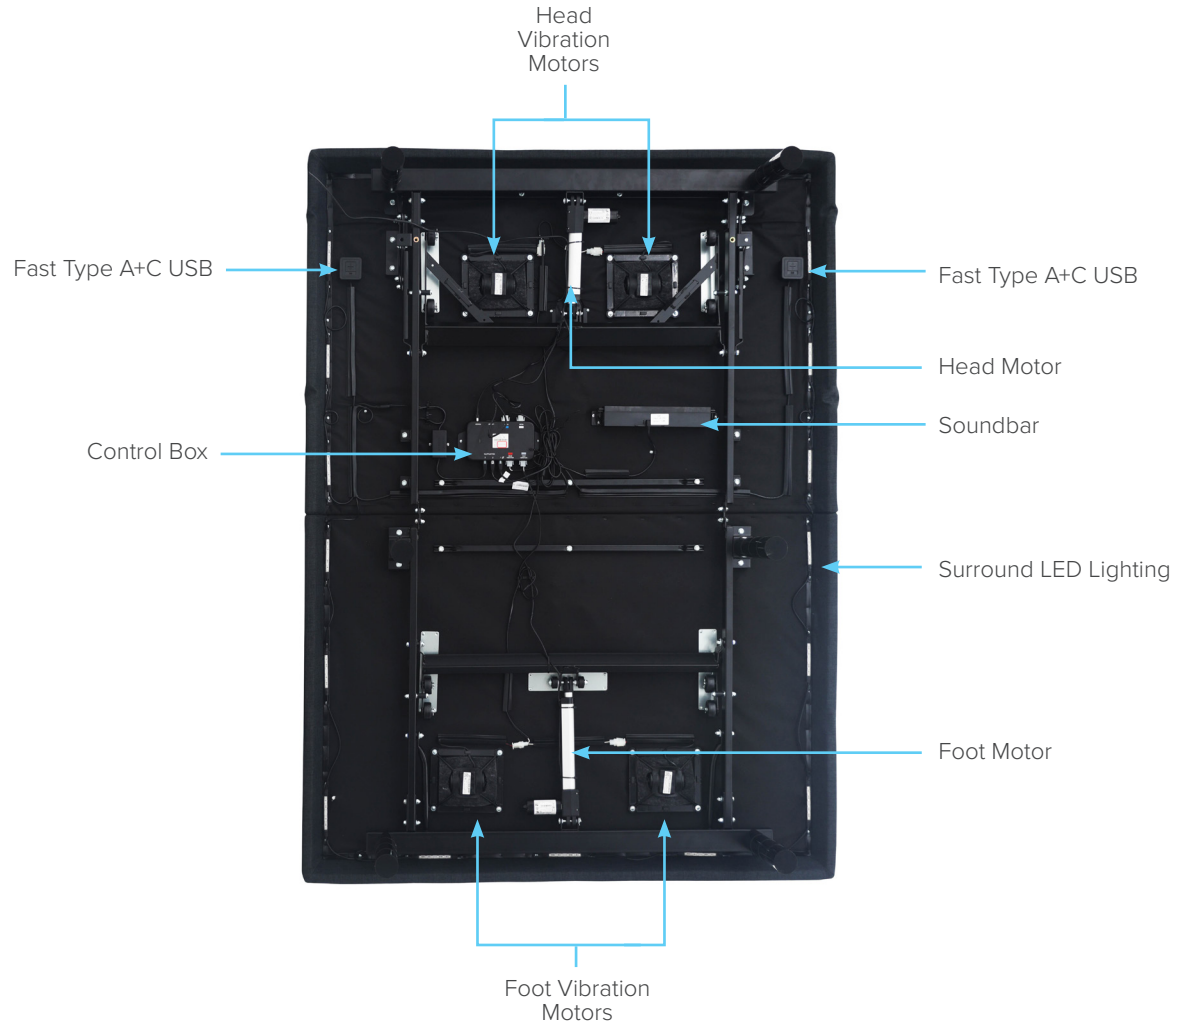




# quick reference guide

Not to scale. For illustration purposes only. Read all instructions before beginning installation.

## ELECTRONICS OVERVIEW

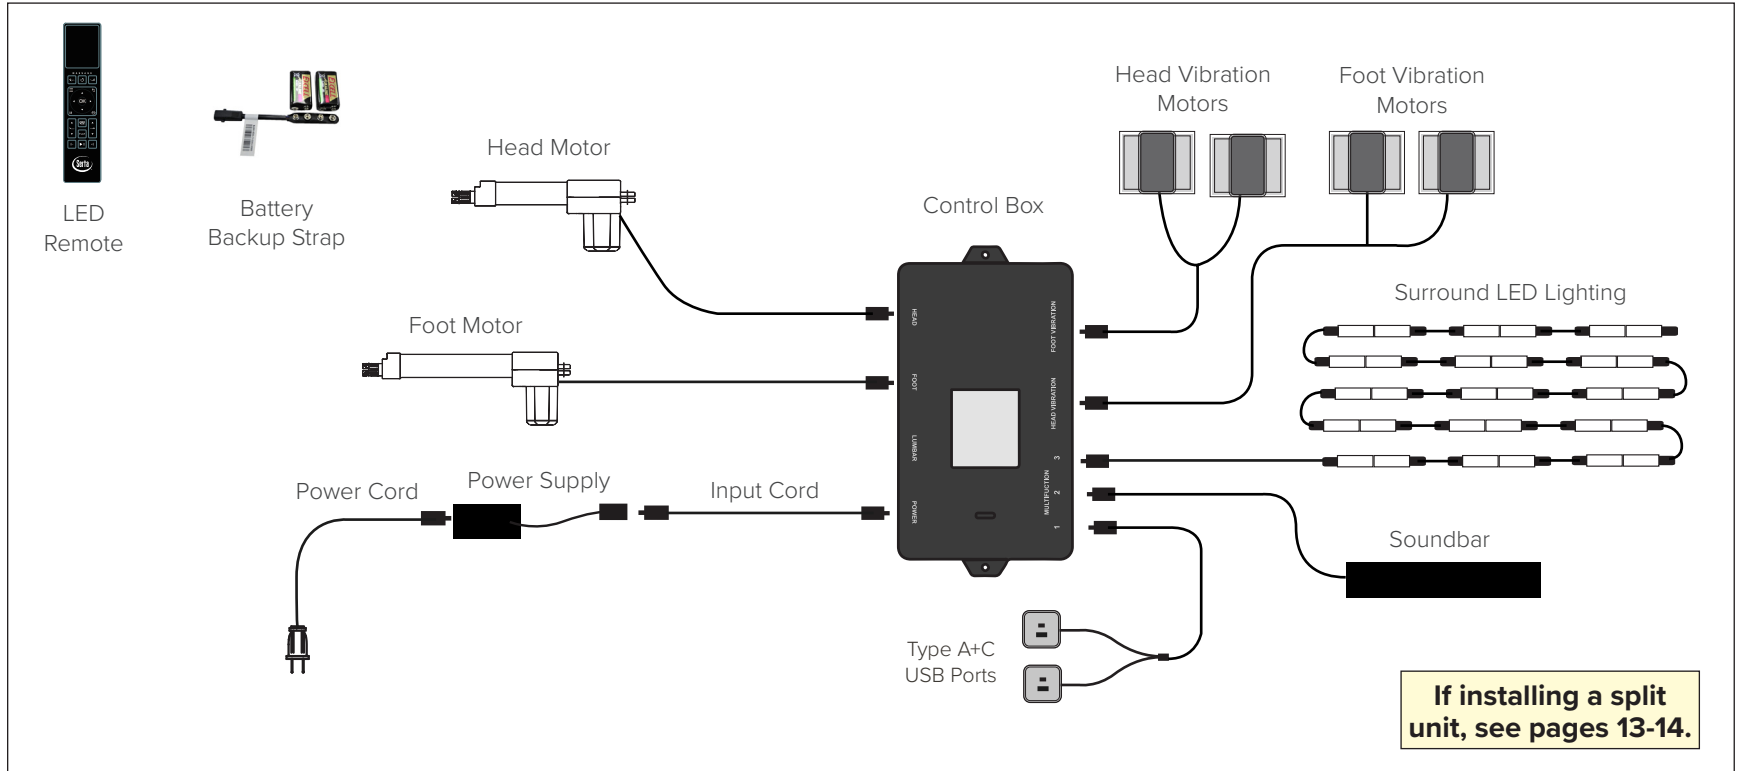

# installation guide

Always use two people when setting up the base.

## STEP 1

Place the bed base box in a desired location with the top of the box facing up.

Remove the binding straps and packing materials, making sure not to puncture the box with any sharp objects.

## STEP 2

Remove the bed base from the box. Unfold the bed making sure to keep the bottom of the bed facing upwards.



## STEP 3

To install Headboard Brackets, see instructions on page 16.

Legs are shipped fully assembled. Alternative heights in 3" increments can be achieved by removing leg segments.

To install the legs, thread the washer over the screw on the leg. Next, screw the leg into the nutsert on the frame. **Do not over tighten.**



## STEP 4

To sync two bases see detailed installation instructions on pages 13-14.

Locate the battery backup strap and set it aside. Be sure that it is accessible after the base is set up, in case of an emergency power outage.

# installation guide

## STEP 5

Uncoil input Power Cord (connected to Control Box's power port) and plug into Power Supply.



## STEP 8

Plug the power cord into a power source.

**A surge protector is recommended.**

## STEP 9

Install the remote batteries and test remote functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

## STEP 10

To install the mattress retainer bars, insert the ends of the bars into the holes at the foot of the platform.



## STEP 6

Uncoil the Power Cord and connect to the Power Supply. Place Power Supply on the ground and extend from the base. Ensure that the Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



## STEP 7


Carefully flip the base over. Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.

**Setup is now complete!**

# remote control

Remote Control arrives paired to the adjustable base.

Three (3) AAA batteries are required to operate the remote.

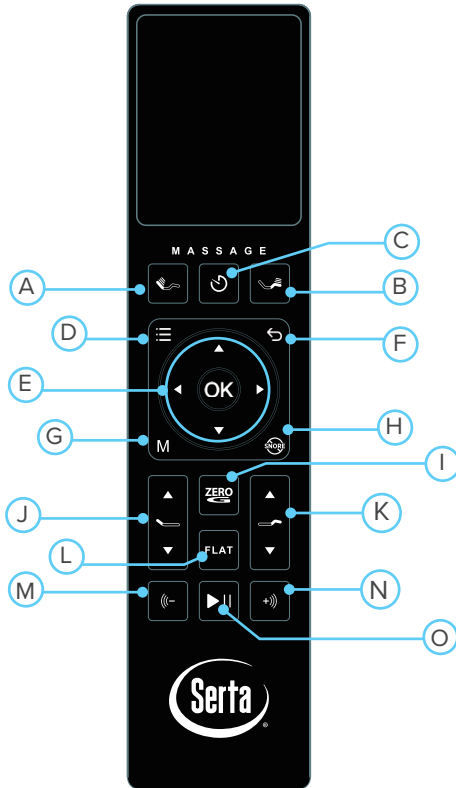

- A. Head Vibration:** Turns on the head vibration and cycles through 3 massage intensities. (Low > Med > High > Off)
- B. Foot Vibration:** Turns on the foot vibration and cycles through 3 massage intensities. (Low > Med > High > Off)
- C. Vibration Timer/All Off:** Selects a 15 minute, 30 minute, or 60 minute vibration interval. Pressing a fourth time will turn off all vibration.
- D. Menu:** Opens a list of setting options on the LCD screen.

Light Therapy: Select from a WARM, NEUTRAL or COOL lighting temperature mode. The lights under the bed can be timed for 30min, 60min or 8 hours.

Sound Therapy: Select from a WHITE, PINK or BROWN sound mode. The stereo can be timed for 30min, 60min or 8 hours.

Light & Sound: Select both the light therapy mode (WARM/ NEUTRAL/COOL) and the sound therapy mode (WHITE/PINK/ BROWN) together. A timer may be set for 30 min, 60 min, or 8 hours.

# remote control

- E. Navigation:** Use the arrows to navigate the menu options on the LCD screen. Press the **OK** button to select different options.
- F. Return:** Returns to the previous menu on the LCD screen.
- G. Memory\*:** Programs and saves your favorite position.
- H. Anti-snore\*:** Helps to reduce snoring by elevating the head and opening up airways.
- I. Zero-G®:** Adjusts your legs to a higher level than your heart, helping to relieve pressure off the lower back and promote circulation.
- J. Head Articulation:** Raises and lowers the head section of the base.
- K. Foot Articulation:** Raises and lowers the foot section of the base.
- L. Flat:** Lowers the base to a flat position.
- M. Volume – :** Decreases the sound volume.
- N. Volume + :** Increases the sound volume.
- O. Play/Pause:** Plays and pauses the audio.

## \*Save a new preset position:

1. Articulate the head and foot to your desired position.
2. Press and hold one of the programmable preset buttons (**Memory** or **Anti-snore**) for 5 seconds. Position is now saved.
3. Note: To restore the preset buttons back to their original factory settings, press and hold **Flat** and **Zero-G®** simultaneously for at least 5 seconds. The original presets will be restored.


# remote control

## REMOTE PAIRING

The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the base, follow the steps below.

### STEP 1

Unplug the Power Cord from your power outlet. Wait 1 minute, then plug it back in to your power outlet. Perform Step 2 within 10 seconds, while the control box light is flashing.

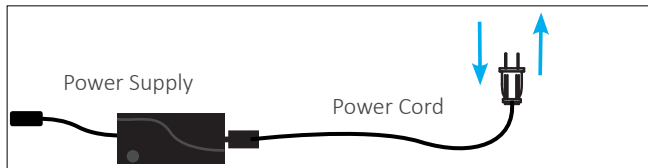

### STEP 2

Press and hold the PAIR button on the back of the remote. The PAIR button will illuminate and start to flash. When the PAIR button stops flashing, the LED light on the control box will stop flashing. Release the PAIR button.



### STEP 3

The remote is now paired to the adjustable base. Test all remote functions. If the remote buttons do not impact the adjustable base movements, please repeat the process again.


## CHILD LOCK

### Activate Child Lock

To activate Child Lock, double click the **Child Lock** button on the back of the remote.

The remote is now in Child Lock. Pressing any buttons while in Child Lock will yield no movement to your adjustable base.

**Note:** A lock icon on the remote LCD screen will light up green when Child Lock is active.




### Deactivate Child Lock

To deactivate Child Lock, double click the **Child Lock** button on the back of the remote.

The remote is no longer in Child Lock. The remote and adjustable base will work normally.

**Note:** An open lock icon will appear on the remote LCD screen when Child Lock is inactive.



# syncing two bases (optional)

A sync cord is included with the base. Not available on Queen, Full or King/Cal King size bases. The sync cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases.

## STEP 1


Unplug bases from power source.

## STEP 2

Plug the male ends of the sync cord into the Multifunction port of each control box.

## STEP 3

Plug bases back into the power source. The light under the bed will begin to flash, indicating that it is in pairing mode.

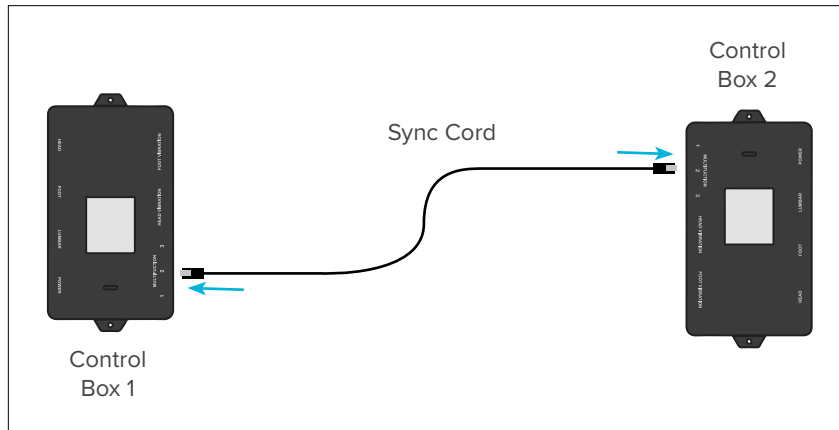

## STEP 4

Press and hold down the PAIR button on the back of the remote. The button will flash to indicate the pairing is completed. The PAIR button will stop flashing and the underbed light will turn off. The remote control can now operate the base normally.

PAIR button



# connecting strap (optional)

Connecting straps are secured to the base frame upon delivery.

Legs are required for the installation of the connecting straps.

## STEP 1

With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.



## STEP 2

Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt. Swing the strap and connect side (b) to the leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.



## STEP 3

Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.




# emergency battery backup strap

For emergency use only, in case of a power outage.

Batteries are not to be used for normal operation of the bed.


## STEP 1

Disconnect the Power Supply from the input power cord.

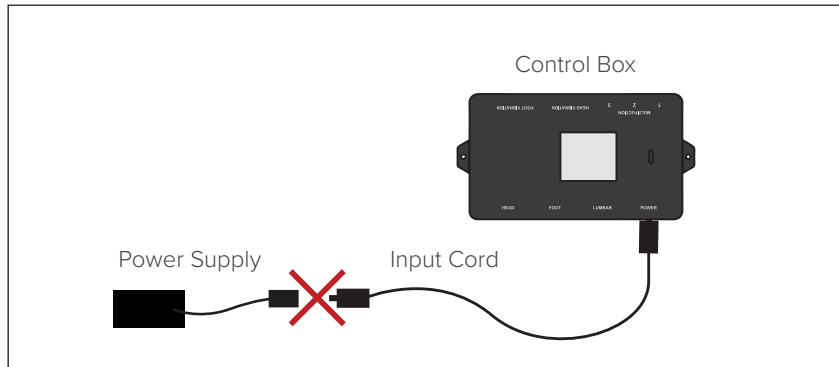

## STEP 3

Connect the end of the Battery Backup Strap to the input power cord that is attached to the control box.

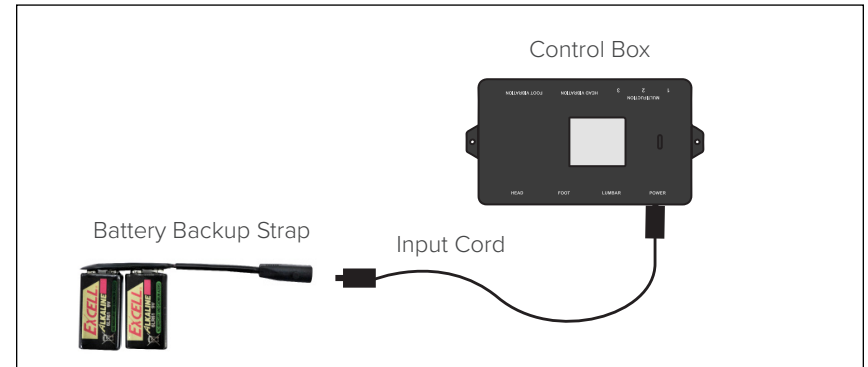

## STEP 2

Connect the Battery Backup Strap to the (2) 9 Volt Alkaline batteries.  
Do not mix brand name Batteries.



## STEP 4

Use the remote control to return the base to a flat position.

**Note:** Detach the Battery Backup Strap after the emergency is over, as the system will continue to draw power from the batteries even if not in use.

# headboard bracket installation guide (optional)


Headboard Brackets are an optional accessory and are not included.

A 9/16" & 1/2" socket and crescent wrench are necessary to complete installation.



## STEP 1

Attach the Headboard Bracket.

- Align the hole in the bracket to the brass sleeve into which the leg threads (a). Hold the bracket in place and screw the leg into the base until it is snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Too much force may cause the leg to spin freely.
- Align the tab with the hole in the frame (b) and use a short bolt and nut to secure the bracket. Make sure the bolt is tight.

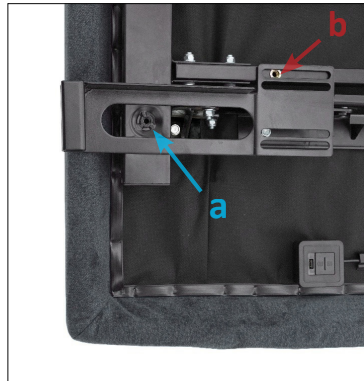


- Secure T-Bracket in place by inserting two short screws through top of bracket. Use hex key to tighten screws.

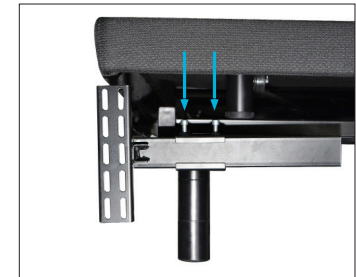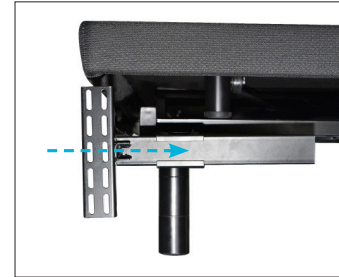

## STEP 3

Connect your headboard to the attachment plate using the remaining long screws or hardware that came with your headboard. The heads of the bolts will face outward. Use hex key to tighten bolts.

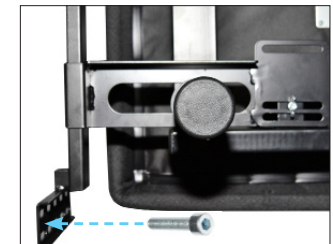

## STEP 2

Attach the plastic spacer and T-Bracket.

- Measure the distance between the mounting holes on the headboard and install the T-Bracket to accommodate the headboard.
- To install the T-Bracket, slide the T-Bracket through the end of the headboard bracket. Align the flat side of the T-Bracket plate to the mounting holes on the headboard.

# troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the blue LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 minute to reset the electronic components.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).
- Remove and replace full batteries in the remote control and re-pair the remote to the base (see page 12).
- Ensure Child Lock feature is not enabled. See page 12 for more information.

If issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote and call

**Ergomotion Customer Service: (888) 550-3746**

## Pg. 1-4 - Sobre las precauciones y el uso:

Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. Guarde estas instrucciones.

### ADVERTENCIA

Desenchufe siempre la base del tomacorriente antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe la base antes de limpiarla. Para desconectar de forma segura, asegúrese de que la base esté en una posición plana con todos los motores apagados y desconéctela de la fuente de alimentación.

## SEGURIDAD

### PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, INCENDIO O LESIONES:

Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para desconectar de forma segura, asegúrese que la base está en una posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes. Suspenda el uso de la base y póngase en contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha supervisión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, convalecientes, personas con discapacidad o los animales domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

### ADVERTENCIA

- Mantenga la cama en posición plana cuando no esté en uso.
- Manténgase alejado de las piezas móviles mientras está en movimiento.
- Antes de ajustar , asegúrese de que los niños y las mascotas estén alejadas de las partes móviles y no están bajo somier antes de ajustar.
- No permita que los niños operen base de la cama y sin supervisión de un adulto.

### CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD:

Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir que se suelte.

Bloqueo para niños: este control remoto está programado con una función de seguridad de bloqueo para niños. La información sobre la activación y desactivación de esta función se puede encontrar en la (s) página (s) del control remoto y en la parte posterior de su control remoto.

Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma presionando cualquier botón del control remoto.

Corte de energía: use la “Correa de respaldo de batería de emergencia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la correa de respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de batería de emergencia.

### NIÑOS Y MASCOTAS:

Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin supervisión de un adulto.

## ADVERTENCIA

Para una seguridad y funcionamiento óptimos, conecte la base de la cama a un protector contra sobretensiones (no incluido). La base de la cama sólo debe enchufarse directamente a un tomacorriente de pared con conexión a tierra o a un protector contra sobretensiones (muy recomendable). Una conexión inadecuada del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica, descarga eléctrica o funcionamiento defectuoso de este somier. Si el enchufe no se ajusta a su toma de corriente, comuníquese con un electricista calificado para instalar una toma de corriente adecuada.

### **MARCAPASOS:**

Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfibrilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietarios de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimiento / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

### **USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:**

Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusivamente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenoterapia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

### **CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES**

Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipados con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de pellizco.

### **ACÚSTICOS**

#### **MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO**

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera

tensión sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una operación normal de la base, las ruedas, que permiten distanciamiento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido al contacto, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

### **MATERIALES**

Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materiales como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través del uso general puede crear un sonido audible.

### **FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN**


La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien apretados.

Niveles 1-3 de la intensidad del masaje representan las revoluciones del motor por minuto. Nivel 3 proporciona el número máximo de RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entender la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones cambian simultáneamente.

### **TOLERANCIA**

Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases operen dentro de estas normas durante el uso normal de funcionamiento. El uso normal de funcionamiento se define como la siguiente: la base ajustable se va a operar con un

colchón y la carga. Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado "a" en la figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  $\pm 3^\circ$ , que se traduce en una tolerancia de hasta  $1\frac{1}{2}''$ .

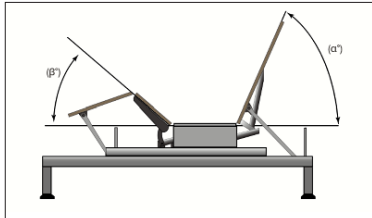

El ángulo (designado "b" en la figura 1) entre la sección plana y la sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  $\pm 3^\circ$ , que se traduce en una tolerancia de hasta  $\frac{3}{4}''$ .

Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de calidad del fabricante.

## EL OLOR DEL " NUEVO PRODUCTO ":

Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando se proporcione una ventilación adecuada.

## PERIODO DE ADAPTACION:

Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajustables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plataforma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

## SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:

Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando.

## DESGASTE Y ROTURA:

El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevitablemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

## CUIDADO DE LA TELA:

Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol siempre que sea

posible. Para la limpieza de manchas, limpie el área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes permanecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento profesional.

## CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo [18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseñados para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descansa 30 minutos después de que el masaje se haya apagado automáticamente antes de reiniciar.

## LÍMITES DE PESO:

Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 850 libras (o) 650 libras. Este producto no está evaluado para soportar pesos de más de 850 libras (o) 650 libras incluyendo el colchón y ropa de cama. La base soportara estructuralmente el peso, siempre y cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o causar lesiones y anulará la garantía.

## IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER

### HACER:

- Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
- Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la base eleve de manera dispareja.
- Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o el marco.
- Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay manchas.
- Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda utilizar colchones aptos para bases ajustables
- Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición plana (horizontal).

- Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base ajustable.

#### NO HACER:

- Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar el chasis, travesaños o espuma.
- Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos de la pierna.
- Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, esto puede dañar el marco y motores.
- Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regularmente.
- Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la posición plana (horizontal).
- Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
- Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores están funcionando puede dañar el marco y motores.

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

##### Cumplimiento con la FCC:

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

**Pg. 5 - Componentes:** Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene todos los componentes.

Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco.

- A) Control remoto inalámbrico y (3) pilas triple A.
- B) Patas (6)
- C) Barra de retención del colchón (2)\*
- D) Cable de Alimentación
- E) Fuente de Poder
- F) Correa de respaldo de la batería \*
- H) Cable Sync (1) †
- H) Correa de conexión\* †

#### Misceláneos (no incluidos):

Protector de sobrecargas

Pilas alcalinas de 9 voltios (2)

\* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. Retírelos con cuidado de la base y sepárelos.

† Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual, individual larga y Cal King dividida.

#### Pg. 6 - Resumen sobre la base

Head Vibration Motors = **Motores de vibración de cabeza**

Fast Type A+C USB Ports = **USB tipo rápido A+C**

Head motor = **Motor de la cabecera**

Foot motor = **Motor de los pies**

Control Box = **Caja de control**

Soundbar = **Barra de sonido**

Surround LED Lighting = **Iluminación LED envolvente**

Foot Vibration Motors = **Motores de vibración de los pies**

#### Pg. 7 - Guía de referencia rápida

No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación.

#### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ELECTRÓNICA

LED Remote = **Control remoto LED**

Battery Backup Strap = **Correa de respaldo de la batería**

Head motor = **Motor de la cabecera**

Foot motor = **Motor de los pies**

Control Box = **Caja de control**

Head Vibration Motors = **Motores de vibración de cabeza**

Foot Vibration Motors = **Motores de vibración de los pies**

Input Cord = **Cable de entrada de electricidad**

Power Supply = **Fuente de Poder**

Power Cord = **Cable de electricidad**

Type A+C USB Ports = **USB tipo A+C**

Surround LED Lighting = **Iluminación LED envolvente**

Soundbar = **Barra de sonido**

Si instala una unidad dividida, consulte las páginas 13-14.

**Pg. 8 - Guía de instalación:** Siempre use a dos personas para instalar la base.

**PASO 1:** Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con algún objeto afilado.

**PASO 2:** Retire la base de la cama de la caja. Despliegue la cama asegurándose de mantener la parte inferior de la cama hacia arriba. (PELIGRO: PUNTO DE PELLIZCO)

**PASO 3:** Para instalar los soportes de la cabecera, consulte las instrucciones en la página 16.

Las patas se envían completamente ensambladas. Se pueden lograr alturas alternativas en incrementos de 3" quitando segmentos de patas. Para instalar las patas, enrosque la arandela sobre el tornillo de la pata. Luego, atornille la pata en la tuerca del marco. No apriete demasiado.

**PASO 4:** Para sincronizar dos bases ver instalación detallada instrucciones en las páginas 13-14. Localice la correa de respaldo de la batería y déjela a un lado.

Asegúrese de que sea accesible después de instalar la base, en caso de un corte de energía de emergencia.

**Pg. 9 - Guía de instalación**

**PASO 5:** Desenganche el cable de alimentación de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la fuente de alimentación.

**PASO 6:** Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el protector de sobretensión deseado.

**PASO 7:** Con cuidado, vuelca la base. Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

**PASO 8:** Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electricidad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.

**PASO 9:** Instale las baterías del control remoto y pruebe las funciones remotas para verificar la configuración correcta antes de colocar el colchón en la base. Vuelva la base a una posición plana antes de colocar el colchón en la parte superior.

**PASO 10:** Para instalar las barras de retención del colchón, inserte los extremos de las

barras en los orificios de las esquinas del pie de la base.

¡La configuración ya está completa!

Para servicio al cliente, visite [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) o llame al 1-888-550-3746.

**Pg. 10-11 - Control remoto:**

**El control remoto llega emparejado a la base ajustable. Se requieren tres (3) baterías AAA para operar el control remoto.**

- A. Vibración de la cabeza:** Enciende la vibración de la cabeza y realiza un ciclo a través de 3 intensidades de masaje. (Bajo > Medio > Alto > Desactivado)
- B. Vibración de los pies:** enciende la vibración de los pies y realiza un ciclo a través de 3 intensidades de masaje. (Bajo > Medio > Alto > Desactivado)
- C. Vibration Timer/All Off:** selecciona un intervalo de vibración de 15, 30 o 60 minutos. Al presionar una cuarta vez se apagará toda vibración.
- D. Menú:** abre una lista de opciones de configuración en la pantalla LCD.
  - Terapia de luz: seleccione entre un modo de temperatura de iluminación cálida, neutra o fría. Las luces debajo de la cama se pueden programar para 30 minutos, 60 minutos u 8 horas.
  - Terapia de sonido: seleccione entre un modo de sonido blanco, rosa o marrón. El estéreo se puede programar para 30 min, 60 min u 8 horas.
  - Luz y sonido: Seleccione el modo de terapia de luz (CÁLIDO/NEUTRO/FRÍO) y el modo de terapia de sonido (BLANCO/ROSA/MARRÓN) juntos. Se puede configurar un temporizador para 30 min, 60 min u 8 horas.
- E. Navegación:** use las flechas para navegar por las opciones del menú en la pantalla LCD. Presione el botón OK para seleccionar diferentes opciones.
- F. Volver:** Vuelve al menú anterior en la pantalla LCD.
- G. Memoria\*:** Programa y guarda tu posición favorita.
- H. Antirronquidos\*:** Ayuda a reducir los ronquidos elevando la cabeza y abriendo las vías respiratorias.
- I. Zero-G®:** Ajusta sus piernas a un nivel más alto que su corazón, lo que ayuda a aliviar la presión en la parte baja de la espalda y promueve la circulación.
- J. Articulación de la cabeza:** sube y baja la sección de la cabeza de la base.
- K. Articulación de los pies:** sube y baja la sección de los pies de la base.
- L. Plana:** Baja la base a una posición plana.
- M. Volumen – :** Disminuye el volumen del sonido.
- N. Volumen + :** Aumenta el volumen del sonido.
- O. Reproducir/Pausar:** Reproduce y pausa el audio.

**\*Programación predefinida:**



**PASO 1:** Articular la cabeza y el pie a la posición deseada.

**PASO 2:** Presione y mantenga presionado uno de los botones de presintonía [**Memoria** o **Antirronquidos**] durante 5 segundos. La posición se ha guardado.

**Nota:** Para restablecer los valores predeterminados de fábrica de los botones de presintonía, mantenga pulsados simultáneamente **Plana** y **Zero-G®** durante al menos 10 segundos. Los ajustes preestablecidos originales se restaurarán.

## Pg. 12 - control remoto

### PAREO DEL CONTROL REMOTO

El control remoto que viene en la caja ya está sincronizado con la base de la cama. No se requieren acciones adicionales. En caso que el remoto no esté sincronizado con la base, siga los siguientes pasos.

**PASO 1:** Desconecte el cable de alimentación de su toma de corriente. Espere 1 minuto y vuelva a conectarlo a la toma de corriente. Realice el Paso 2 dentro de 10 segundos, mientras la luz de la caja de control parpadea.

**PASO 2:** Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando el botón PAIR deja de parpadear, la luz LED en la caja de control dejará de parpadear. Suelta el botón PAIR.

**PASO 3:** El control remoto ahora está emparejado con la base ajustable. Pruebe todas las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan los movimientos ajustables de la base, repita el proceso nuevamente.

### BLOQUEO PARA NIÑOS:

•**Activar el Bloqueo para Niños:** Para activar el Bloqueo para Niños, presione el botón de bloqueo para niños en la parte posterior del control remoto dos veces.

**Nota:** Un ícono de candado en la pantalla LCD remota se iluminará en verde cuando Child Lock esté activo.

•**Desactivar el Bloqueo para Niños:** Para desactivar el Bloqueo para Niños, presione el botón de bloqueo para niños en la parte posterior del control remoto dos veces.

**Nota:** Aparecerá un ícono de candado abierto en la pantalla LCD remota cuando Child Lock esté inactivo.

## Pg. 13 - Sincronizar Dos Bases (opcional)

Se incluye un cable de sincronización con la base. No está disponible para las bases tamaño Queen, Full, Full-Largo, o King Dividido. El cable de sincronización conecta las dos cajas de control a un solo control remoto para la sincronización de dos bases.

**PASO 1:** Desconecte las bases de los tomacorrientes.

**PASO 2:** Conecte los extremos macho del cable de sincronización en el puerto multifunción de cada caja de control.

**PASO 3:** Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación. La luz debajo de la cama comenzará a parpadear, lo que indica que está en modo de emparejamiento.

**PASO 4:** Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior del control remoto. El botón parpadeará para indicar que se completó el emparejamiento. El botón PAIR dejará de parpadear y la luz debajo de la cama se apagará. El control remoto ahora puede operar la base normalmente. El sistema ahora está sincronizado. Ahora ambos remotos funcionarían en las dos bases.

**Pg. 14 - Correa de conexión (opcional):** Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de las correas de conexión.

**PASO 1:** Con las bases en la ubicación deseada, afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco.

**PASO 2:** Deslice el lado (a) de la correa de conexión por la tuerca de la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) a la tuerca de la pata. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.

**PASO 3:** Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la base.

**Pg. 15 - Correa de respaldo de la batería :** Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la cama.

**PASO 1:** Desconecte la fuente de alimentación del cable de alimentación de entrada.

**PASO 2:** Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca.

**PASO 3:** Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de control.

**Nota:** Desconecte la correa de la batería de respaldo después de que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo energía de las baterías, incluso si no se usa.

Control Box = **Caja de control**

Input Cord = **Cable de entrada de electricidad**

Power Supply = **Fuente de Poder**

Battery Backup Strap = **Correa de respaldo de la batería**

## Pg. 16 - Guía de instalación del soporte de la cabecera Componentes del soporte de la cabecera:

Los soportes de la cabecera son un accesorio opcional y no están incluidos. Se necesita un dado de 9/16" y 1/2" y una llave inglesa para completar la instalación.

**PASO 1:**

Conecte el soporte de la cabecera.

- a. Alinee el orificio del soporte con el manguito de latón en el que se enrosca la pata (a). Sostenga el soporte en su lugar y atornille la pata en la base hasta que quede ajustada. **NO APRIETE DEMASIADO.** Demasiada fuerza puede hacer que la pierna gire libremente.
- a. Alinee la lengüeta con el orificio en el marco (b) y use un perno corto y una tuerca para asegurar el soporte. Asegúrese de que el perno esté apretado.

## **PASO 2:**

Coloque el espaciador y Soporte-T.

- a. Mida la distancia entre los orificios de montaje en la cabecera e instale el espaciador y la placa de fijación para dar cabida a la cabecera.
- b. Para instalar el soporte en T, deslícelo a través del extremo del soporte de la cabecera. Alinee el lado plano de la placa del soporte en T con los orificios de montaje en la cabecera.
- c. Asegure el soporte en T en su lugar insertando dos tornillos cortos a través de la parte superior del soporte. Utilice una llave hexagonal para apretar los tornillos.

**PASO 3:** Ahora puede conectar el cabezal a las placas de fijación usando los pernos pequeños y las tuercas restantes para asegurarlo a los soportes. Las cabezas de los tornillos deben estar hacia afuera. Use una llave hexagonal para apretar los tornillos.

## **Pg. 17 - Solución de problemas**

Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de funcionar:

- Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyendo el movimiento de la base.
- Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada y la potencia están conectados correctamente.
- Desconecte la base durante 1 minuto para reponer los componentes electrónicos.
- Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
- Retire y reemplace las baterías completas del control remoto y vuelva a emparejar el control remoto con la base (consulte la página 12).
- Asegúrese de que la función de bloqueo para niños no esté habilitada. Consulte la página 12 para obtener más información.

Si el problema no se resuelve, siguiendo las instrucciones anteriores, busque el número de serie en la tarjeta de garantía, manual o posterior del mando a distancia y llame

Ergomotion Servicio al cliente: EE.UU. 1-888-550-3746

## Pg. 1-4 - Précaution de sécurité à prendre et consignes d'utilisation

**Attention : Avis de non-responsabilité importants en matière de sécurité**  
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre base réglable. Enregistrez ces instructions.

### **AVERTISSEMENT**

Débranchez toujours la base de la prise électrique avant de réparer une partie de la base. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez la base avant de la nettoyer. Pour déconnecter en toute sécurité, assurez-vous que la base est dans une position plate avec tous les moteurs éteints et débranchez-la de la source d'alimentation.

## SÉCURITÉ

### **POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, BRÛLURES, FEU, OU BLESSURES :**

Pour l'opération et la sécurité optimales, branchez le sommier dans une barre d'alimentation contre les surtensions. Le sommier devrait seulement être branché directement dans une prise murale ou dans une barre d'alimentation contre les surtensions (fortement recommandé). Débranchez toujours de la prise avant d'assurer l'entretien de toute partie du sommier. Pour réduire le risque de décharges électriques, débranchez toujours le sommier avant de le nettoyer. Pour bien le débrancher, assurez-vous que la base se trouve en position neutre et à plat avec tous les moteurs éteints et débranchez-le de la source d'énergie. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chauffées. Cessez l'emploi du sommier et contactez un centre de service qualifié si le sommier a un fil électrique ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé dans l'eau. Utilisez ce sommier seulement pour son usage prévu comme désigné dans ce manuel. N'employez pas d'accessoires ni pièces additionnelles qui ne sont pas recommandés par le fabricant. La surveillance étroite est nécessaire quand le sommier est utilisé par ou près des enfants, convalescents, personnes infirmes ou animaux domestiques. Un branchement incorrect de l'équipement peut amener un risque de décharge électrique, feu électrique ou une mauvaise utilisation de ce sommier. Si la prise du sommier n'est pas de bonne taille pour votre prise murale, contactez un électricien qualifié en faire l'installation. La modification non autorisée

du sommier, la non-conformité d'une prise ou l'absence de barre d'alimentation contre les surtensions pourrait rendre nulle la section électrique de votre garantie.

### **AVERTISSEMENT**

- Garder toujours le lit en position à plat lorsqu'il ne sert pas.
- Restez à l'écart des pièces mobiles en mouvement.
- Avant d'actionner le mécanisme du lit, assurez-vous que les enfants et les animaux sont tenus à l'écart de la base du lit.
- Ne pas laisser les enfants utiliser la base de lit sans la supervision d'un adulte .

### **DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:**

**Fonctionnement manuel** - Si quelque chose se coince dans la plate-forme lorsqu'elle est aplatie, vous pouvez soulever manuellement la plate-forme en soulevant à la fois la tête et le pied pour soulager la pression et permettre la libération.

**Verrouillage pour enfants** - Cette télécommande est programmée avec une fonction de sécurité de verrouillage pour enfants. Des informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction se trouvent sur la (les) page (s) Télécommande et au dos de votre télécommande.

**Arrêt d'urgence** - Arrêtez le mouvement de la plate-forme en appuyant sur n'importe quel bouton de la télécommande ou en appuyant sur le bouton du boîtier de batterie de secours situé sous la base.

**Panne de courant** - Utilisez le «boîtier de batterie de secours de secours» comme source d'alimentation temporaire pour amener la base à la position souhaitée. Les instructions sur le fonctionnement du boîtier de batterie de secours se trouvent sur la (les) page (s) de secours par batterie de secours.

### **ANIMAUX DOMESTIQUES ET ENFANTS :**

Jetez immédiatement toutes les matières d'emballage comme elles peuvent poser un risque d'étouffement pour les jeunes enfants et animaux domestiques. Pour éviter les blessures, il est déconseillé de permettre aux enfants et petits animaux de jouer sur ou sous le lit. Les enfants ne devraient pas opérer le sommier sans la supervision d'un adulte.

## **WARNING**

Pour une sécurité et un fonctionnement optimaux, branchez le sommier sur un parasurtenseur (non inclus). Le sommier ne doit être branché que directement sur une prise murale mise à la terre ou un parasurtenseur (fortement recommandé). Une mauvaise connexion de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique, de lime électrique ou un mauvais fonctionnement de ce sommier. Si la fiche ne correspond pas à votre prise, contactez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

### **STIMULATEURS CARDIAQUES :**

Quelques produits contiennent les aimants Neodymium qui pourraient interférer avec des appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs implantables et tout autre appareil sensible aux champs magnétiques. Il est **FORTEMENT** recommandé que les propriétaires de tels appareils médicaux consultent leur médecin avant d'utiliser les produits qui contiennent les aimants Neodymium. Il est aussi possible que certains stimulateurs cardiaques puissent mal interpréter les vibrations de la fonction massage comme du mouvement/de l'exercice. C'est un résultat fréquent avec tout produit qui crée un mouvement de vibration et peut également affecter le stimulateur cardiaque. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la fonction massage.

### **UTILISATION À DOMICILE :**

Les sommiers ajustables Ergomotion sont conçus seulement pour l'utilisation à domicile. Ce sommier n'a pas été conçu comme lit d'hôpital et n'est pas conçu pour satisfaire les normes hospitalières. N'employez pas ce sommier avec de l'équipement de thérapie d'oxygène TENT TYPE ou près de gaz explosifs.

### **CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :**

Les roulettes (accessoires de pied facultatifs) sont équipées de roues bloquantes pour éviter le mouvement involontaire. Même lorsque verrouillées et bloquées, il est possible que les roulettes glissent. Les moteurs d'abaissement de la tête et des pieds sont conçus pour baisser le matelas, se rétractant seulement par la force de la gravité, jamais en tirant vers le bas, minimisant les points de pincement.

## **ACOUSTIQUE**

### **MÉCANISMES DE LEVAGE/D'ABAISSEMENT**

La fonction de levage et d'abaissement émettra un faible vrombissement lors de l'opération. Ce bruit est normal. Pendant l'opération, les roues de levage de

bras entrent en contact avec le support du sommier. Ce contact peut occasionner un contact entre métaux ou entre métal et plastique, ce qui apporte une légère tension sur les composantes mobiles. La résonance est aussi réduite à un niveau minimal. Si un bruit excessif ou une vibration sont remarqués, inversez le mouvement du sommier (vers le haut ou vers le bas) avec la télécommande. Ceci devrait réaligner les mécanismes d'activation du sommier à la bonne position d'opération. Lors de l'emploi normal du sommier, les roues – qui permettent au lit d'être à une certaine distance du mur – entreront en contact avec le support du sommier en acier, ce qui créera un bruit de contact. En entrant, en sortant ou en transférant son poids sur le lit, on peut entendre ce bruit de contact des roues qui touchent le support du sommier. Ce bruit est normal.

### **MATÉRIAUX**

Les sommiers ajustables Ergomotion sont fabriqués avec divers matériaux, y compris du bois, des métaux, des plastiques et des tissus. La tension, la pression ou le mouvement appliqués au cadre, au support ou à la couverture lors de son utilisation générale peuvent créer un son audible.

### **FONCTION MASSAGE ET ENVIRONNEMENT D'EMPLACEMENT**


La fonction massage émettra une alerte sonore lors de l'usage. Ce bruit est normal. Quand le niveau d'intensité du massage augmente, le son s'intensifiera. Le volume de cette alerte est directement lié à l'environnement d'emplacement. Par exemple, pendant une démonstration de fonctionnement dans une salle d'exposition, le bruit environnant couvrira une partie du bruit du massage. Par contre, lorsque le lit est installé à domicile avec un parquet, avec un tapis ou non, le volume du massage sera plus ou moins perceptible. Pour minimiser le bruit, mettez un tapis ou des feutres pour roulettes en caoutchouc en dessous de chaque pied ou roulettes du sommier. Il est possible de remarquer une vibration ou un bruit de l'extérieur du sommier, des supports de la tête de lit, des têtes de lit, ou des pieds de lit si les boulons de montage ne sont pas fermement serrés.

Les niveaux 1-3 d'intensité du massage correspondent aux révolutions du moteur par minute. Le niveau 3 donne le nombre maximum de tours par minute. Cependant, ceci ne veut pas dire que la sensation de vibration est la plus forte. Selon le matériau du matelas, l'épaisseur et la position de l'utilisateur, les sensations de vibration différeront. Nous encourageons l'utilisateur à trouver l'intensité du massage qui lui convient le mieux. Il est important de comprendre les propriétés physiques des vibrations. Un moteur seul peut fonctionner de façon irrégulière à l'arrêt, mais comme le nombre de tours par minute augmente, les

vibrations changent simultanément.

## TOLÉRANCE

Tous les sommiers ajustables Ergomotion, selon leur marque et modèle, sont conçus et fabriqués pour fonctionner selon des paramètres précis de contrôle de qualité. Les sommiers sont sujets aux inspections méticuleuses et rigoureuses pendant notre processus de contrôle de qualité pour nous assurer que les sommiers fonctionneront selon les normes exigées lors d'un usage normal. L'usage normal est défini tel que suit : la fondation ajustable doit être opérée avec un matelas et un poids. Les processus de test requièrent des tests de cycle de durée de vie avec un poids allant jusqu'à 120 kilos distribués équitablement. L'angle (désignée par « a » dans la figure 1) entre la section arrière et la section plate pour les diverses configurations du matelas/du support devraient être à  $\pm 3^\circ$ , ce qui se traduit en une tolérance de jusqu'à  $1\frac{1}{2}''$ .

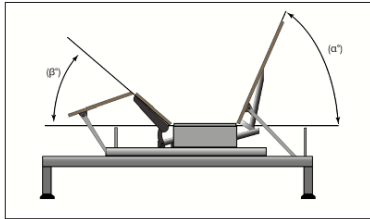

L'angle (désigné par « B » dans la figure 1) entre la section plate et la section de pied, pour les diverses configurations du matelas et du support, devrait être à  $\pm 3^\circ$ , ce qui se traduit en une tolérance de jusqu'à  $1\frac{1}{2}''$ .

Toute fondation ajustable jugée compatible avec ces tolérances allouées est considérée comme satisfaisante par rapport aux contrôles de qualité du fabricant.

## L'ODEUR DU NOUVEAU PRODUIT

Certaines personnes remarquent une légère odeur avec leur nouveau sommier ajustable – ceci peut venir de notre processus de fabrication. Cette odeur est normale et disparaît habituellement avant que le produit ne vous parvienne. Cependant, cette odeur peut parfois encore être sentie. Normalement elle disparaît après quelques semaines avec une ventilation adéquate du produit et de l'environnement.

## PÉRIODE DE RODAGE

Vous pouvez accélérer la période de rodage en passant du temps sur votre lit ajustable avec des activités telles que lire, regarder la télévision ou jouer avec les enfants ou les petits-enfants. Ce mouvement supplémentaire aidera le sommier ajustable à répondre au poids et aux changements de température. Certains des matériaux dans nos sommiers ajustables, comme les bois, les métaux, et

les plastiques dans la plate-forme, le cadre et les composantes sont sensibles à la teneur d'humidité et à la température et peuvent ainsi faire de bruit dans des environnements frais.

## EMPLOI EN PAIRE

Lors de l'emploi avec une installation de sommier divisée en deux, il se peut qu'il y ait un temps de latence allant jusqu'à 1,5 seconde entre les articulations de chaque sommier.

## USURE NORMALE

L'usure normale correspond à l'endommagement qui arrive naturellement et inévitablement comme un résultat de l'emploi normal ou du vieillissement.

## ENTRETIEN DU TISSU

Pour prolonger la vie de votre tissu, protégez-le de la lumière directe du soleil autant que possible. Pour nettoyer de petites taches, essuyez-les avec une éponge légèrement humide ou passez l'aspirateur avec un adaptateur de brosse douce pour enlever les particules. Gardez au minimum à une distance de 30 cm (12 pouces) des sources directes de chaleur. Pour nettoyer plus profondément, épongez les liquides avec un chiffon sec et propre. N'humectez pas excessivement. Une brosse en soie douce peut aussi être utilisée pour enlever les saletés incrustées. Brossez doucement pour éviter les égratignures. Essuyez avec un chiffon propre et humide avec de l'eau chaude pour enlever les résidus. Séchez à l'ombre loin de la chaleur directe. Si les tâches persistent après le nettoyage, consultez un professionnel.

## CLASSIFICATION DU PRODUIT

Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour opérer de manière continue pour plus que [2] minutes pendant une période de [18] minutes ou environ 10 % du cycle de service. Des efforts pour circonvenir ou excéder cette classification rendront plus courte l'espérance de vie du produit et pourraient annuler la garantie. Les moteurs de massage ne sont pas conçus pour opérer de manière continue pendant plus que 30 minutes à la fois. Veuillez permettre au système de massage une pause de 30 minutes après l'arrêt automatique du massage avant de recommencer.

## LIMITES DE POIDS

Ce produit n'est pas classé pour soutenir des poids excédant 750 livres (340 kg), ce qui inclut le matelas et la literie. Le sommier soutiendra structurellement ce poids, tant qu'il est distribué également sur tout le sommier. Le sommier

ajustable n'est pas conçu pour soutenir ou lever ce poids dans la section tête ou pied seulement. Excéder cette restriction de poids pourrait endommager le lit ou blesser l'utilisateur et pourrait rendre nulle la garantie.

## À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

### À FAIRE

- Branchez votre sommier ajustable dans une barre d'alimentation contre les surtensions.
- Distribuez le poids de manière égale dans le cas d'une installation double. Une distribution inégale du poids peut amener le sommier à s'élever inégalement.
- Appelez le service à la clientèle pour tout problème technique. N'essayez pas de forcer le sommier à s'abaisser ; ceci pourrait endommager les moteurs ou le cadre.
- Utilisez un savon doux et de l'eau pour nettoyer votre sommier ajustable s'il est taché.
- Sachez que les sommiers ajustables sont recommandés pour être utilisés avec des matelas qui sont ajustables
- Baissez à la position neutre (horizontale) après l'emploi et entre les préréglages.
- Inscrivez votre garantie aussitôt que votre sommier ajustable est livré.

### À NE PAS FAIRE

- Ne vous asseyez pas sur les coins du sommier; ceci pourrait déformer le cadre, les supports, ou la mousse.
- Ne penchez pas le sommier sur le côté. Ceci pourrait endommager les pieds ou les boulons.
- Ne vous mettez jamais debout et ne sautez jamais sur le sommier ajustable; ceci peut endommager le cadre et les moteurs.
- Ne tirez pas sur le sommier pour le déménager. Ceci pourrait endommager le cadre, les boulons ou casser les pieds. Achetez des roulettes si vous prévoyez souvent déménager votre sommier.
- Ne montez pas sur le sommier ajustable et n'en descendez pas avec la tête ou le pied dans la position articulée; montez sur le sommier ajustable et descendez-en dans la position neutre (horizontale).
- Ne modifiez pas le sommier. Ceci annulera la garantie.
- N'appuyez pas sur la tête ni sur le pied pendant l'opération, car ceci peut endommager le cadre et les moteurs.

## Déclaration de Certification FCC

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence (RF). Si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, l'appareil peut provoquer des interférences dans les communications radio. Rien ne garantit, cependant, que de telles interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Déplacez l'appareil
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui des autres appareils électroniques
- Consulter le revendeur ou un technicien radio expérimenté.

## Pg. 5 - Liste de pièces

Avant de jeter le matériel d'emballage - s'assurer que toutes les pièces soient comptabilisées.

Tous les produits électroniques et composants qui doivent être installés se trouvent dans des casiers sous la base ou fixés au châssis.

- |    |  |
|----|--|
| A) | Télécommande sans fil et piles AAA (3) |
| B) | Pattes (6)                             |
| C) | Barre de retenue de matelas (2)*       |
| D) | Cordon d'alimentation                  |
| E) | Bloc d'alimentation                    |
| F) | Sangle de batterie de secours          |
| G) | Cordon de synchronisation‡             |
| H) | Sangle de raccordement‡ *              |

### Div. Pièces (non incluses) :

Protecteur de surtension des supports de tête de lit

Piles alcalines de 9 volts (2)

\* Ces éléments sont attachés à la base aux fins d'expédition. Enlever de la base

avec précaution et les mettre de côté.

‡ Inclus seulement avec les bases divisées Twin Long et Cal King avec bases divisées..

## **Pg. 6 - Aperçu de base et à distance**

**Head Vibration Motors** = Moteurs de vibration de tête

**Fast Type A+C USB** = Ports USB rapides de type A+C

**Head Motor** = Moteur de la tête

**Control Box** = Boîte de contrôle

**Soundbar** = Barre de son

**Surround LED Lighting** = Éclairage à DEL d'ambiance

**Foot Vibration Motors** = Moteurs de vibration de pied

**Foot Motor** = Moteur du pied

## **Pg. 7 - Guide de référence rapide**

Pas à l'échelle. Pour des fins d'illustration uniquement. Lire toutes les instructions avant de commencer l'installation.

Aperçu de l'électronique

**LED Remote** = Télécommande DEL

**Battery Backup Strap** = Sangle de batterie de secours

**Head Motor** = Moteur de la tête

**Foot Motor** = Moteur du pied

**Control Box** = Boîte de commande

**Input Cord** = Corde d'entrée

**Power Supply** = Alimentation électrique

**Power Cord** = Cordon d'alimentation

**Head Vibration Motors** = Moteurs de vibration de tête

**Foot Vibration Motors** = Moteurs de vibration de pied

**Fast Type A+C USB Ports** = Ports USB rapides de type A+C

**Surround LED Lighting** = Éclairage à DEL d'ambiance

**Soundbar** = Barre de son

Si vous installez une unité divisée - voir page 13-14.

## **Pg. 8 - Guide d'installation**

Toujours faire appel à deux personnes lors de la configuration de la base.

**ÉTAPE 1** : Placez la boîte de la base du lit dans un emplacement de votre choix

avec le fond de la boîte vers le haut.

Déposer les sangles de fixation et des matériaux d'emballage, en veillant à ne pas perforer la boîte avec des objets tranchants.

**ÉTAPE 2** : Retirez le sommier de la boîte. Dépliez le lit en veillant à garder le bas du lit vers le haut. (DANGER - POINT DE PINCEMENT)

**ÉTAPE 3** : Pour installer les supports de tête de lit, consultez les instructions à la page 16. Les pattes sont expédiés entièrement assemblés. Des hauteurs alternatives par incréments de 3" peuvent être obtenues en retirant les segments de pattes.

Pour installer les pattes, enfiler la rondelle sur la vis du pied. Ensuite, vissez la patte dans l'écrou du cadre. Ne pas trop serrer.

**ÉTAPE 4** : Si vous installez une unité divisée - voir page 13-14.

Localisez la sangle de la batterie de secours et mettez-la de côté. Assurez-vous qu'il est accessible une fois la base installée, en cas de panne de courant d'urgence.

Pour service consommateurs, allez au site web [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) ou appelez le numéro vert : 1-888-550-3746

## **Pg. 9 - Guide d'installation**

**ÉTAPE 5** : Déroulez la corde d'entrée (connectée au port d'alimentation sur la boîte de contrôle) et branchez-la dans l'alimentation électrique.

**ÉTAPE 6** : Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le dans l'alimentation électrique. Placez l'alimentation électrique par terre et rallongez-la de la base. Assurez-vous que l'alimentation électrique et tous les fils attachés se dirigent vers la multiprise.

**ÉTAPE 7** : Tournez soigneusement la base sur ses pattes. Important : Toujours faire appel à deux personnes lors de l'installation ou lorsque vous tournez la base. Ne pas glisser sur le plancher. Ne laissez pas le châssis sur le côté, une pression excessive risque d'endommager les pattes.

**ÉTAPE 8** : Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation. Un protecteur de surtension est fortement recommandé.

**ÉTAPE 9** : S'assurer que les piles sont correctement installées dans l'arrière de la télécommande. Tester des fonctions à distance afin de vérifier la configuration avant de placer le matelas sur la base. Appuyez sur PLAT pour retourner la basse

à sa position à plat.

**ÉTAPE 10** : Pour installer les barres de maintien du matelas, insérez les extrémités des barres dans les trous au pied de la plateforme.

L'installation Élémentaire Est Complète.

Pour contacter l'assistance clientèle, visitez [ergomotion.com](http://ergomotion.com) ou appelez le : 1-888-550-3746

## Pg. 10-11 - Télécommande

La télécommande arrive couplée à la base réglable.

Trois (3) piles AAA sont nécessaires pour faire fonctionner la télécommande.

**A. Vibration de la tête** : active la vibration de la tête et fait défiler 3 intensités de massage. (Faible > Moyen > Elevé > Désactivé)

**B. Vibration du pied** : active la vibration du pied et fait défiler 3 intensités de massage. (Faible > Moyen > Elevé > Désactivé)

**C. Minuterie de vibration/Tout désactivé** : sélectionne un intervalle de vibration de 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Appuyez une quatrième fois pour désactiver toutes les vibrations.

**D. Menu** : Ouvre une liste d'options de réglage sur l'écran LCD.

- **Luminothérapie** : sélectionnez un mode de température d'éclairage WARM, NEUTRAL or COOL (chaud, neutre ou froid) Les lumières sous le lit peuvent être temporisées pour 30min, 60min ou 8 heures.
- **Thérapie par le son** : sélectionnez un mode sonore WHITE, PINK OR BROWN (blanc, rose ou marron). La stéréo peut être chronométrée pour 30min, 60min ou 8 heures.
- **Lumière et son** : Sélectionnez à la fois le mode de luminothérapie WARM, NEUTRAL or COOL (chaud, neutre ou froid) et le mode de thérapie par le son WHITE, PINK OR BROWN (blanc, rose ou marron). Une minuterie peut être réglée sur 30 min, 60 min ou 8 heures.

**E. Navigation** : utilisez les flèches pour parcourir les options de menu sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner différentes options.

**F. Retour** : Revient au menu précédent sur l'écran LCD.

**G. Mémoire\*** : programme et enregistre votre position favorite.

**H. Anti-ronflement\*** : Aide à réduire le ronflement en surélevant la tête et en

dégageant les voies respiratoires.

**I. Zero-G®** : Ajuste vos jambes à un niveau supérieur à celui de votre cœur, aidant à soulager la pression exercée sur le bas du dos et à favoriser la circulation.

**J. Articulation de la tête** : S'élève et s'abaisse portion de la tête de la base.

**K. Articulation des pieds** : S'élève et s'abaisse portion du pied de la base.

**L. Position à plat** : abaisse la base à plat

**M. Diminuer le volume** : Diminuer le volume de la barre de son

**N. Augmenter le volume** : Augmenter le volume de la barre de son

**O. Lecture/Pause** : lit et met en pause le son.

### \*Télécommande - programmation pré-réglée

1. Articuler la tête et le pied à la position désirée.

2. Appuyez sur l'un des boutons de pré-réglage et maintenez-le enfoncé [M et Anti-ronflement ] pendant 5 secondes. La position est maintenant enregistrée.

Remarque: Pour rétablir les réglages d'usine des boutons de pré-réglage, maintenez FLAT et ZERO-G® enfoncés simultanément pendant au moins 10 secondes. Les pré-réglages d'origine seront restaurés.

## Pg. 12 - Télécommande JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande d'origine qui est livrée avec l'assemblage est déjà couplée à la base de lit. Aucune action supplémentaire n'est requise. Si la télécommande n'est pas couplée à la base, suivez les étapes ci-dessous.

**ÉTAPE 1** : Débranchez le cordon d'alimentation de votre prise de courant. Attendez 1 minute, puis rebranchez-le dans votre prise de courant. Effectuez l'étape 2 dans les 10 secondes, pendant que le voyant du boîtier de commande clignote.

**ÉTAPE 2** : Appuyez sur le bouton PAIR situé à l'arrière de la télécommande et maintenez-le enfoncé. La touche PAIR s'allume et commence à clignoter. Lorsque la touche PAIR cesse de clignoter, le voyant DEL du boîtier de commande cesse de clignoter. Relâchez le bouton PAIR.

**ÉTAPE 3** : La télécommande est maintenant associée à la base réglable. Testez toutes les fonctions à distance. Si les boutons de la télécommande n'ont pas



d'impact sur les mouvements de la base, répétez le processus.

La télécommande est maintenant jumelée avec la base.

## LE VERROUILLAGE PARENTAL:

**Activer le verrouillage parental :** Pour activer le verrouillage enfant, appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage enfant au dos de la télécommande.

Remarque : Une icône de verrouillage sur l'écran LCD de la télécommande s'allume en vert lorsque la sécurité enfant est active.

**Désactiver le verrouillage parental :** Pour activer le verrouillage enfant, appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage enfant au dos de la télécommande.

Remarque : Une icône de cadenas ouvert apparaît sur l'écran LCD de la télécommande lorsque le verrouillage parental est inactif.

## Pg. 13 - La synchronisation des deux bases (facultatif)

Un cordon de synchronisation est inclus avec la base. Non disponible pour les bases de grandeur Queen, pleine, de taille entière ou pour les bases King divisées. Le cordon de synchronisation relie les deux boîtes de commande à une seule télécommande pour la synchronisation des deux bases.

**ÉTAPE 1 :** Débranchez les bases de la source d'alimentation.

**ÉTAPE 2 :** Branchez ensuite les extrémités mâles du cordon de synchronisation dans le port multifonction de chaque boîtier de commande.

**ÉTAPE 3 :** Rebranchez les bases sur la source d'alimentation. La lumière sous le lit commencera à clignoter, indiquant qu'il est en mode d'appairage.

**ÉTAPE 4 :** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PAIR à l'arrière de la télécommande. Le bouton clignotera pour indiquer que le jumelage est terminé. Le bouton PAIR cessera de clignoter et la lumière sous le lit s'éteindra. La télécommande peut maintenant faire fonctionner la base normalement.

## Pg. 14 - Sangle de raccordement (facultatif)

S'il s'agit d'une installation de base divisée, les attaches de raccordement en plastique sont fournies (une par base), afin de fixer les bases ensemble.

**ÉTAPE 1 :** Une fois les bases placées à l'endroit souhaité, desserrez légèrement les deux pattes de lit afin de pouvoir insérer l'attache sur les boulons de patte, entre la rondelle et le cadre.

**ÉTAPE 2 :** Glissez le côté (a) de l'attache de raccordement sur le boulon de la patte de lit. Faites pivoter l'attache et connectez le côté (b) au boulon de la patte. Fixez

l'attache de raccordement en la tirant vers la gauche.

**ÉTAPE 3 :** Resserrez les pattes de lit. Ne serrez pas excessivement. Utilisez l'attache de raccordement restante sur l'autre extrémité de la base.

## Pg. 15- Sangle de batterie de secours

Pour une utilisation d'urgence uniquement, en cas de panne de courant. Les piles ne doivent pas être utilisées pour le fonctionnement normal du lit.

**ÉTAPE 1 :** Débranchez l'alimentation du cordon d'entrée.

**ÉTAPE 2 :** Connectez la sangle de batterie de secours aux (2) piles alcalines de 9 volts. Ne mélangez pas les piles de marque.

**ÉTAPE 3 :** Connectez l'extrémité de la sangle de batterie de secours au cordon d'alimentation d'entrée qui est attaché au boîtier de commande.

**ÉTAPE 4 :** Utilisez la télécommande pour abaisser la base à plat.

**Remarque :** détachez la sangle de la batterie de secours une fois l'urgence terminée, car le système continuera à être alimenté par les batteries même s'il n'est pas utilisé.

## Pg. 16- Guide d'installation des fixations de la tête de lit

Les fixations de la tête de lit sont des accessoires optionnels et ne sont pas incluses. Une clé à douilles de 9/16" + une clé à molette de 1/2" sont nécessaires pour compléter l'installation.

### ÉTAPE 1 :

Fixez le support de tête de lit.

- Alignez le trou dans la fixation avec la douille en laiton dans laquelle se visse la patte de lit. Maintenez la fixation en place et vissez la patte dans la base jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. **NE VISSEZ PAS TROP FORTEMENT**, car la patte de lit pourrait tourner à vide.
- Alignez la pièce avec le trou dans le cadre (situé vers le pied de la base) et utilisez un boulon court et un écrou pour sécuriser la fixation. Assurez-vous que le boulon est bien serré.

### ÉTAPE 2 :

Attachez l'espaceur en plastique et la fixation en T.

- Mesurez la distance entre les trous de montage sur la tête de lit et installez

l'espaceur et la plaque de fixation pour accueillir la tête de lit.

le numero: 1-888-550-3746

- b. Pour installer le support en T, faites glisser le support en T à travers l'extrémité du support de tête de lit. Alignez le côté plat de la plaque de support en T avec les trous de montage de la tête de lit.
- c. Fixez le support en T en place en insérant deux vis courtes dans le haut du support. Utilisez une clé hexagonale pour serrer les vis.

**ÉTAPE 3** : Vous pouvez maintenant assembler votre tête de lit et la plaque de fixation à l'aide des boulons courts et des écrous restants afin de la relier aux fixations. Les têtes de boulons seront orientées vers l'extérieur. Utilisez une clé à douilles de 9/16" et une clé à molette de 1/2" pour serrer les boulons.

## Pg. 17- Dépannage

Si une ou plusieurs fonctions sur la base de lit ont cessé de fonctionner:

- Vérifier sous la base de lit pour vérifier que les connexions filaires sont sécurisées et qu'il n'y a pas de cordons ou de la literie qui entrave le mouvement de la base.
- Vérifiez que le voyant DEL vert est allumé sur le bloc d'alimentation. (Si aucun voyant ne s'allume), vérifiez que l'entrée et que les cordons d'alimentation sont correctement connectés.
- Débranchez la base pendant 1 heure pour réinitialiser les composants électroniques.
- Branchez la base du lit sur une prise électrique différente, ou vérifiez le courant de la prise avec un autre appareil qui fonctionne (protecteur de surtension électrique mise à la terre est recommandé).
- Retirez et remplacez les piles dans la télécommande et accouplez la télécommande à la base (voir page 12).
- Assurez-vous que la fonction de verrouillage enfant n'est pas activée. Voir page 12 pour plus d'informations.

Si le problème n'est pas résolu en suivant les instructions ci-dessus, notez le numéro de série sur la carte de garantie ou à l'arrière du contrôle à distance et contactez-le

Pour service consommateurs, allez au site web [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) ou appelez

# notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## US Customer Service

Phone US 1-888-550-3746  
Fax US 1-805-979-9399  
Email [info@ergomotion.com](mailto:info@ergomotion.com)  
Web [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com)

© Ergomotion Inc  
V002\_11/2023

Serial Number:

+

+

+

+