

## GAUNTLET THUMB POST ORTHOSIS

Material: Orflight® NS 1.6 mm (1/16”) micro perforation

**Art. no.**    **35810/L (S)**  
                  **35811/L (M)**  
                  **35812/L (L)**

**Indications:** : *Acute MCP arthritis - basal joint osteo arthritis - rheumatoid arthritis - thumb sprain - median nerve palsy*


**Indicaties:** *MCP verstuiking (skiërsduim) - rhizartrorse - reuma - nervus medianus letsels*

**Indications:** *Arthrité de la MP - rhizartrorse - polyarthrite rhumatoïde - entorse du pouce - atteinte du nerf médian)*

**Indikationen:** *Akute MCP-Arthritis - Rhizartrorse - rheumatoide Arthritis - Medianus-Lähmung*

<p>This product is made of a Low Temperature Thermoplastic material and can be moulded directly on the patient. Before starting, read the instructions for use (ref. No. 31001) of the basic product mentioned above and take all the necessary precautionary measures.</p> <p>This pattern is NOT SUITABLE for the following applications: - fractures (scaphoïde) - acute De Quervain tendinitis - first webspace contractures</p> <p>It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.</p> <p>For additional copies, please contact your local distributor or send an e-mail to <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a></p>	<p>Dit product is vervaardigd uit een lage temperatuur thermoplastisch materiaal dat direct op de patiënt kan worden gevormd. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzingen (ref. nr. 31001) van het hierboven aangeduide basisproduct en neem de voorzorgsmaatregelen in acht die daarbij horen.</p> <p>Dit spalkpatroon is NIET GESCHIKT voor volgende toepassingen: - fracturen (os naviculare scaphoïdeus) - acute De Quervain tendinitis - commissure contracturen</p> <p>Het is verboden veranderingen aan te brengen in deze tekst zonder voorafgaande toestemming van Orfit Industries.</p> <p>Indien u bijkomende exemplaren wenst, neem dan contact op met de verdeler in uw land of stuur een e-mailbericht naar <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a>.</p>
<p>Ce produit est fabriqué dans un matériel thermoformable à basse température, qui est formé directement sur le patient. Lisez d'abord attentivement les instructions d'utilisation (réf. no. 31001) pour le produit de base mentionné ci-dessus et respectez les précautions d'usage y référant.</p> <p>Ce patron n'est PAS INDIQUE pour les cas suivants: - fractures (scaphoïde) - tendinite aiguë de De Quervain - rétraction de la première commissure</p> <p>Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sauf accord préalable d'Orfit Industries.</p> <p>Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, prenez contact avec notre distributeur dans votre pays ou envoyez votre demande par e-mail à <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a></p>	<p>Dieses Produkt ist aus ein Niedrigtemperatur Thermoplast hergestellt und darf unmittelbar auf den Patienten angelegt werden. Lesen Sie zuerst andächtig die Gebrauchsanweisungen (Ref. Nr. 31001) die zu dem o.e. Basisprodukt gehören und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.</p> <p>Dieses Dessin EIGNET SICH NICHT für die nachstehenden Indikationen: - Frakturen (Scaphoïdeus) - akute De Quervain Sehnenentzündung - Retraktionskommissure</p> <p>Es ist verboten den Text zu ändern, ohne vorhergehende Zustimmung von Orfit Industries.</p> <p>Falls Sie mehrere Exemplare wünschen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verteiler in Ihrem Land, oder schicken Sie uns einen E-Mail Bericht nach der Adresse <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a>.</p>

## SIZING

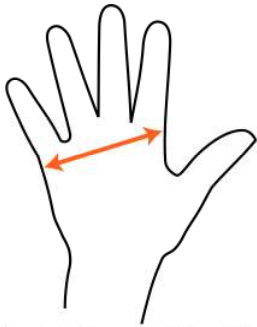

### SIZING


Measure the total hand width at the MCP joints of the 2nd to 5th finger.

60-70 mm - "2<sup>1</sup>/<sub>5</sub>" - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" = **SMALL**

80-90 mm - 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" - 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" = **MEDIUM**

100-110 mm - 4" - 4<sup>3</sup>/<sub>10</sub>" = **LARGE**

## METHOD OF APPLICATION

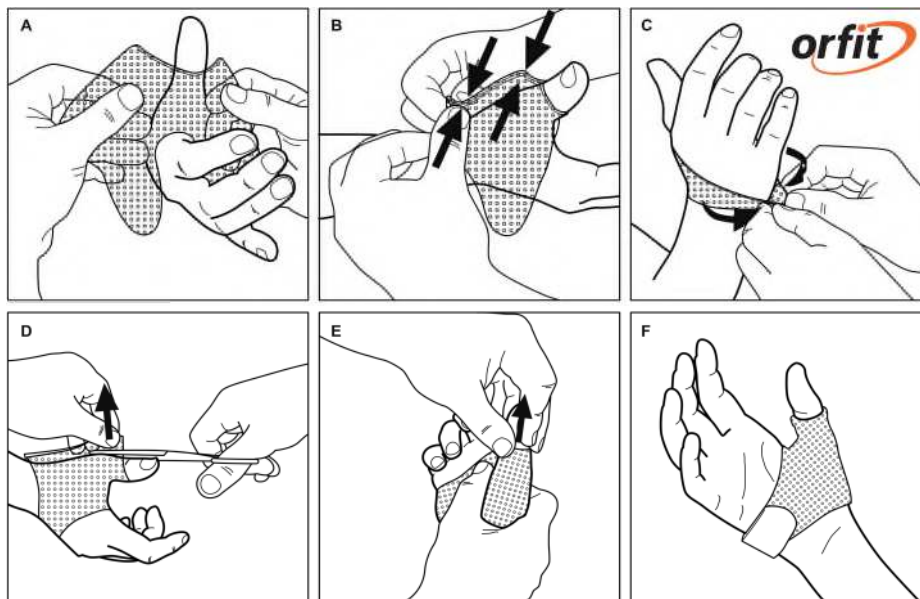

### Note:

It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.  
ORFILIGHT® is a registered trademark of ORFIT INDUSTRIES N.V.



**ORFIT INDUSTRIES**  
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium  
T (+32) (0)3 326 20 26  
welcome@orfit.com

[www.orfit.com](http://www.orfit.com)



Ref. No. 35810L-35811L-35812L ORFILIGHT  
VERSION 6  
LAST UPDATE: 26/06/2021  
REVISION DATE: 26/06/2023


## GAUNTLET THUMB POST ORTHOSIS

Material: Orflight® Black NS 1.6 mm (1/16”) micro perforation

<p><b>Art. no.</b>    <b>35810Z/L/NS (S)</b>  <b>35811Z/L/NS (M)</b>  <b>35812Z/L/NS (L)</b></p>	<p><b>Indications:</b> : <i>Acute MCP arthritis - basal joint osteo arthritis - rheumatoid arthritis - thumb sprain - median nerve palsy</i>  <b>Indicaties:</b> <i>MCP verstuiking (skiërsduim) - rhizartrose - reuma - nervus medianus letsels</i>  <b>Indications:</b> <i>Arthrité de la MP - rhizarthrose - polyarthrite rhumatoïde - entorse du pouce - atteinte du nerf médian)</i>  <b>Indikationen:</b> <i>Akute MCP-Arthritis - Rhizarthrose - rheumatoide Arthritis - Medianus-Lähmung</i></p>
--	--

<p>This product is made of a Low Temperature Thermoplastic material and can be moulded directly on the patient. Before starting, read the instructions for use (ref. No. 31001) of the basic product mentioned above and take all the necessary precautionary measures.</p> <p>This pattern is NOT SUITABLE for the following applications:  - fractures (scaphoïde)  - acute De Quervain tendinitis  - first webspace contractures</p> <p>These instructions were made up in accordance with the European Directive 93/42/EEC for Medical Devices. It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.</p> <p>For additional copies, please contact your local distributor or send an e-mail to <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a></p>	<p>Dit product is vervaardigd uit een lage temperatuur thermoplastisch materiaal dat direct op de patiënt kan worden gevormd. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzingen (ref. nr. 31001) van het hierboven aangeduide basisproduct en neem de voorzorgsmaatregelen in acht die daarbij horen.</p> <p>Dit spalkpatroon is NIET GESCHIKT voor volgende toepassingen:  - fracturen (os naviculare scaphoïdeus)  - acute De Quervain tendinitis  - commissure contracturen</p> <p>Deze gebruiksaanwijzingen werden opgesteld in de geest van de Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Het is verboden veranderingen aan te brengen in deze tekst zonder voorafgaande toestemming van Orfit Industries.</p> <p>Indien u bijkomende exemplaren wenst, neem dan contact op met de verdeler in uw land of stuur een e-mailbericht naar <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a>.</p>
<p>Ce produit est fabriqué dans un matériel thermoformable à basse température, qui est formé directement sur le patient. Lisez d'abord attentivement les instructions d'utilisation (réf. no. 31001) pour le produit de base mentionné ci-dessus et respectez les précautions d'usage y référant.</p> <p>Ce patron n'est PAS INDIQUE pour les cas suivants:  - fractures (scaphoïde)  - tendinite aiguë de De Quervain  - rétraction de la première commissure</p> <p>Ces instructions d'utilisation ont été rédigées dans l'esprit de la Directive Européenne 93/42/CEE concernant les aides techniques médicales. Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sauf accord préalable d'Orfit Industries.</p> <p>Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, prenez contact avec notre distributeur dans votre pays ou envoyez votre demande par e-mail à <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a></p>	<p>Dieses Produkt ist aus ein Niedrigtemperatur Thermoplast hergestellt und darf unmittelbar auf den Patienten angelegt werden. Lesen Sie zuerst andächtig die Gebrauchsanweisungen (Ref. Nr. 31001) die zu dem o.e. Basisprodukt gehören und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.</p> <p>Dieses Dessin EIGNET SICH NICHT für die nachstehenden Indikationen:  - Frakturen (Scaphoideus)  - akute De Quervain Sehnenentzündung  - Retraktionskommissure</p> <p>Diese Gebrauchsanweisungen wurden im Geiste der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG für medische Hilfemittel aufgestellt. Es ist verboten den Text zu ändern, ohne vorhergehende Zustimmung von Orfit Industries.</p> <p>Falls Sie mehrere Exemplare wünschen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verteiler in Ihrem Land, oder schicken Sie uns einen E-Mail Bericht nach der Adresse <a href="mailto:welcome@orfit.com">welcome@orfit.com</a>.</p>

## SIZING

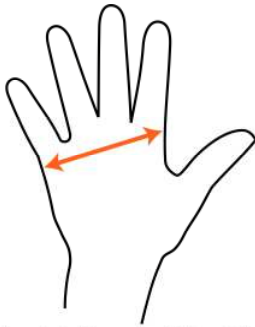

### SIZING


Measure the total hand width at the MCP joints of the 2nd to 5th finger.

60-70 mm - "2<sup>1</sup>/<sub>5</sub>" - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" = **SMALL**

80-90 mm - 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" - 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" = **MEDIUM**

100-110 mm - 4" - 4<sup>3</sup>/<sub>10</sub>" = **LARGE**

## METHOD OF APPLICATION

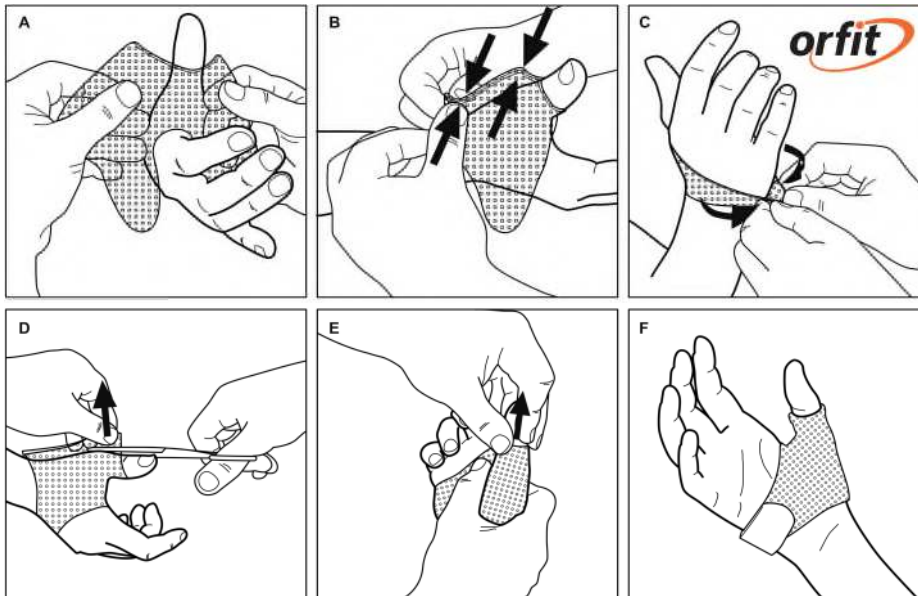

### Note:

It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.  
ORFLIGHT® is a registered trademark of ORFIT INDUSTRIES N.V.



**ORFIT INDUSTRIES**  
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium  
T (+32) (0)3 326 20 26  
welcome@orfit.com

[www.orfit.com](http://www.orfit.com)



Ref. No. 35810ZLNS-35811ZLNS-35812ZLNS  
ORFLIGHT BLACK NS  
VERSION 2  
LAST UPDATE: 06/05/2021  
REVISION DATE: 06/05/2023