

ERGOSportive™



OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Actual product appearance and functionality may vary from photographs, illustrations and descriptions included in this manual.
L'apparence et les fonctionnalités du produit peuvent différer de la photo, des illustrations et des descriptions incluent dans ce manuel.

Table of Contents

Safety Precautions and Usage Statements	1-4
Parts List	5
Base and Remote Overview	6
Quick Reference Guide	7
Installation Guide	8-9
Remote Control	10
Remote Control Pairing	11
Battery Backup Strap	12
Syncing Two Bases (Optional)	13
Controlling LED Light Separately (Optional)	14
Connecting Strap (Optional)	15
Headboard Installation Guide (Optional)	16-18
Assembling Video	19
ErgoSportive™ APP	20
Troubleshooting	21

Table des matières

Consignes de sécurité et d'utilisation	22-25
Liste des pièces	26
Vue d'ensemble : lit et télécommande	27
Guide de référence rapide	28
Guide d'installation	29-30
Télécommande	31
Synchronisation de la télécommande	32
Sangle pour piles de secours	33
Synchronisation de deux lits (facultatif)	34
Contrôler la lumière DEL séparément (facultatif) ..	35
Sangle de raccordement (facultatif)	36
Installation de la tête de lit (facultatif)	37-39
Vidéo d'assemblage	40
Application ErgoSportive™	41
Dépannage	42

Safety Precautions and Usage Statements

Attention: Important Safety Disclaimers

Read all instructions before using your adjustable base. Save these instructions.

TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY:

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (strongly recommended). Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces. Never operate the base when the air openings are blocked. Keep air openings free of lint, hair and the like. Do not drop or insert any object into any opening. Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or it has been dropped into water. Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets. Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

PETS AND CHILDREN:

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on or under the bed. Children should not operate the bed base without adult supervision.

PACEMAKERS:

Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with devices such as pacemakers, ICD's and any other device sensitive to magnetic fields. It is STRONGLY recommended that owners of such medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium MAGNETS. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any product that create a vibrating movement and may affect the pacemaker. Please consult your physician before using the massage feature.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS:

Ergomotion adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

ADDITIONAL SAFETY FEATURES

Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

Manual operation – If something gets caught in the platform when flattened, you can manually raise the platform up by lifting at either the head or foot to relieve pressure and allow for release.

Emergency stop – Stop the motion of the platform by pressing any button on the remote control.

Power outage – Use the “Emergency Battery Backup Strap” as a temporary power source to get the base to a desired position. Instructions on how to operate the Battery Backup Strap are on the Emergency Battery Backup page(s).

Safety Precautions and Usage Statements

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This contact may result in metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position. In normal base operation, the wheels, which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

MATERIALS


Ergomotion adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create an audible sound.

MESSAGE OPERATION AND LOCATION ENVIRONMENT

The massage feature will emit a tone during operation. This is normal. As the massage intensity level is increased, the tone will intensify. The volume of this tone is directly related to the location environment. For example, when demonstrated in a show room, the surrounding environmental noise will cover some of the massage noise. However, when installed in a home setting with wooden floors, carpeted or not, the massage volume will be more noticeable. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base. It is possible to experience vibration or noise from the exterior bed frame, headboard brackets, headboards or footboards if

mounting bolts are not firmly tightened.

Levels 1-2 of massage intensity represent the revolutions of the motor per minute. Level 2 provides the maximum number of RPMs. However, this does not mean that the feeling of vibration is the strongest. Depending on the mattress material, thickness, and positioning of the user, the feeling of vibrations will differ. We encourage the user to find the massage intensity setting that suits them best. It is important to understand the physics of vibrations. Just as an engine may run rough during idle, as the RPMs increase, the vibrations change concurrently.

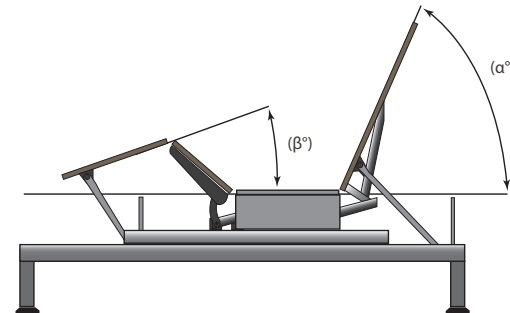

TOLERANCE

All Ergomotion adjustable foundations, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure bases will operate within these standards during normal operating use. Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 120kg distributed load. The angle (designated " α " in figure 1) between the back section and the flat section

Safety Precautions and Usage Statements

for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $1\frac{1}{2}''$.

The angle (designated “ β ” in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $\frac{3}{4}''$.

Any adjustable foundation deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer’s quality control standards.

THAT “NEW PRODUCT” SMELL:

Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this can come from our material manufacturing process. This smell is normal and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the environment.

BREAK IN PERIOD:

You can speed up the break-in period by simply spending time in the adjustable bed through activities such as reading, watching TV or playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature changes. Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

PAIRED OPERATION:

When operating a “paired” split base setup there may be a time latency up to 1.5 seconds between each bases articulation.

WEAR AND TEAR:

Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.

FABRIC CARE:

To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30cm (12 inches) away from direct heat sources. For a deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

PRODUCT RATINGS:

The lift motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty. The massage motors are not designed to operate continuously for more than 30 minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for 30 minutes after automatic massage shut off before restarting.

WEIGHT LIMITS:

This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds / 340 kg inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

Safety Precautions and Usage Statements

IMPORTANT DO'S AND DON'TS

DO:

- Plug your adjustable base into a power surge protector.
- Evenly distribute weight when sleeping in a split setup. Uneven distribution of weight can cause the base to raise unevenly.
- Call Customer Service for any technical issues. Do not try to force the base down, this can damage the motors or frame.
- Use mild soap and water to clean your adjustable base if staining occurs.
- Keep in mind that adjustable bases are recommended to be used with adjustable friendly mattresses.
- Lower to the flat (horizontal) position after use and in between presets.
- Register your warranty as soon as your adjustable base has been delivered.

DON'T:

- Sit on corners/edges of base, this may warp the frame, struts or foam.
- Tilt the base on its side. This can damage the legs and/or leg screws.
- Stand or jump on the adjustable base at any time, this can damage the frame and motors.
- Drag the base to move it. Dragging the base could damage the frame, strip the nut/bolts or break the legs. Purchase castors if you plan on moving your base routinely.
- Enter and exit the adjustable base with the head and/or foot in the articulated position. You must always enter or exit your adjustable in the flat (horizontal) position.
- Tinker with or modify base. This will void the warranty.

- Press down on the head or foot while actuated can damage frame and motors.
- Do not use mattresses that contain more than 5cm of latex.

FCC Compliance:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Parts List

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for.

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.












- A) Wireless Remote Control x1 and AAA Batteries x3
- B) Legs x6
- C) Mattress Retainer Bar* x2
- D) Power Cord
- E) Power Supply
- F) Battery Backup Strap
(9 volt alkaline batteries not included)
- G) SmartSync® Cord‡
- H) Connecting Strap‡*
- I) C Clamps x2
- J) Long Bolts x4, Washers x8, Nuts x4
- K) 13 MM Outer Hexagonal Wrench x1,
5 MM Hex wrench x1



Misc Parts (not included):

- L) Surge Protector
- M) 9 Volt Alkaline Batteries x2



* These items are attached to the base for shipping purposes. Carefully remove from base and set aside.

‡ Only included in Twin Long and Split King bases.

A) 	B) 	C)* 
D) 	E) 	F) 
G) ‡ 	H) ‡* 	
I) 	J) 	K) 

MISC Parts (NOT INCLUDED)	
L) 	M) 

Base and Remote Overview

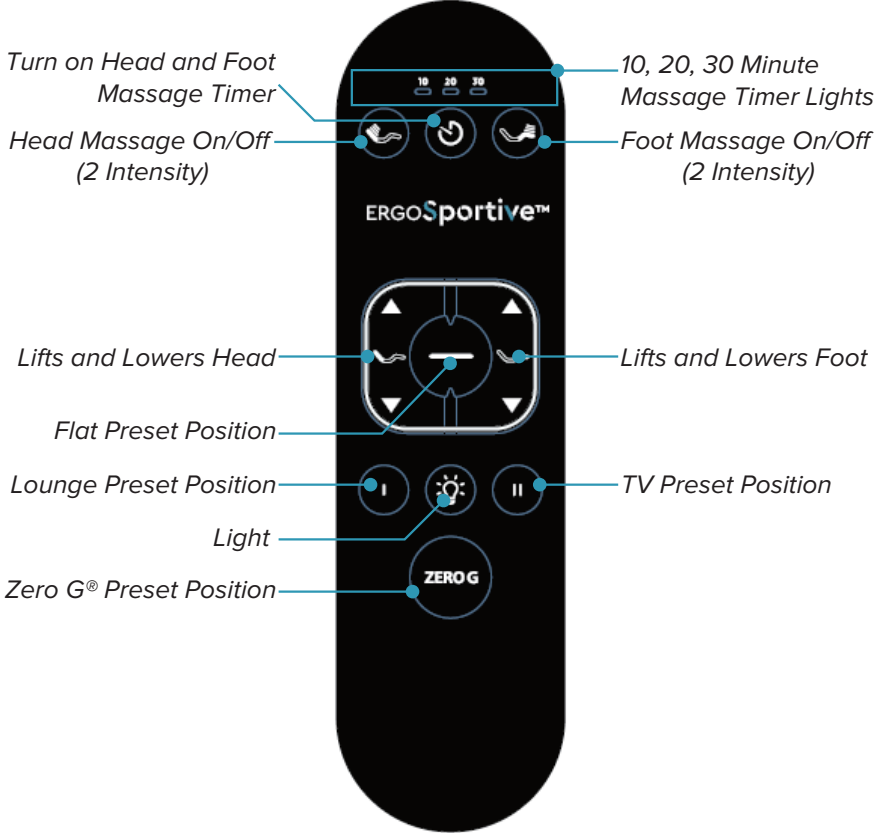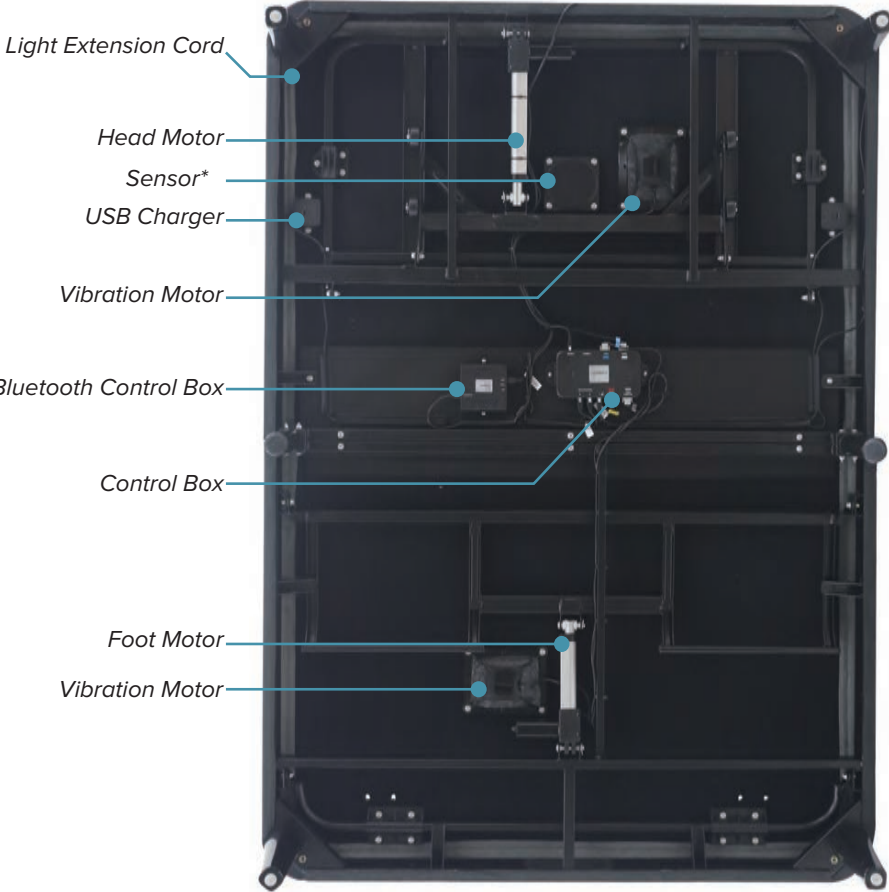


*Note: Queen bed includes two sensors.

Quick Reference Guide

Not to scale. For illustration purposes only. Read all instructions before beginning installation.

ELECTRONICS OVERVIEW

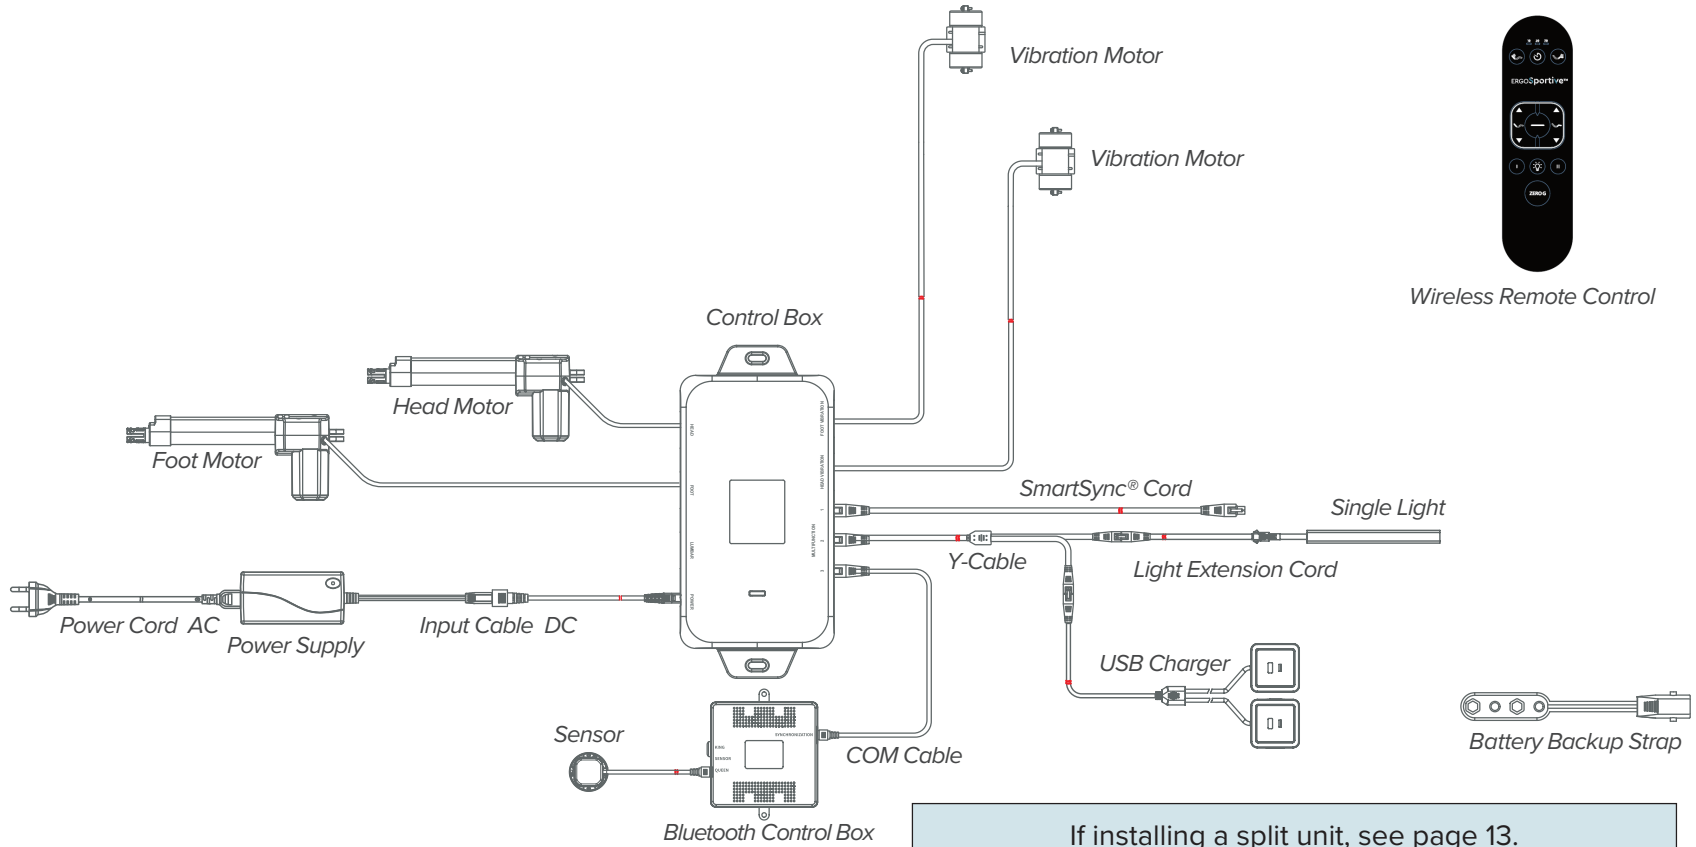


Installation Guide

Always use two people when setting up the base.

STEP 1

Remove the bed from box, and keeping the bottom-side facing up.

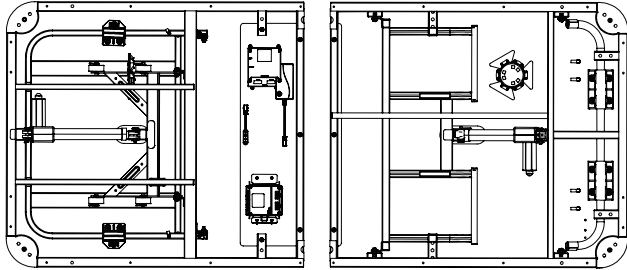

STEP 2

Connect the frames together, slide C-clamp over the frame connections (Refer to Fig B) in the middle of both sides of the base.

Fig A





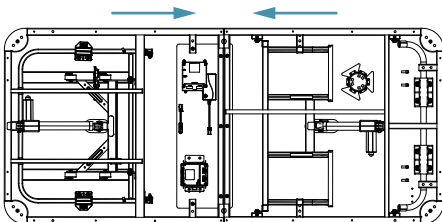


Fig B

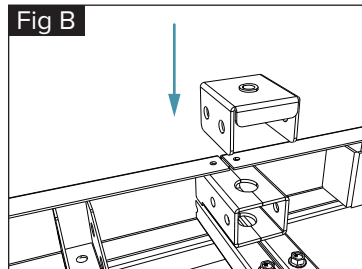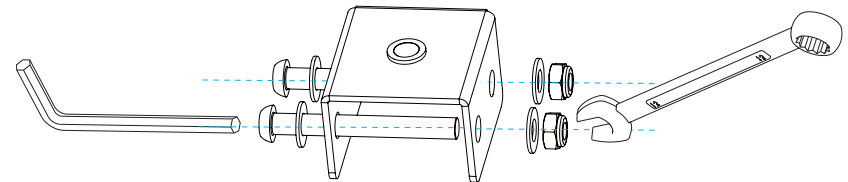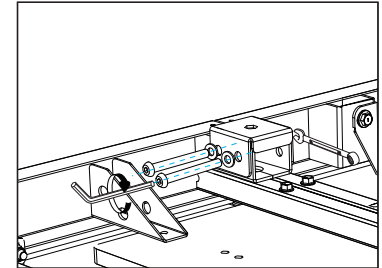

STEP 3

Insert two long bolts through a washer before inserting them through the holes on the side of the C-Clamp. Using inner hexagon wrench.

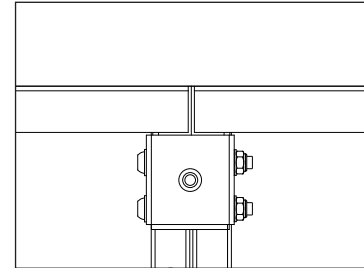

STEP 4 (Optional)

To install the legs, thread the washer over the bolt of the leg with the recessed side facing the leg. Insert each of the four tapered legs on each corner of the frame using the bolt hole nearest the long edge of the bed. Insert each of the two cylindrical (round) legs on the frame in the center edge of bed. Tighten the legs to the base by hand. **Do not over tighten.**

Note: If you are installing the ErgoSportive on an existing platform or bed frame with slats, it is not necessary to install the legs.

Installation Guide

STEP 5

To sync two bases see detailed installation instructions on page 13.

Locate the Battery Backup Strap and set it aside. Be sure that it is accessible after the base is set up.

STEP 6

Uncoil the input Power Cord (connected to Control Box's power port) and plug into Power Supply.



STEP 7

Uncoil the Power Cord and connect to the Power Supply. Place Power Supply on the ground and extend from the base. Ensure that the Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



STEP 8

Carefully flip the base over.

Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs (if used).

STEP 9

Plug the power cord into a power source.

A surge protector is recommended.

STEP 10

The remote need be operated within 10 seconds of powering on the bed to ensure successful pairing. Quickly test remote functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

STEP 11


Install mattress retainer bars by inserting both ends of the mattress retainer bar into the holes on the platform and laying the bars down with curved side facing up.







Setup is now complete! Test all functions on remote.

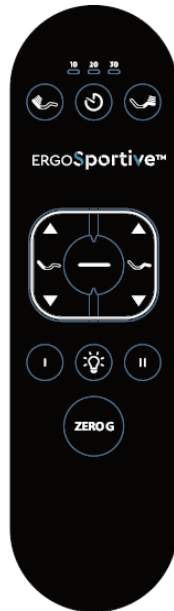Remote Control

Remote Control arrives paired to the adjustable base.
Three (3) AAA batteries are required to operate the remote.








MESSAGE FEATURE

-  The HEAD button will turn on the head massage. Cycle through 2 massage intensities.
-  The FOOT button will turn on the foot massage. Cycle through 2 massage intensities.
-  Message timer. Adjust the massage timing for 10 mins, 20 mins, or 30 mins.
-  **10** The light on the top of the remote indicates a 10, 20 or 30 minute timer setting. Massage will automatically shut off after 10 minutes if the massage timer isn't set.

ADJUST

-  The HEAD ▲ ▼ arrows lift and lower the head section of the base.
-  The FOOT ▲ ▼ arrows lift and lower the foot section of the base.

ONE TOUCH BUTTONS

-  One touch Zero G® preset position. Zero G® adjusts your legs to a higher level than your heart helping to improve and promote circulation.
-  One touch FLAT preset position.
-  One touch lounge preset position.
-  One touch TV preset position.
-  Long press 5 seconds to adjust brightness.

TO PROGRAM THE PRESET POSITIONS:

Articulate the head and foot to your desired position. Next, press and hold one of the preset buttons [I, II] for 5 seconds. The position is now saved.

NOTE: To restore the preset buttons back to their original factory settings, hold **FLAT** and **ZERO G** simultaneously for at least 5 seconds. The original presets will be restored.


Remote Control Pairing

Remote Pairing

The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the base, follow the steps below.

STEP 1

Unplug the Power Cord from your power outlet. Wait 1 minute, then plug it back in to your power outlet. Perform Step 2 within 10 seconds, while the control box light is illuminating.

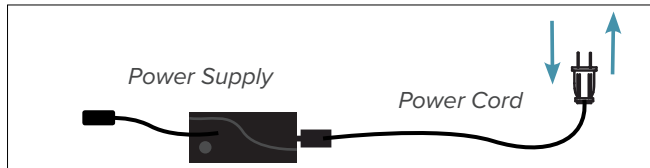

STEP 2

Press and hold the PAIR button on the back of the remote. The PAIR button will illuminate and start to flash. When the PAIR button stops flashing, the Pair LED light on the control box will stop flashing. Release the PAIR button.



STEP 3

The remote is now paired to the adjustable base. Test all remote functions. If the remote buttons do not impact the adjustable base movements, please repeat the process again.

Battery Backup Strap

For emergency use only, in case of a power outage.

Batteries are not to be used for normal operation of the bed.

STEP 1

Disconnect the Power Supply from the input power cord.


STEP 2

Connect the Battery Backup Strap to the (2) Alkaline 9 Volt batteries. Do not mix brand name batteries.



STEP 3

Connect the end of the Battery Backup Strap to the input power cord that is attached to the control box.

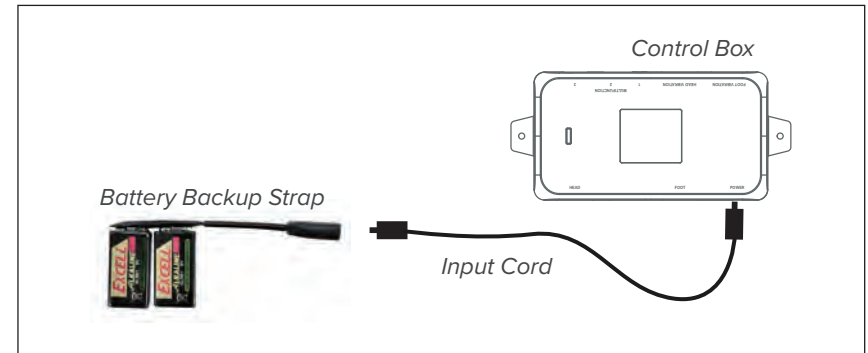

STEP 4

Use the remote to return the base to a flat position.

Note: Detach the Battery Backup Strap and reconnect the power supply after the emergency is over, as the system will continue to draw power from the batteries even if not in use.

Syncing Two Bases (Optional)

A SmartSync® Cord is included with the base. Only available on select models.

The SmartSync® Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases. Please connect the synchronization cable before installing the headboard.

STEP 1

Unplug bases from power source.

STEP 2

Connect the SmartSync® Cord to the Multifunction port of each Control Box.


STEP 3

Plug bases back into the power source.

STEP 4

Check to ensure all cords are securely attached. Both remotes will now operate both bases simultaneously.

The system is now linked. Pressed buttons on either remote will control the two bases simultaneously.

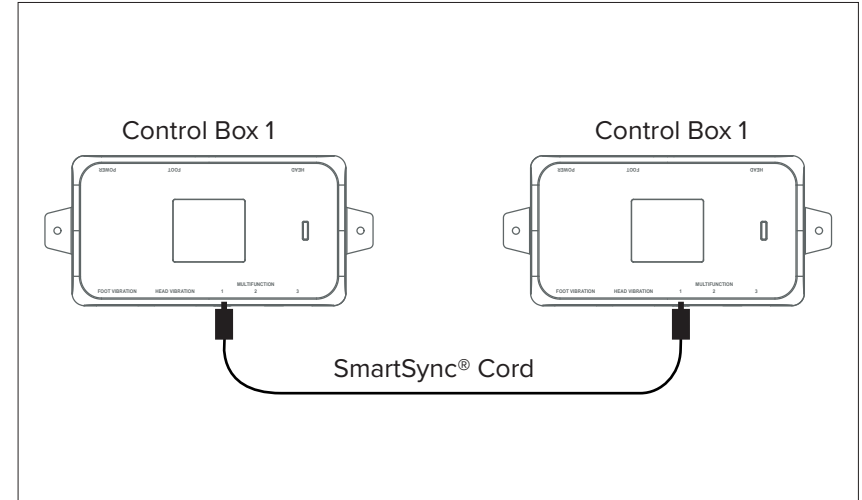

PERFORMANCE NOTES

If bases become mismatched, returning the bases to the flat positions will re-sync the mechanical positions.

Controlling LED Light Separately



This page is intended to explain how to enable both remotes to control the light strip when the sync cord is unplugged. Only applied on Split King bed.

STEP 1

Unplug the synchronization cable of bed A and bed B.

STEP 2

Press and hold the flat button of both A and B remote until the A and B remotes' lights are flashing, the light will stop flashing when the pairing is complete.

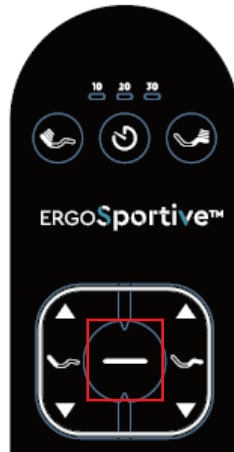

STEP 3

If the remote lights are flashing for a long time, it means the pairing has failed, wait 20 seconds for the light to stop flashing. Then repeat step 2.


Connecting Strap (Optional)

**Connecting straps are secured to the base frame upon delivery.
Legs are required for the installation of the connecting straps.**

STEP 1

*Legs are required for the installation of the headboard brackets.
To purchase legs, please contact **Customer Service:**
support@ergosportive.com*

With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.

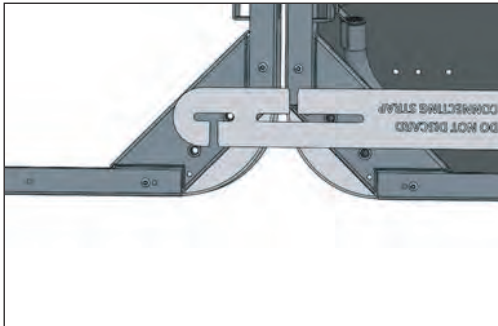

STEP 2

Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt. Swing the strap and connect side (b) to the opposite leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.








STEP 3

Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.

Headboard Installation Guide

Parts List:

All the following spare parts are not included in the bed, they are packaged with headboard. It can also be sold as an accessory if required.



A) 	B) 	C) 
Headboard Bracket X2	Headboard Spigot X2	Hexagon Screw X6
D) * 	E) 	
5 MM Hex Wrench X1	Headboard Bracket X2	

* The 5 MM hex wrench is included in the head bracket fitting package.

Note that part B is for TXL and Queen sizes. Part E is for King size.

STEP 1


Use two hexagon screws to attach the head bracket female buckle on the bed frame.

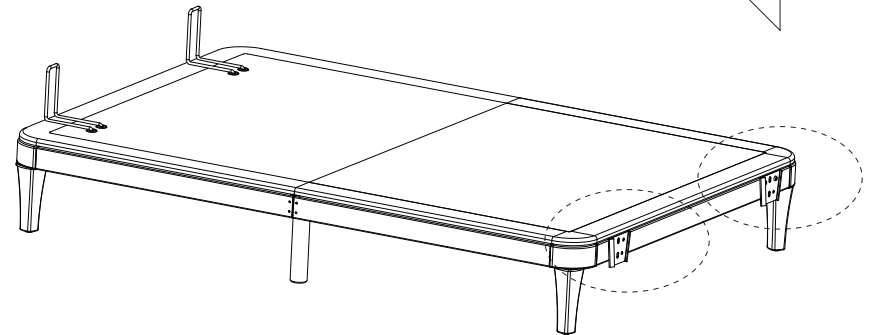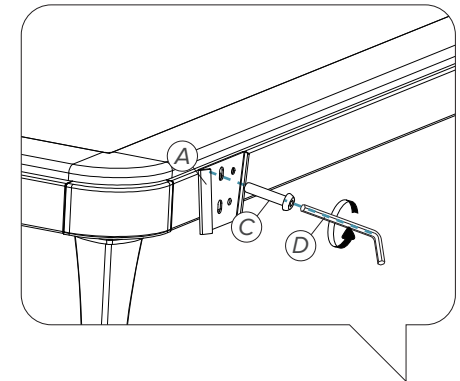


Headboard Installation Guide

STEP 2 (For King headboard only)

Remove four hexagon screws from the pre-install headboard spigots.

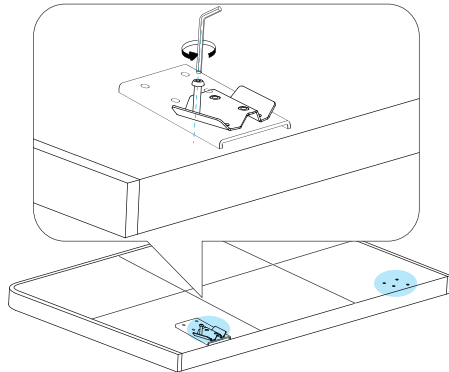


Reattach bracket to headboard using the four uppermost holes with screws removed in previous step. Fasten securely.

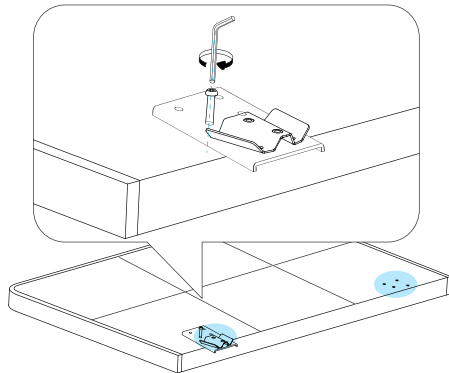

STEP 3


It takes two people to lift the headboard align the male buckle of the headboard with the female buckle and insert it vertically.

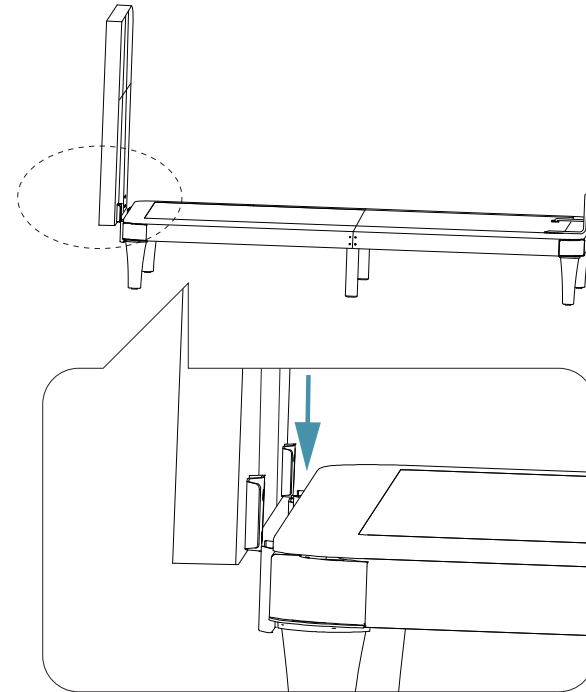

Headboard Installation Guide


STEP 4

Power on the bed and raise the head. Insert a hexagon screw and tighten to firmly attach the headboard to the bed base. Note that it may be necessary to slightly lift the headboard to align the screw.

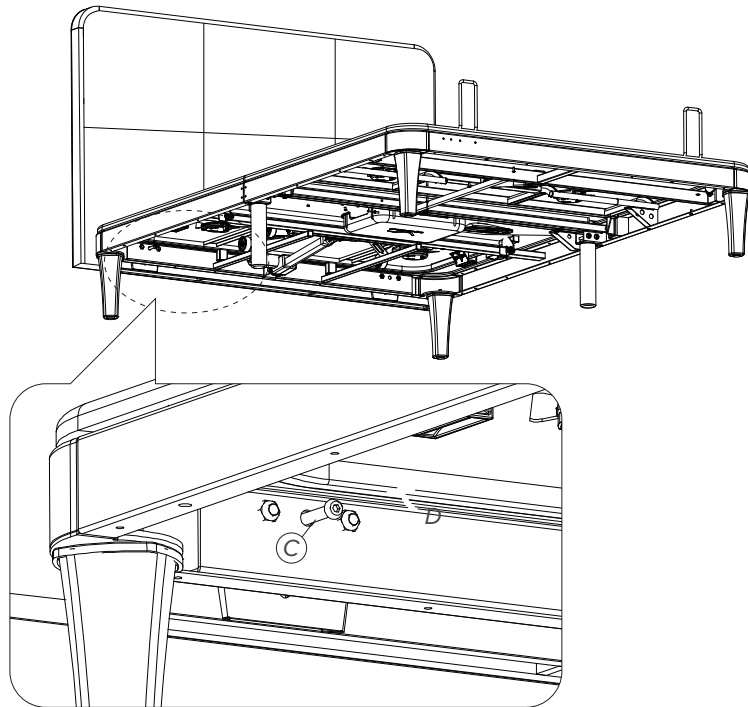

STEP 5

Disconnect power to the bed. Connect the LED light. Reconnect power to the bed.

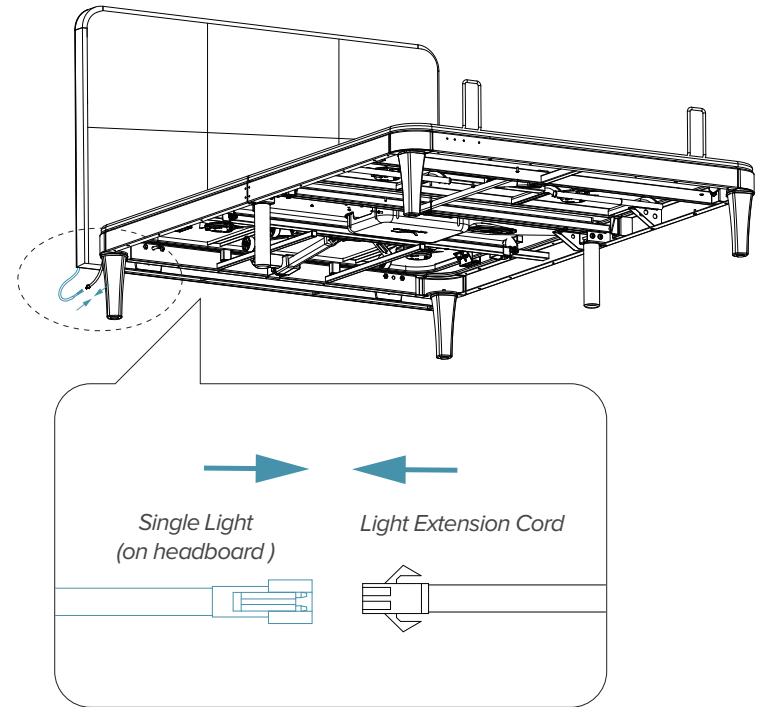

Assembling Video



Please scan the QR code for the Assembling video

ErgoSportive™ APP

STEP 1 DOWNLOAD APP

Download ErgoSportive™ App.

Download Android Version of the APP from the Google Play.

Download iOS version of the App from the Apple Store.



STEP 2 REGISTRATION

Open the ErgoSportive™ APP, click on the **"Sign Up"** button on the sign in page and follow the instructions to complete the registration. Once you have registered, you will be automatically logged in and enter the process of connecting to the ErgoSportive™.

STEP 3 SIGN IN

In order to identify yourself during subsequent logins, simply enter your email and the password created during your registration, and click on **"Sign in"**.

STEP 4 CONNECT SMART BED

Connect Smart Bed

Open the ErgoSportive APP, select the **"Settings"** tab, click **"Bed Settings"** to enter the smart bed settings page, then click the **"Connect a new bed"** button.

Start Connection

Scan the QR code of the bed or click on the **"Search beds"** button to select your bed and connect it.

Finish Connection

Enter the connection phase and when the progress is 100%, the connection is complete.

Select Data Switch

Select the on/off data switch and you can turn the data storage switch on or off as required.

Select The Bed Side (Double Bed)

Choose the side of the bed you sleep, e.g. Facing the bed, choose to sleep on the left, on the right, or with one person in a double bed.

Calibrate your ErgoSportive™

In order to obtain accurate data, your gender, date of birth, height, weight and mattress thickness are required to complete the calibration. Note, it may take up to seven days for your ErgoSportive™ to fully calibrate, during which time sleep metrics will continue to improve.

Authorize The Garmin® Account

Authorize your Garmin® account in order to access Garmin® data, you can choose to skip this step first.


MORE DETAILS

Please Scan QR code to see more function information and operation.



NOTE

Sleeping position may affect data collection. To ensure the most accurate data, it is recommended to sleep in the center of the bed in single beds or on your selected side in double beds (center if sleeping alone). Sleeping too close to the edge or other unconventional sleeping position will affect the accuracy of date.

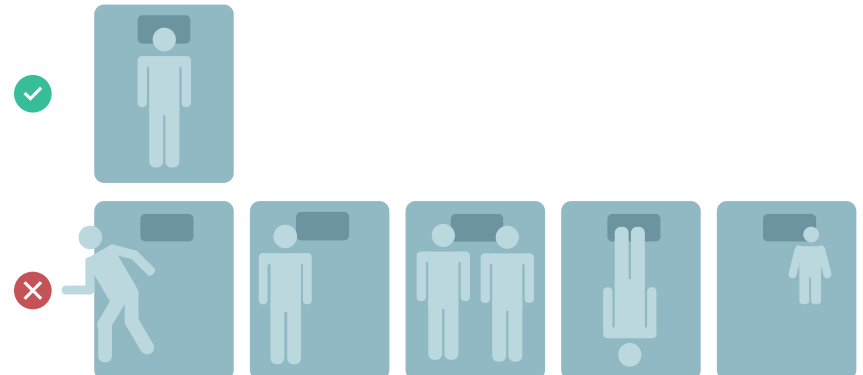

Troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the green LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 minute to reset the electronic components.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).
- Remove and replace full batteries in the remote control and re-pair the remote to the base (see page 11).

If issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote and contact

ErgoSportive Customer Service: support@ErgoSportive.com

Consignes de sécurité et d'utilisation

Attention : Remarques importantes relatives à la sécurité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre lit ajustable. Conservez ces instructions.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE

Pour optimiser la sécurité et l'efficacité, branchez la base ajustable sur un parasurtenseur (non fourni). La base ajustable ne doit être branchée qu'à une prise murale ou à un parasurtenseur (fortement recommandé). Débranchez toujours la base ajustable de la prise électrique avant de procéder à l'entretien de toute pièce qu'elle comporte. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez la base ajustable avant de la nettoyer. Pour la déconnecter en toute sécurité, assurez-vous qu'elle est à plat avec tous les moteurs éteints et débranchez-la de la source d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Ne jamais faire fonctionner la base lorsque les ouvertures d'air sont obstruées. Maintenir les ouvertures d'air libres de poussière, cheveux et autres. Ne laissez pas tomber ou n'insérez aucun objet dans les ouvertures. Cessez d'utiliser la base ajustable et contactez un centre de dépannage qualifié si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils ont été immergés dans de l'eau. N'utilisez cette base ajustable que dans le cadre de l'utilisation prévue décrite dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Une surveillance constante est requise lorsque le lit ajustable est utilisé par ou près d'enfants, de convalescents, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques. Une mauvaise connexion de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique, d'incendie électrique ou un mauvais fonctionnement de ce lit. Si la fiche n'est pas adaptée à votre prise, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adaptée. Toute modification non autorisée ou le fait de ne pas utiliser une prise murale ou un parasurtenseur peut annuler la garantie en ce qui concerne la partie électrique.

ENFANTS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage, car ils peuvent

entraîner un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, il est déconseillé aux enfants et aux petits animaux de compagnie de jouer sur ou sous le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser la base ajustable sans la surveillance d'un adulte.

STIMULATEURS CARDIAQUES

Certains produits contiennent des AIMANTS en néodyme qui peuvent interférer avec des appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les DAI et tout autre appareil sensible aux champs magnétiques. Il est FORTEMENT recommandé aux utilisateurs de ces dispositifs médicaux de consulter leur médecin avant d'utiliser des produits qui contiennent des AIMANTS en néodyme. Il est également possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent à tort les vibrations de la fonction de massage facultative comme un mouvement ou un exercice. Il s'agit d'une situation fréquente avec tout produit qui crée un mouvement vibrant et qui peut affecter un stimulateur cardiaque. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la fonction de massage.

UTILISATION À DOMICILE ET NORMES HOSPITALIÈRES

Les bases ajustables Ergo sont conçues uniquement pour une utilisation à domicile. Ce lit ajustable n'a pas été conçu comme un lit d'hôpital et n'est pas destiné à répondre aux normes hospitalières. N'utilisez pas ce lit avec un équipement d'oxygénothérapie de TYPE TENTE ou à proximité de gaz explosifs.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Les roulettes (en option) sont équipées de roues verrouillables pour éviter tout mouvement indésirable. Même lorsque verrouillées, il est possible que les roulettes glissent. Les moteurs de la tête et du pied utilisent la gravité afin de ramener le lit à plat, plutôt qu'une force exercée vers le bas, minimisant ainsi les points de pincement.

Consignes de sécurité et d'utilisation

Fonctionnement manuel – Si quelque chose se coince dans la plateforme lorsqu'elle est à plat, il est possible de la relever manuellement en la soulevant au niveau de la tête ou du pied pour relâcher la pression et la décoincer.

Arrêt d'urgence – Interrompt les mouvements de la plateforme en appuyant sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Coupage de courant – Utilisez la sangle pour piles de secours comme source d'alimentation temporaire pour amener le lit ajustable à la position souhaitée. Les instructions d'utilisation de la sangle pour piles de secours se trouvent sur la page décrivant cet accessoire.

MÉCANISMES DE LEVAGE/ABAISSMENT

La fonction de levage/abaissement émet un bourdonnement minimal pendant le fonctionnement. Ce bruit est normal. Pendant le fonctionnement, les roulettes du bras de levage entrent en contact avec le support de la plateforme de la base ajustable. Ce contact peut entraîner un contact métal sur métal ou métal sur plastique. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. En cas de bruit ou de vibrations excessifs, inversez le mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base à l'aide de la télécommande. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation du lit ajustable sur la position opérationnelle appropriée. En fonctionnement normal, les roulettes, qui permettent au lit de maintenir sa distance par rapport au mur, entrent en contact avec les supports de plateforme en acier de la base ajustable et produisent alors un bruit. Lorsque vous entrez dans le lit, en sortez ou bougez dessus, ce bruit peut être audible lorsque les roulettes entrent en contact. Ce bruit est normal.

MATÉRIAUX

Les lits ajustables Ergo sont fabriqués à partir de divers matériaux, dont différentes essences de bois, des métaux, des plastiques et des tissus. La tension, la pression ou le mouvement appliqué sur le châssis, la plateforme ou le cadre lors d'une utilisation normale peuvent générer un son audible.

FONCTION DE MASSAGE ET EMPLACEMENT DU LIT

La fonction de massage émet un bruit pendant son fonctionnement. Ce bruit est normal. La tonalité s'intensifie au fur et à mesure que le niveau d'intensité du massage augmente. Le volume de ce bruit est directement lié à l'environnement où se trouve le lit. Par exemple, lorsqu'une démonstration du fonctionnement du lit s'effectue dans un magasin, le bruit environnant couvre une partie des sons produits par le massage. Cependant, si le lit est installé dans une maison avec du parquet, avec de la moquette ou non, le volume du massage sera plus perceptible. Pour réduire cette résonance, placez un morceau de tapis, ou des patins en caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base ajustable. Il est possible de ressentir des vibrations ou du bruit provenant du cadre extérieur de la base ajustable, des supports de la tête de lit, de la tête de lit ou du pied de lit si les boulons de montage ne sont pas fermement serrés. Les niveaux 1 à 3 d'intensité de massage représentent le nombre de tours du moteur par minute. Le niveau 3 indique le nombre maximum de tours par minute. Cependant, cela ne signifie pas que la sensation de vibration sera la plus forte. La sensation de vibrations sera différente en fonction du matériau du matelas, de l'épaisseur et du positionnement de l'utilisateur. Nous recommandons à l'utilisateur de déterminer le réglage d'intensité de massage qui lui convient le mieux. Il est important de comprendre la physique des vibrations. Tout comme un moteur peut tourner irrégulièrement au ralenti, les vibrations changent dès que le régime augmente.

L'ODEUR DE « NOUVEAU PRODUIT »


Certaines personnes remarquent une légère odeur se dégageant de leur nouvelle base ajustable, ce qui peut provenir de notre processus de fabrication et des matériaux employés. Cette odeur est normale et disparaît généralement avant que le produit ne vous soit livré. Parfois, cependant, cette odeur peut encore être perceptible. Elle disparaît généralement après quelques semaines, sous réserve qu'il y ait une ventilation adéquate du produit et de l'environnement.

Consignes de sécurité et d'utilisation

TOLÉRANCE

Toutes les bases ajustables Ergo, en fonction de la marque et du modèle, sont conçues et fabriquées pour fonctionner dans les limites des paramètres de contrôle qualité désignés. Les bases font l'objet d'inspections méticuleuses et rigoureuses au cours du processus de contrôle de la qualité afin de s'assurer qu'elles fonctionneront dans le respect de ces normes pendant une utilisation normale. Une utilisation normale est définie comme suit : Le lit ajustable doit être utilisé avec un matelas et une charge. Les procédures de test font appel à des tests de cycle de vie avec une charge distribuée atteignant 120 kg (264 lb).

L'angle (désigné par un « α » dans l'image) entre la section arrière et la section plate pour les différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance de 1,5 po (3,7 cm) maximum. L'angle (désigné par un « β » dans l'image) entre la section plate et la section du pied de lit pour différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance atteignant $\frac{3}{4}$ po (1,9 cm.) Toute base ajustable jugée conforme à ces limites de tolérance est considérée comme ayant satisfait aux normes de contrôle qualité du fabricant.

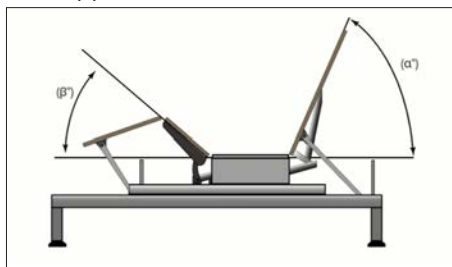

PÉRIODE DE RODAGE

Vous pouvez accélérer la période de rodage en passant simplement du temps dans le lit ajustable en lisant, en regardant la télévision ou en jouant avec vos enfants ou petits-enfants. Ces mouvements supplémentaires aideront la base ajustable à répondre aux changements de poids et de température. Certains des matériaux de nos lits ajustables, tels que les essences de bois, les métaux et les plastiques utilisés dans la plateforme, le cadre et les composantes, sont sensibles à l'humidité et à la température et peuvent produire des sons dans des environnements plus froids.

FONCTIONNEMENT COUPLÉ

Lors de l'utilisation de lits ajustables synchronisés, il peut y avoir un intervalle allant jusqu'à 1,5 secondes entre les mouvements de chaque lit.

USURE

L'usure correspond au dommage qui se produit naturellement et inévitablement à la suite d'une utilisation normale ou du vieillissement du lit ajustable.

ENTRETIEN DU TISSU

Protégez le tissu de la lumière directe du soleil chaque fois que c'est possible afin d'en prolonger la durée de vie. Pour le nettoyage des taches, essuyez la zone avec une éponge légèrement humide ou passez un aspirateur avec une brosse douce pour éliminer les particules. Maintenez les parties en tissu au moins à 12 pouces (30 cm) de sources de chaleur directes. Pour un nettoyage plus en profondeur, épongez les liquides avec un chiffon propre et sec. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède. Ne pas mouiller excessivement. Une brosse à poils doux peut être utilisée pour enlever la saleté incrustée. Évitez de rayer la surface en brossant délicatement. Essuyez avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau tiède pour éliminer les résidus. Séchez à l'ombre loin d'une source directe de chaleur. Consultez un professionnel si des marques persistantes restent visibles après le nettoyage.

CLASSIFICATION DU PRODUIT

Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de [2] minutes sur une période de [18] minutes ou environ 10 % du cycle de fonctionnement. Tenter de contourner ou dépasser cette valeur peut réduire la durée de vie du produit et annuler la garantie. Les moteurs de relaxation ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de 30 minutes à la fois. Veuillez laisser le système de relaxation inactif pendant 30 minutes après son arrêt automatique avant de le redémarrer.

Consignes de sécurité et d'utilisation

IMPORTANT : CE QU'IL FAUT FAIRE ET CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

CE QU'IL FAUT FAIRE

- Brancher votre base ajustable à un parasurtenseur.
- Répartir uniformément le poids lorsque vous dormez dans une disposition partagée. Une répartition inégale du poids peut entraîner un soulèvement irrégulier de la base.
- Appeler le service à la clientèle pour tout problème technique. N'essayez pas de forcer le mouvement de la base vers le bas, cela pourrait endommager les moteurs ou le cadre.
- Utiliser un savon doux et de l'eau pour nettoyer votre base ajustable si des taches apparaissent.
- Garder à l'esprit qu'il est recommandé d'utiliser les bases ajustables avec des matelas adaptés aux réglages.
- Ramener la base en position horizontale (à plat) après utilisation et entre les pré-réglages.
- Enregistrer votre garantie dès que votre base ajustable a été livrée.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- S'asseoir sur les coins/bords de la base, cela pourrait déformer le cadre, les supports ou la mousse.
- Incliner la base sur le côté. Cela peut endommager les pattes et/ou les vis des pattes.
- Se tenir debout ou sauter sur la base ajustable à tout moment, cela peut endommager le cadre et les moteurs.
- Faire glisser la base pour la déplacer. Cela risquerait d'endommager le cadre, de casser les écrous et les boulons ou de briser les pattes. Achetez des roulettes si vous prévoyez de déplacer votre base régulièrement.
- Entrer et sortir de la base ajustable avec la tête et/ou le pied en position articulée. Vous devez toujours entrer ou sortir de votre base ajustable en position à plat (horizontale).
- Bricoler ou modifier la base. Cela annulera la garantie.
- Appuyer sur la tête ou le pied pendant la manœuvre peut endommager le cadre et les moteurs.
- Ne pas utiliser de matelas contenant plus de 5 cm de latex.

LIMITES DE POIDS

Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids de plus de 750 lb (340 kg). Ces limites comprennent le poids du matelas et de la literie. Le lit ajustable soutiendra structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti sur toute sa surface. Le lit ajustable n'est pas conçu pour supporter ou soulever de tels poids au niveau de la tête ou du pied de lit. Le dépassement de cette limite de poids annulerait la garantie, pourrait endommager le lit et/ou causer des blessures.

CONFORMITÉ FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déterminé comme se conformant aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un contexte particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Liste des pièces

Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous que toutes les pièces sont bien présentes.

Toutes les composantes électroniques et les éléments qui doivent être installés sont placés dans des boîtes sous le lit ajustable ou fixés au cadre.



- A) Télécommande sans fil et piles AAA (3)
- B) Pattes x6
- C) Barre de soutien du matelas* x2
- D) Cordon d'alimentation
- E) Bloc d'alimentation
- F) Sangle pour piles de secours (2) Piles 9 V (non incluses)
- G) Cordon de synchronisation‡
- H) Sangle de raccordement‡*
- I) Pinces en C x2
- J) Boulons longs (4), rondelles (8), écrous (4)
- K) Clé hexagonale externe de 13 mm (1), Clé hexagonale de 5 mm (1)

Pièces recommandées (non incluses) :



- L) Parasurtenseur
- M) Piles alcalines de 9 volts x2

*Ces éléments sont fixés à la base pour des raisons d'expédition. Retirez-les délicatement de la base et mettez-les de côté.

‡ Uniquement inclus pour les lits ajustables Simple XL et Split King.

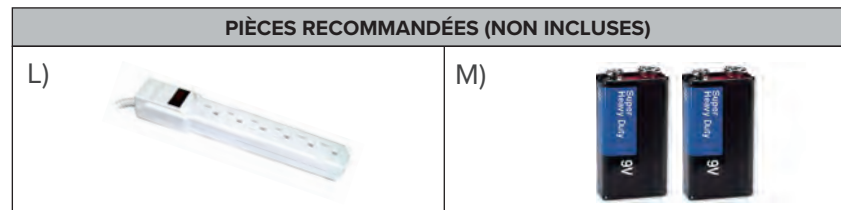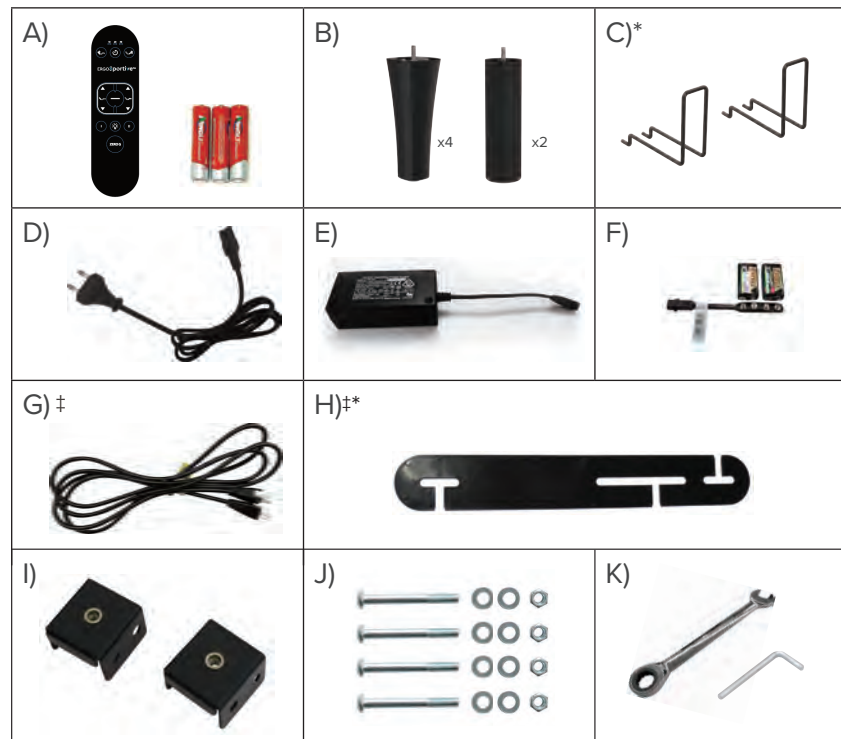

Vue d'ensemble : lit et télécommande

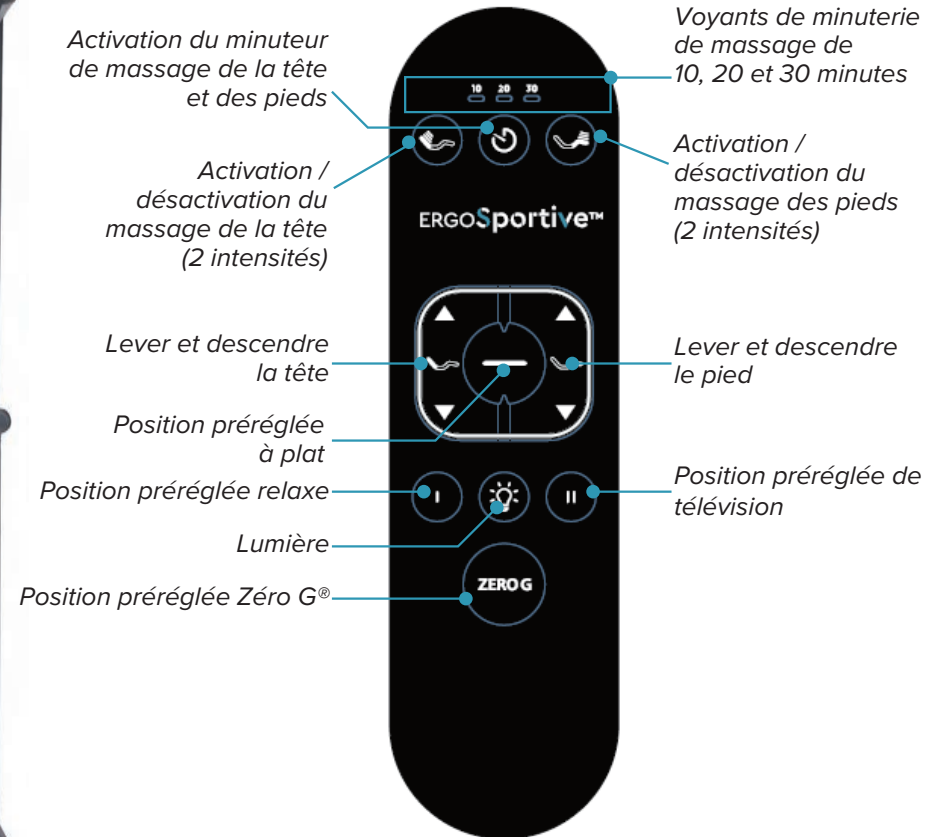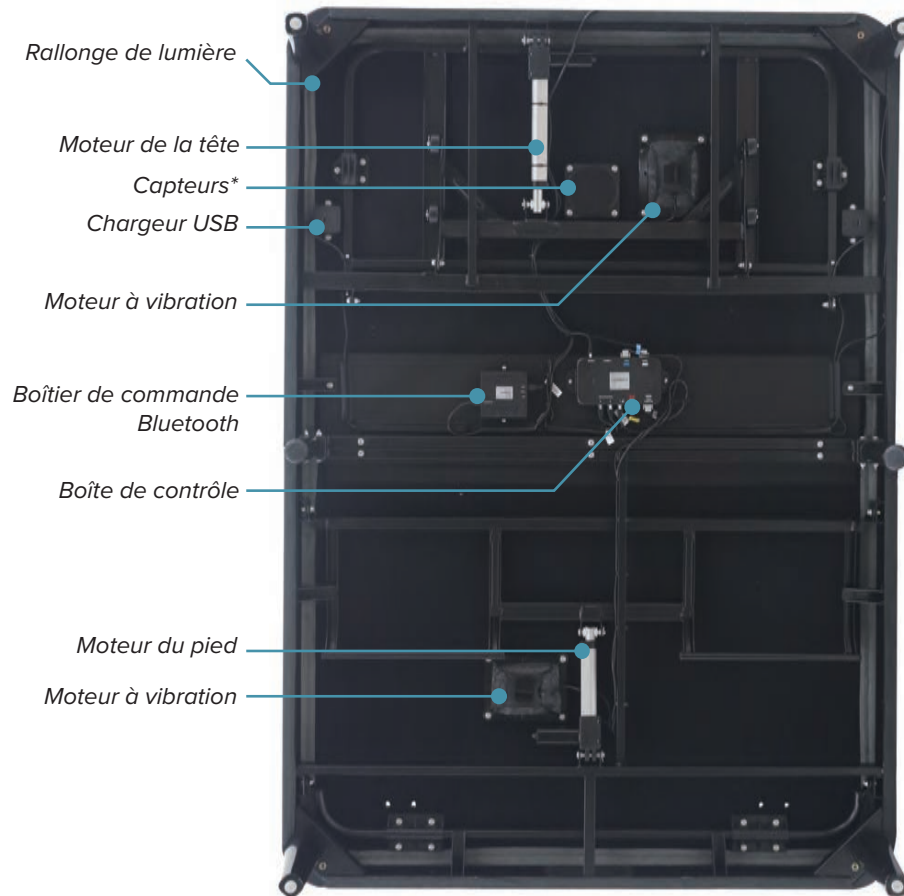


* Note : Les lits Queen ont deux capteurs.

Guide de référence rapide

Pas à l'échelle. À titre d'illustration seulement. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.

APERÇU DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

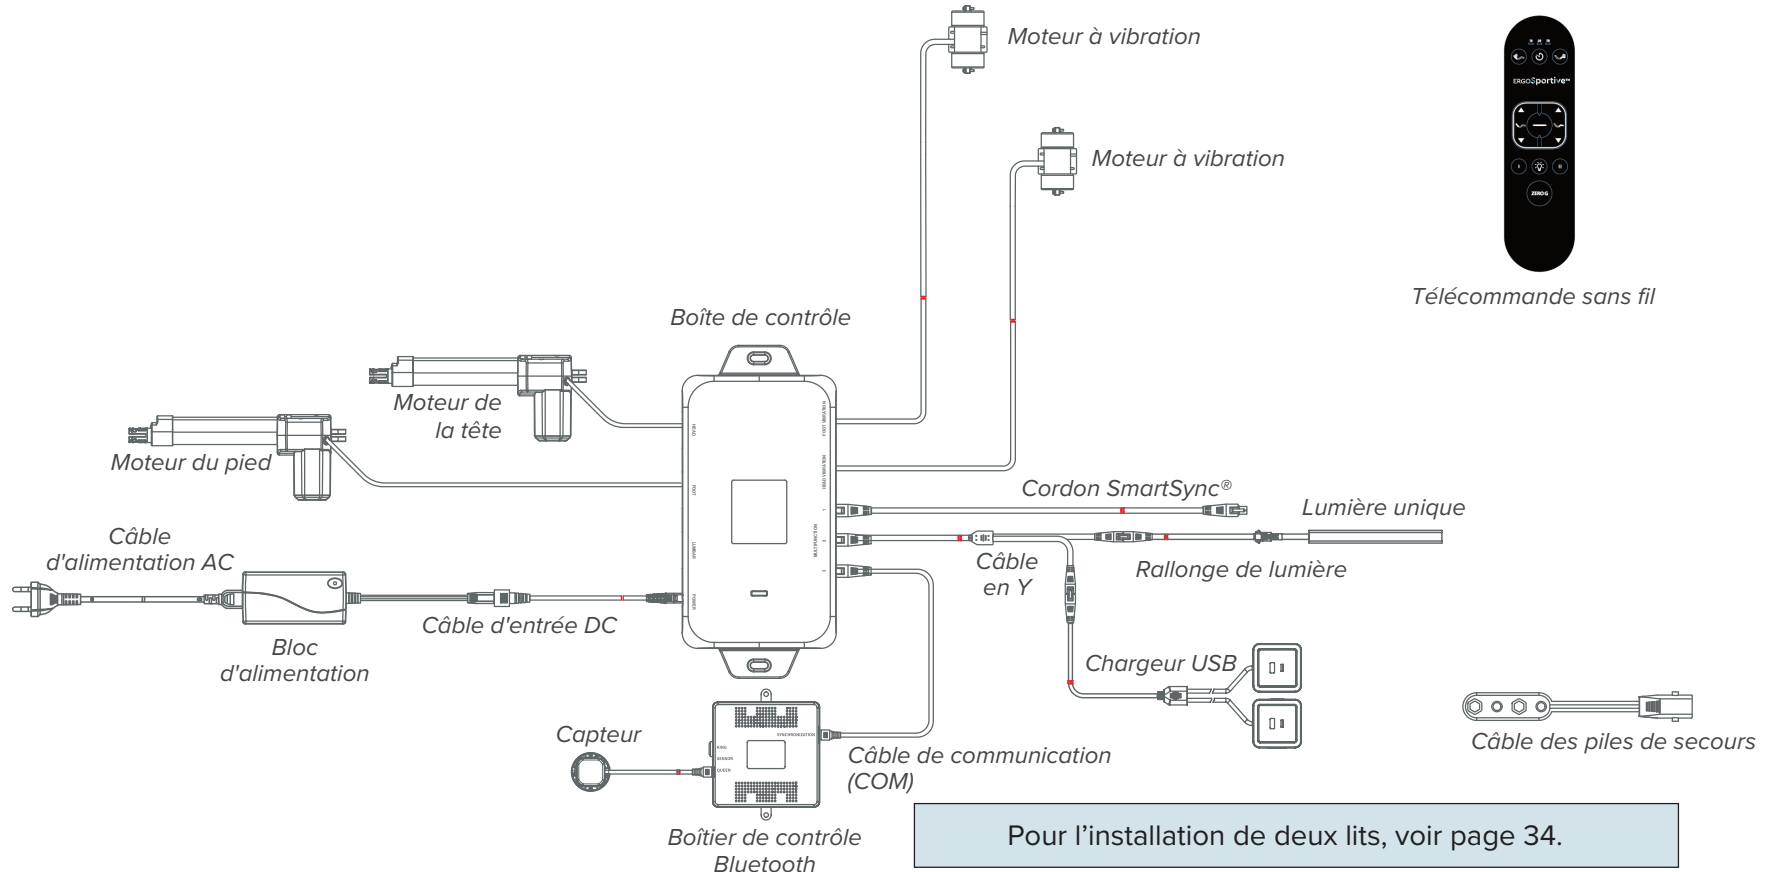


Guide d'installation

Le lit doit toujours être déplacé, ou retourné par deux personnes.

ÉTAPE 1

Retirez la base de la boîte en gardant le dessous de la base vers le haut.

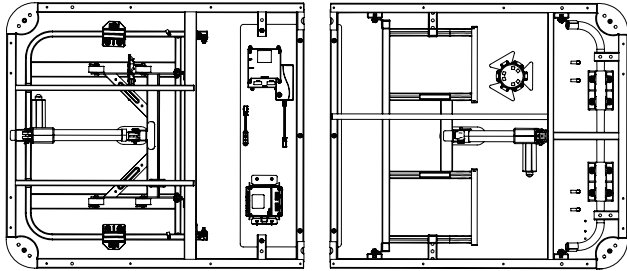

ÉTAPE 2

Joignez les deux sections de la base ensemble, faites glisser la pince en C sur les connexions du cadre (voir la figure B) au milieu des deux côtés de la base.

Fig A





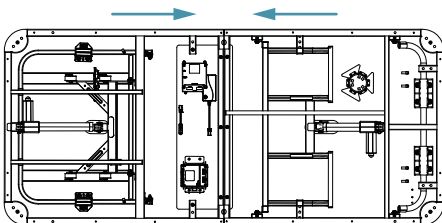


Fig B

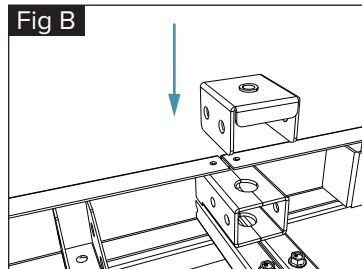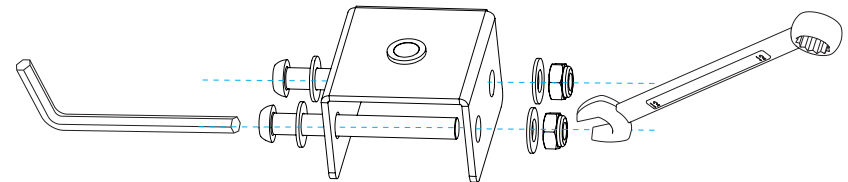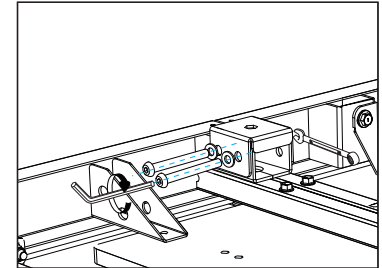

ÉTAPE 3

Insérez deux boulons longs à travers une rondelle avant de les introduire dans les trous situés sur le côté de la pince en C. Utilisez les clés hexagonales.

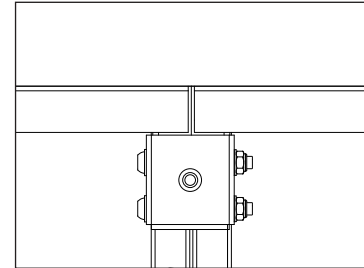

ÉTAPE 4 (Optionel)

Pour installer les pattes, placez une rondelle sur la partie fileté de chaque patte, la partie arrondie vers la patte. Insérez chacune des quatre pattes coniques aux coins du lit en utilisant les trous de boulon les plus proches du bord long du lit. Installez les deux pattes cylindriques (rondes) au centre des pinces en C préalablement installées à la jonction des deux sections. Vissez les pattes à la main.

Ne pas trop serrer.

Remarque : Si vous installez le lit ErgoSportive sur une plateforme ou un cadre de lit avec des lattes, il n'est pas nécessaire d'installer les pattes.

Guide d'installation

ÉTAPE 5

Pour synchroniser deux bases, voir les instructions d'installation détaillées à la page 34.

Repérez la sangle pour piles de secours et mettez-la de côté. Assurez-vous qu'elle soit bien accessible après l'installation de la base.

ÉTAPE 6

Déroulez le câble d'alimentation d'entrée (connecté au port d'alimentation de la boîte de contrôle) et branchez-le au bloc d'alimentation.



ÉTAPE 7

Déroulez le câble d'alimentation et connectez-le au bloc d'alimentation. Placez le bloc d'alimentation sur le sol et faites-le sortir de la base. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et tous les câbles qui y sont reliés sont dirigés vers le parasurtenseur souhaité.



ÉTAPE 8

Retournez délicatement la base.

Important : Deux personnes sont nécessaires pour déplacer la base de lit. Ne pas la traîner sur le sol. Ne pas faire reposer la base sur le côté, une pression excessive pourrait endommager les pattes (si utilisées).

ÉTAPE 9

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. **Un parasurtenseur est recommandé.**

ÉTAPE 10

La télécommande doit être utilisée dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension du lit pour garantir la réussite de la synchronisation. Testez rapidement les fonctions de la télécommande pour vérifier la bonne configuration avant de placer le matelas sur la base. Remettez la base en position à plat avant de placer le matelas dessus.

ÉTAPE 11


Installez les barres de soutien du matelas en insérant les deux extrémités de la barre dans les trous de la base pour ensuite les abaisser vers la base les barres tout en maintenant le côté incurvé vers le haut.



La configuration est maintenant terminée ! Testez toutes les fonctions de la télécommande.

Télécommande

La télécommande arrive synchronisée à la base réglable.
Trois (3) piles AAA sont nécessaires pour faire fonctionner la télécommande.

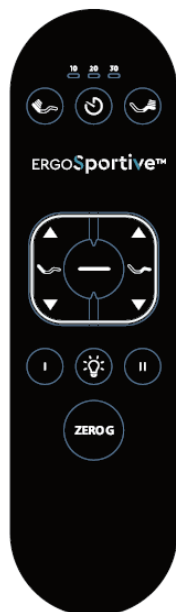





POUR PROGRAMMER LES POSITIONS PRÉRÉGLÉES :

Articulez la tête et le pied jusqu'à la position souhaitée. Ensuite, appuyez sur l'un des boutons de pré-réglage [I, II] et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La position est maintenant enregistrée.

NOTE : Pour restaurer les boutons de pré-réglage à leurs configurations d'usine, maintenez simultanément enfoncés les boutons FLAT et ZERO G pendant au moins 5 secondes. Les pré-réglages d'origine seront restaurés.






FONCTIONS DE MASSAGE

-  Le bouton TÊTE permet d'activer le massage de la tête. Vous pouvez choisir entre 2 intensités de massage.
-  Le bouton PIED permet d'activer le massage des pieds. Vous pouvez choisir parmi 2 intensités de massage.
-  Minuterie de massage. Réglez la durée du massage sur 10, 20 ou 30 minutes.
- 10**  Le voyant situé dans le haut de la télécommande indique le réglage d'une minuterie de 10, 20 ou 30 minutes. Le massage s'arrête automatiquement après 10 minutes si la minuterie de massage n'est pas réglée.

AJUSTEMENTS

-  Les flèches TÊTE ▲ ▼ permettent de soulever et d'abaisser la section de la tête de la base.
-  Les flèches PIED ▲ ▼ permettent de soulever et d'abaisser la section des pieds de la base.

BOUTONS TOUCHE UNIQUE

- ZERO G**  Position pré-réglée à touche unique Zero G®. La fonction Zéro G® ajuste vos jambes à un niveau plus élevé que votre cœur; ce qui aide à améliorer la circulation.
-  Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour ajuster la luminosité.
-  Position pré-réglée à touche unique À PLAT.
- I**  Position pré-réglée à touche unique RELAXE.
- II**  Position pré-réglée à touche unique TV.


Synchronisation de la télécommande

Synchronisation de la télécommande

La télécommande d'origine qui se trouve dans la boîte est déjà synchronisée au lit ajustable. Aucune autre action n'est requise. Dans le cas où la télécommande n'est pas synchronisée au lit, suivez les étapes ci-dessous.

ÉTAPE 1

Débranchez le câble d'alimentation de votre prise électrique. Attendez 1 minute, puis rebranchez-le dans votre prise. Effectuez l'étape 2 dans les 10 secondes, pendant que le voyant de la boîte de contrôle est allumé.

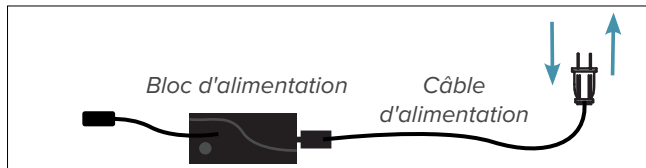

ÉTAPE 2

Appuyez et maintenez le bouton de SYNCHRONISATION à l'arrière de la télécommande. Le bouton de SYNCHRONISATION s'allumera et commencera à clignoter. Lorsque le bouton de SYNCHRONISATION cesse de clignoter, le voyant lumineux sur la boîte de contrôle s'éteindra. Relâchez ensuite le bouton de SYNCHRONISATION.



ÉTAPE 3

La télécommande est maintenant synchronisée à la base ajustable. Testez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons de la télécommande n'ont aucun impact sur les mouvements de la base ajustable, veuillez recommencer le processus.

Sangle pour les piles d'urgence

Pour utilisation d'urgence uniquement, en cas de panne de courant.

Les piles ne doivent pas être utilisées pour le fonctionnement normal du lit.

ÉTAPE 1

Débranchez le dispositif d'alimentation du câble d'alimentation d'entrée.


ÉTAPE 2

Connectez la sangle pour piles de secours aux (2) piles alcalines de 9 volts. Ne mélangez pas des marques différentes.



ÉTAPE 3

Connectez l'extrémité de la sangle pour piles de secours au cordon d'entrée qui est fixé à la boîte de contrôle.

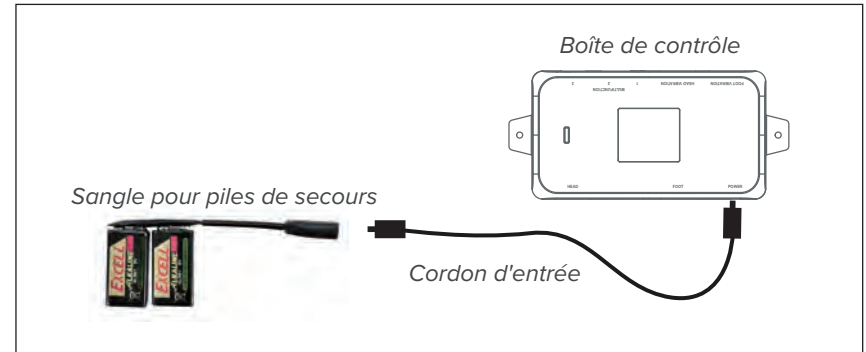

ÉTAPE 4

Utilisez ensuite la télécommande pour remettre le lit à plat.

Remarque : Détachez la sangle pour piles de secours et rebranchez l'alimentation une fois la situation d'urgence terminée, car le système continuera d'utiliser les piles même s'il n'est pas en fonctionnement.

Synchronisation de deux bases (facultatif)

Un cordon SmartSync® est inclus avec la base. Uniquement disponible sur certains modèles. Le cordon SmartSync® relie deux différentes boîtes de contrôle à une seule télécommande afin de synchroniser deux bases. Veuillez connecter le câble de synchronisation avant d'installer la tête de lit.

ÉTAPE 1

Débranchez les bases de la source d'alimentation.

ÉTAPE 2

Connectez le cordon SmartSync® au port multifonction de chaque boîte de contrôle.


ÉTAPE 3

Rebranchez les bases sur la source d'alimentation.

ÉTAPE 4

Assurez-vous que tous les cordons sont bien fixés. Les deux télécommandes vont maintenant fonctionner sur les deux bases simultanément.

Le système est maintenant relié. Les boutons pressés sur l'une ou l'autre des télécommandes permettent de contrôler les deux bases simultanément.

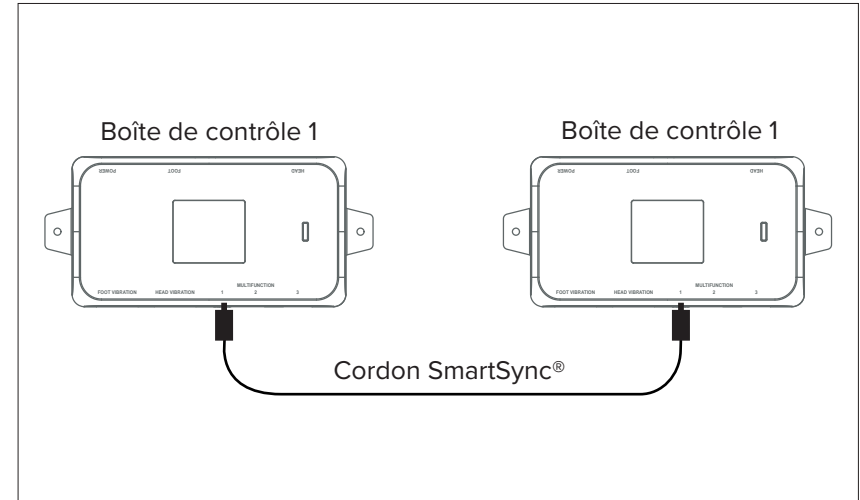

NOTES DE PERFORMANCE

Si les bases sont mal synchronisées, le fait de les remettre en position à plat permet de resynchroniser les positions.

Contrôler la lumière DEL séparément (facultatif)


Cette page a pour but d'expliquer comment permettre aux deux télécommandes de contrôler la bande lumineuse lorsque le cordon de synchronisation est débranché. S'applique uniquement au King séparé.

ÉTAPE 1

Débranchez le câble de synchronisation du lit A et du lit B.

ÉTAPE 2

Appuyez sur le bouton À PLAT des télécommandes A et B et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant des télécommandes clignotent. Les voyants s'arrêtent de clignoter lorsque la synchronisation est terminée.



ÉTAPE 3

Si les lumières des télécommandes clignotent pendant un long moment, cela signifie que la synchronisation a échoué. Attendez 20 s pour que les lumières cessent de clignoter. Puis répétez l'étape 2.


Sangle de raccordement (facultatif)

Les sangles de raccordement sont fixées au cadre de la base dès la livraison. Les pattes sont nécessaires pour l'installation des sangles de raccordement.

ÉTAPE 1

*Les pattes sont nécessaires pour l'installation des équerres de tête de lit. Pour acheter des pattes, veuillez contacter le **service clientèle**: support@ergosportive.com*

Une fois les bases positionnées à l'endroit souhaité, dévissez légèrement les deux pattes qui seront attachées ensemble afin de permettre l'installation de la sangle sur la partie fileté de la patte, entre la rondelle et le lit.

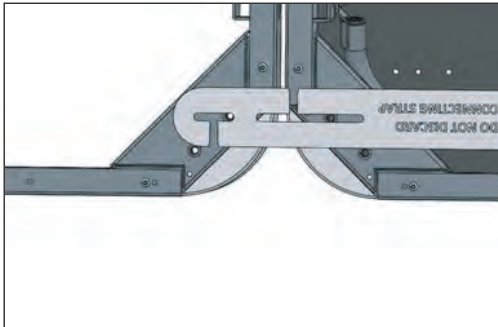

ÉTAPE 2

Glissez l'extrémité de la sangle (a) sur la partie fileté d'une des pattes. Faites pivoter la sangle et attachez l'extrémité (c) sur la partie fileté de l'autre patte. Fixez la sangle en la déplaçant vers la gauche.








ÉTAPE 3

Resserrez les pattes. Ne pas trop serrer. Utilisez l'autre sangle pour répéter les étapes 1 et 2 à l'autre extrémité de la base.

Guide d'installation de la tête de lit (facultatif)

Liste des pièces :

Toutes les pièces suivantes ne sont pas incluses dans le lit, elles sont emballées avec la tête de lit. En cas de besoin, elles peuvent également être vendues comme accessoire.



A) 	B) 	C) 
Équerre de tête de lit X2	Embout tête de lit X2	Vis hexagonale X6
D) * 	E) 	
Clé hexagonale de 5 mm X1	Équerre de tête de lit X2	

* La clé hexagonale est incluse avec l'ensemble des pièces de fixation pour la tête de lit.

Notez que les pièces B servent aux lits de format Simple XL et Grand lit. Les pièces E sont réservées aux lits de format Très grand lit.

ÉTAPE 1


Utilisez les deux (2) vis hexagonales pour fixer la boucle femelle de l'équerre de tête de lit au cadre du lit.

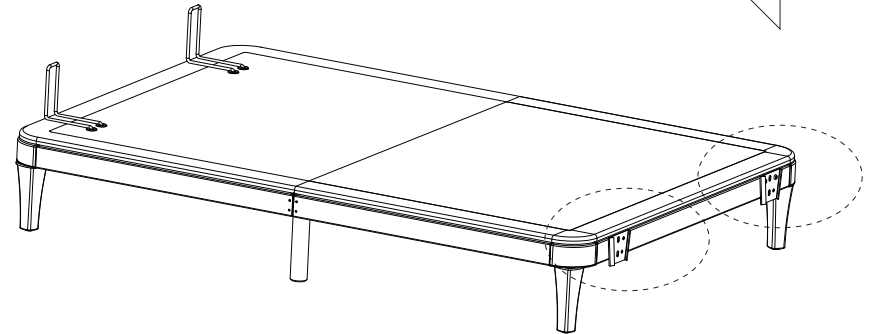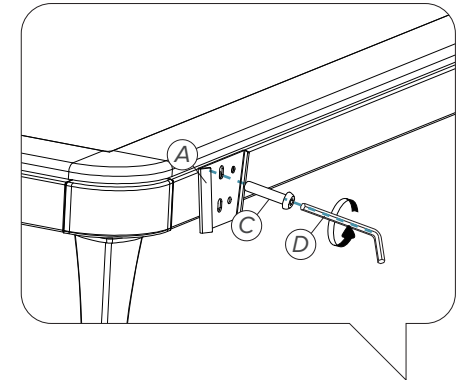


Guide d'installation de la tête de lit (facultatif)

ÉTAPE 2 (Pour les têtes de format Très grand lit seulement)

Retirez les quatre vis hexagonales des embouts de tête de lit préinstallés.

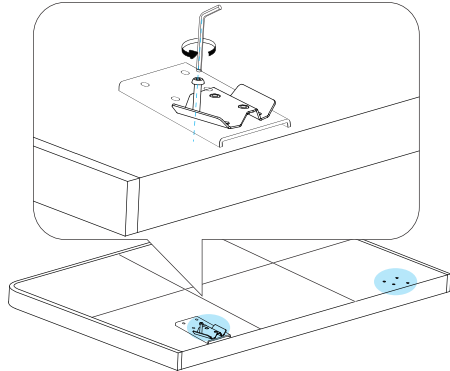


Utilisez les quatre vis préalablement retirées afin de rattachiez l'équerre à la tête de lit en utilisant les quatre trous les plus dans le haut. Fixez solidement.

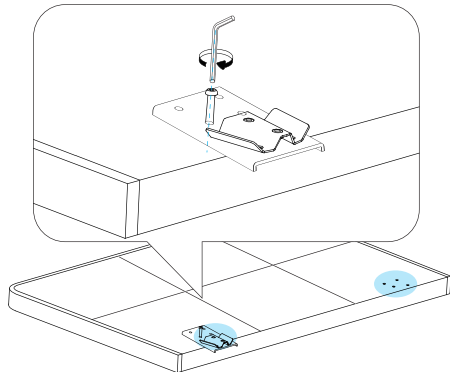

ÉTAPE 3


Deux personnes sont requises pour soulever la tête de lit, aligner la boucle mâle de la tête de lit avec la boucle femelle et insérer la tête de lit verticalement.

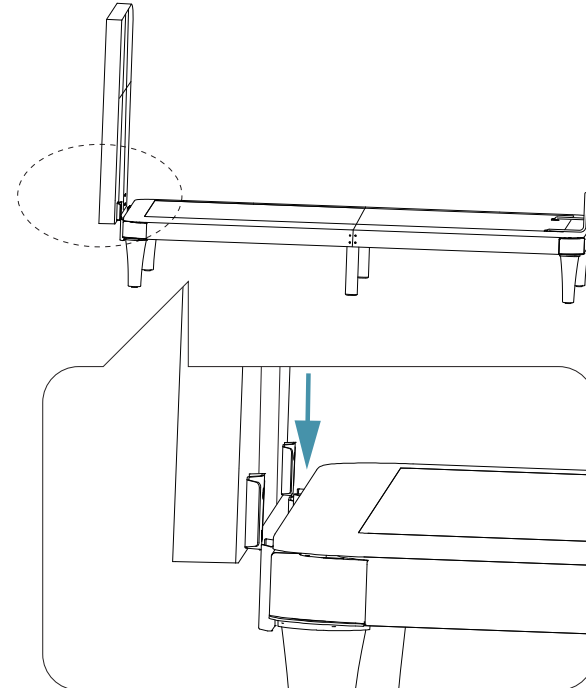

Guide d'installation de la tête de lit (facultatif)


ÉTAPE 4

Activez le lit et levez la tête ajustable. Insérez une vis hexagonale et serrez-la pour fixer fermement la tête de lit à la base. Notez qu'il peut s'avérer nécessaire de soulever légèrement la tête de lit pour aligner la vis.

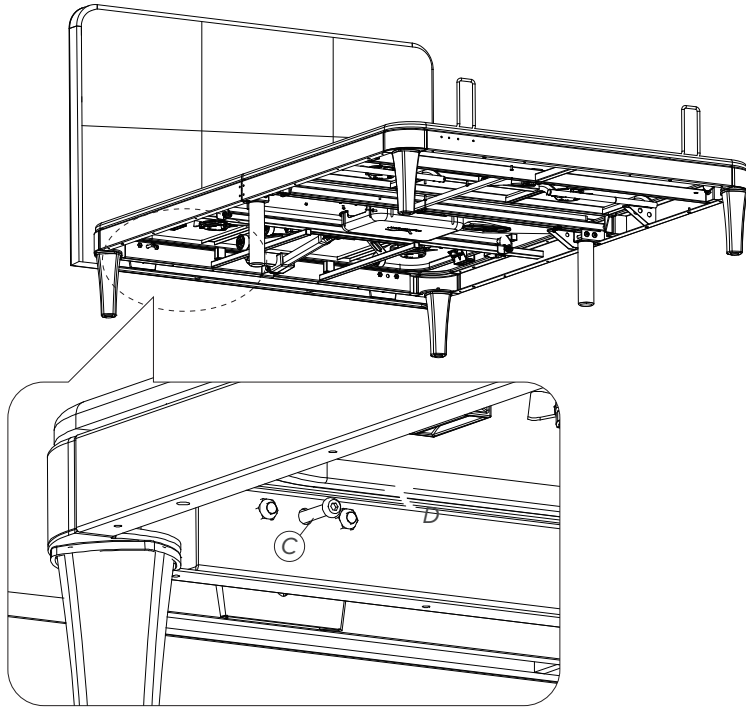

ÉTAPE 5

Débranchez le lit de l'alimentation électrique. Connectez la lampe à DEL. Rebranchez le lit à l'alimentation électrique.

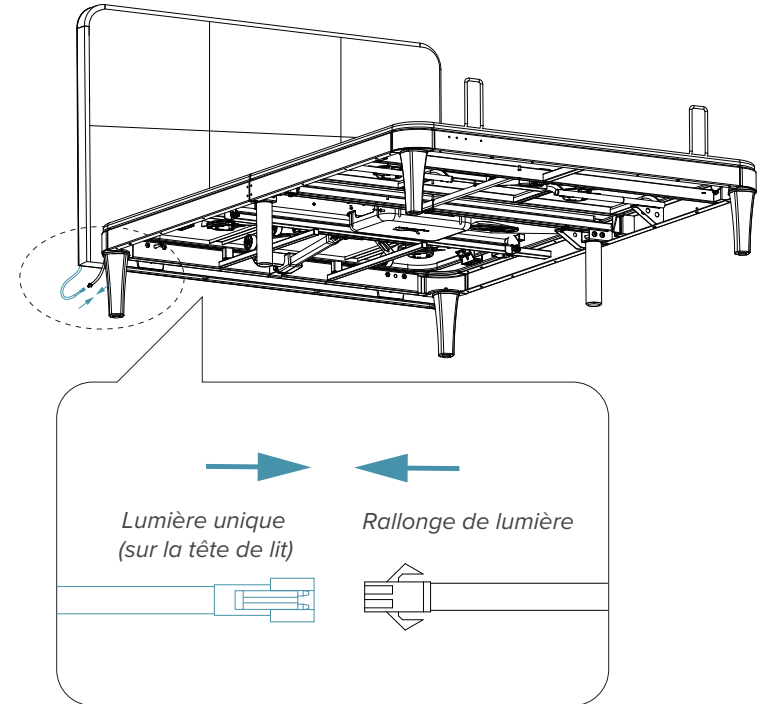

Vidéo d'assemblage



Veillez scanner ce code QR pour voir la vidéo d'assemblage.

Application ErgoSportive™

ÉTAPE 1 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Télécharger l'application ErgoSportive™ Téléchargez la version Android de l'application depuis le Google Play. Téléchargez la version iOS de l'application à partir de l'Apple Store.



ÉTAPE 2 INSCRIPTION

Ouvrez l'application ErgoSportive™, cliquez sur le bouton « **S'inscrire** » sur la page d'inscription et suivez les instructions pour compléter l'inscription. Une fois que vous vous serez inscrit, vous serez automatiquement connecté et vous pourrez entamer le processus de connexion au ErgoSportive.

ÉTAPE 3 S'IDENTIFIER

Afin de vous identifier lors des connexions suivantes, il vous suffira d'entrer votre courriel et votre mot de passe, créé lors de votre enregistrement, et de cliquer sur « **Se connecter** ».

ÉTAPE 4 CONNECTER LE LIT INTELLIGENT

Connecter le lit intelligent

Ouvrez l'application ErgoSportive, sélectionnez l'onglet « **Réglages** », cliquez sur « **Paramètres du lit** » pour accéder à la page des réglages du lit intelligent, puis appuyez sur le bouton « **Connecter un nouveau lit** ».

Démarrer la connexion

Scannez le code QR du lit ou appuyez sur le bouton « **Recherchez des lits** » pour sélectionner votre lit et le connecter.

Terminer la connexion

Accédez à la phase de connexion et une fois que la progression atteint 100 %, la connexion est terminée.

Commutateur de données

Sélectionnez le commutateur de données et vous pouvez activer ou désactiver le stockage de données en fonction des besoins.

Sélectionner le côté du lit (en cas de lit double)

Sélectionnez le côté du lit sur lequel vous dormez, pas exemple choisissez de dormir à gauche, à droite, ou avec une personne dans un lit double.

Calibrer votre ErgoSportive™

Afin d'obtenir des données précises, votre sexe, votre date de naissance, votre grandeur, votre poids et l'épaisseur de votre matelas sont nécessaires pour compléter le calibrage. Veuillez prendre en compte que le calibrage complet de votre ErgoSportive™ peut prendre jusqu'à sept jours, période pendant laquelle les indicateurs de sommeil seront améliorés en continu.

Autoriser le compte Garmin®

Autorisez votre compte Garmin® afin d'accéder aux données Garmin®. Vous pouvez choisir d'ignorer cette étape.


PLUS DE DÉTAILS

Veuillez scanner le code QR pour obtenir plus d'informations sur les caractéristiques et le fonctionnement de l'appareil.



REMARQUE

La position du sommeil peut affecter la collecte de données. Pour assurer les données les plus précises, il est recommandé de dormir au centre du lit dans le cas d'un lit Simple ou sur votre côté de lit choisi en cas d'un Grand lit (au centre si vous dormez seul(e)). Le fait de dormir trop proche du bord ou dans une position inhabituelle affectera la précision des données.

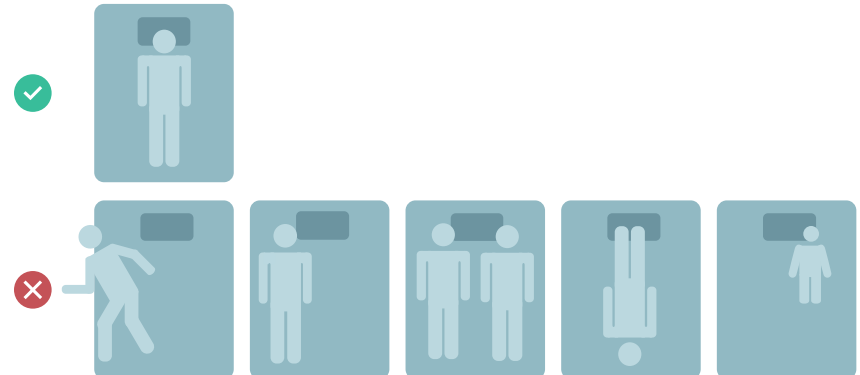

Si une ou plusieurs fonctions de la base de lit ont cessé de fonctionner :

- Vérifiez sous la base de lit que toutes les connexions sont bien fixées et qu'aucun cordon ou pièce de literie n'entrave les mouvements de la base.
- Vérifiez que le voyant vert est allumé sur la boîte de contrôle. S'il n'est pas allumé, vérifiez si l'entrée et les cordons d'alimentation sont correctement connectés.
- Débranchez la base pendant 1 minute afin de réinitialiser les composants électroniques.
- Branchez la base ajustable sur une autre prise électrique ou testez la prise actuelle avec un autre appareil qui fonctionne (il est recommandé d'utiliser un parasurtenseur mis à la terre).
- Retirez et remplacez les piles de la télécommande, puis appariez à nouveau la télécommande sur la base (voir page 32).

Si le problème n'est pas résolu en suivant les instructions ci-dessus, repérez le numéro de série sur la carte de garantie ou au dos de la télécommande et contactez le

Service à la clientèle d'Ergomotion : support@ergosportive.com

Pg. 1-4 - Sobre las precauciones y el uso

Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable.
Guarde estas instrucciones.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, INCENDIO O LESIONES:

Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para desconectar de forma segura, asegúrese que la base está en una posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha supervisión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, convalecientes, personas con discapacidad o los animales domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:

Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin supervisión de un adulto.

MARCAPASOS:

Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfibrilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietarios de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimiento / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:

Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusivamente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenoterapia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de pellizco.

Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir que se suelte.

Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma presionando cualquier botón del control remoto o presionando el botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.

Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergencia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una operación normal de la base, las ruedas, que permiten distanciamiento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido al contacto, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.


MATERIALES:

Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materiales como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN:

La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien apretados.

Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entender la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones cambian simultáneamente.

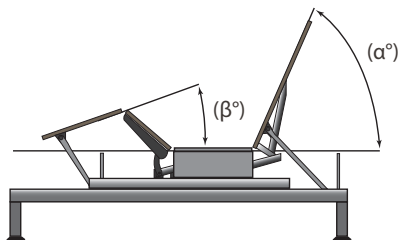

TOLERANCIA:

Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases operen dentro de estas normas durante el uso normal de funcionamiento. El uso normal de funcionamiento se define como la siguiente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado "α" en la figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de $\pm 3^\circ$, que se traduce en una tolerancia de hasta $1\frac{1}{2}''$.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de $\pm 3^\circ$, que se traduce en una tolerancia de hasta $\frac{3}{4}''$.

Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de calidad del fabricante.

EL OLOR DEL " NUEVO PRODUCTO ":

Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:

Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajustables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plataforma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:

Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando.

DESGASTE Y ROTURA:

El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevitablemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:

Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes permanecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo [18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseñados para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 minutos después de que el masaje se haya apagado automáticamente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:

Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa de cama. La base soportara estructuralmente el peso, siempre y cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER

HACER:

- Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
- Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la base eleve de manera dispareja.
- Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o el marco.
- Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay manchas.
- Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda utilizar colchones aptos para bases ajustables
- Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición plana (horizontal).
- Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base ajustable.

NO HACER:

- Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar el chasis, travesaños o espuma.
- Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos de la pierna.
- Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, esto puede dañar el marco y motores.
- Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regularmente.
- Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la posición plana (horizontal).
- Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
- Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores están funcionando puede dañar el marco y motores.
- No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5 Componentes

Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene todos los componentes.

Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco.

- A) Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
- B) Patas (x6)
- C) Barra de retención del colchón (x2)
- D) Cable de alimentación
- E) Fuente de energía

F) Correa de respaldo de la batería *

(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)

G) SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) †

H) Correa de conexión* †

I) Abrazaderas en C (x2)

J) Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4

K) Llave hexagonal exterior de 3 mm x1

Llave hexagonal de 5 mm x1

Misceláneos (no incluidos):

L) Protector de sobrecargas

M) Pilas alcalinas de 9 voltios (2)

Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de instalación rápida de Divided King.

* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. Retírelos con cuidado de la base y sepárelos.

† Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King dividida.

Pg. 6 Resumen sobre la base

Light Extension Cord = Cable de extensión de luz

Head motor = Motor de la cabecera

Vibration Motor = Motor de vibración

USB Ports = Puertos USB

Sensor = Sensor

Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth

Control Box = Caja de control

Foot motor = Motor de los pies

Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador de masaje de cabeza y pies

10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 20, 30 minutos

Head Massage On/Off (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/

apagar (2 intensidades)

Foot Massage On/Off (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/
apagar (2 intensidades)

Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera

Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies

Flat preset position = Posición horizontal predefinida

Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón

TV Preset Position = Posición predefinida de TV

Light = Luz

Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7 Guía de referencia rápida

No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación.

RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA

Head motor = Motor de la cabecera

Foot motor = Motor de los pies

Power Cord AC= Cable de alimentación

Power Supply = Fuente de energía

Input Cable = Cable de entrada de electricidad

Vibration Motor = Motor de vibración

Control Box = Caja de control

SmartSync® Cord = Cable SmartSync®

Y-Cable = Cable Y

Light Extension Cord = Cable de extensión de luz

Single Light= Una sola luz

USB Charger = Cargador USB

COM Cable= Cable COM

Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth

Sensor = Sensor

Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico

Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9 Guía de instalación:

Siempre use a dos personas para instalar la base.

PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con algún objeto afilado.

PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de ambos lados de la base.

PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazadera en C. Utilizando una llave hexagonal interior.

PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instálolo en el tubo del soporte. (Instálolo en la posición diagonal de cada tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empotrado hacia la pata y apriete con la mano.

PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado.

Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.

PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la fuente de alimentación.

PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el protector de sobretensión deseado.

PASO 8: Con cuidado, vuelca la base.

Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electricidad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.

PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segundos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base.

Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón encima.




PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado curvado hacia arriba.

La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del control remoto.


Pg. 10- Control remoto


El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configurado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que funcione el control remoto (incluidas).

CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

-  El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través de 2 intensidades de masaje.
-  El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 2 intensidades de masaje.
-  El botón MASSAGE TIMER Ajuste el tiempo de masaje durante 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
- 10** La luz en la parte superior del control remoto indica una configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

 Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza de la base.

 Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:

ZERO G Un toque ZERO-G® posición preajustada. - Zero G® ajusta sus piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar la presión de la parte baja de la espalda y promover la circulación.

 Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.

— Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto la cabeza como el pie a una posición PLANO.

I Posición preestablecida de salón de un toque.*

II Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:

Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.

NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configuraciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11 Pareo del control remoto

El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado con la base de la cama. No necesita hacer nada.

Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos siguientes:

PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corriente. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corriente. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la

caja de control está iluminada.

Power Supply = Fuente de energía

Power Cord = Cable de alimentación

PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPAREJAR.

PAIR Button=Botón EMPAREJAR

PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados. Pruebe todas las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12 Correa de respaldo de la batería

Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la cama.

PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de alimentación de entrada.

PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca.

PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de control.

PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una posición flat.

Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13 Sincronizar Dos Bases (opcional)

Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas de control a un solo control remoto para la sincronización de dos bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el cabecero.

PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.

PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de cada caja de control.

PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.

PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados.

Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultáneamente.

El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualquiera de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán simultáneamente.

Control Box 1&2= Caja de control 1&2

SmartSync® Cord = Cable SmartSync®

NOTAS DE ACTUACIÓN

Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14 Control de la luz LED por separado

El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño king de 2*90CMx200CM o dividida.

PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la cama B.

PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadéen, la luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15 Correa de conexión (opcional)

Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de las correas de conexión.

PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco.

PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.

PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la base.

Pg. 16-18 Guía de instalación del soporte de la cabecera

Componentes del soporte de la cabecera:

- A) Soporte de la cabecera X2
- B) Espiga de cabecero (solo para TXL/Q) X2
- C) Tornillo hexagonal X6
- D) Llave hexagonal de 5 mm X1
- E) Soporte de cabecero (solo para King) X2

^ Los accesorios con la marca "A" están incluidos en el paquete de accesorios del soporte del cabezal.

PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama.

PASO 2 (Solo para King): Quite los cuatro tornillos hexagonales de las espigas de la cabecera preinstaladas. Vuelva a colocar el soporte en la cabecera usando los cuatro orificios superiores con

los tornillos que quitó en el paso anterior. Sujete de forma segura.

PASO 3: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e insertarla verticalmente.

PASO 4: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligeramente la cabecera para alinear el tornillo.

PASO 5: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. Vuelva a conectar la energía a la cama.

Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)

Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19 Vídeo de montaje

Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje

Pg. 20 Aplicación ErgoSportive™

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde Apple Store.

PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso de conexión a ErgoSportive™.

PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón "Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.

PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE -

Conecte la cama inteligente

Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings",

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configuración de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a new bed".

Iniciar conexión

Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search beds" para seleccionar su cama y conectarla.

Finalizar conexión

Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la conexión estará completa.

Seleccionar interruptor de datos

Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos según sea necesario.

Seleccione el lado de la cama (cama doble)

Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama doble.

Calibre su ErgoSportive™

Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual las métricas de sueño seguirán mejorando.

Autorizar la cuenta de Garmin®

Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.

Más detalles

Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y funcionamiento.

Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccionado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21 Solución de problemas

Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de funcionar:

- Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyendo el movimiento de la base.
- Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada y la potencia están conectados correctamente.
- Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes electrónicos.
- Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).

Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com

Notes

Service à la clientèle : support@ergosportive.com
Site web : ergosportive.com

©2022 Ergomotion Inc.
V002_8/2022 35014951

Numéro de série

+

+

+

+