

Jean

Protokoll vom 13.11.2023

Testperson:

Vorname: Jean
 Name:
 Strasse:
 PLZ/Ort:
 Tel.:
 E-Mail:


Geb.-Datum:
 Gewicht: 0 kg
 Größe: 0 cm
 Geschlecht: männlich

Gerätedaten:

Geräte-ID: 0040501237
 Firmware: v04.08.00

Zusatzbemerkungen zur Testperson:

Leistungskurve:

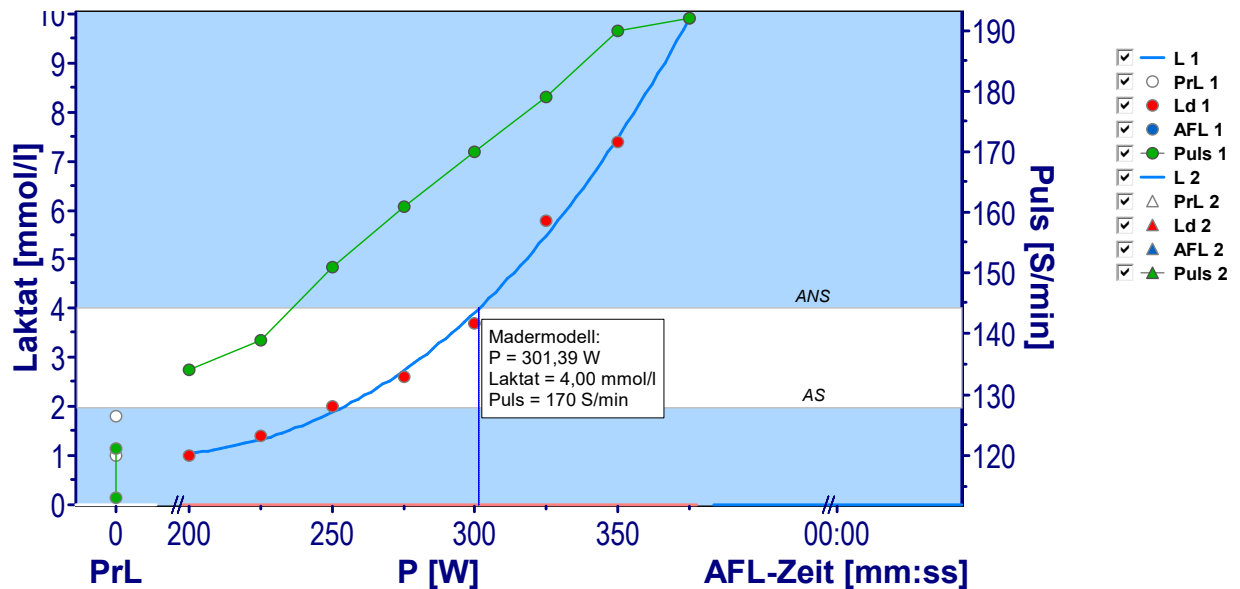

Es wurde kein kompatibler Bluetooth® Dongle gefunden.

Test 1 (Ergometer)

Datum: 17.01.2000
 Uhrzeit: 23:35:12
 Schwellwertmodell: Mader-Modell
 Fitting-Funktion: Polynom 3. Grades

Ergebnisse:

Laktat IANS: 4,00 mmol/l
 v an IANS: 301,39 W
 Puls an IANS: 170 S/min

Jean

Protokoll vom 13.11.2023

Messwerte (Test 1):

	Stufendauer [mm:ss]	Belastung [W]	Laktat [mmol/l]	HR [S/min]
PrL 1			1,8	113
2			1,0	121
Ld 1	05:00 (PC)	200,0	1,0	134
2	05:00 (PC)	225,0	1,4	139
3	05:00 (PC)	250,0	2,0	151
4	05:00 (PC)	275,0	2,6	161
5	05:00 (PC)	300,0	3,7	170
6	05:00 (PC)	325,0	5,8	179
7	05:00 (PC)	350,0	7,4	190
8	05:00 (PC)	375,0	9,9	192