

8STAR MINI AVERAGE TEMP: 75 celsius Q2000

온도검사 및 조절기 온도 값


MAT TEMPERATURE CONTROLLER TEST RESULT

담당	부장	대표이사

측정일자: 2019. 6. 16

Model : *제너이 온타 Q2000*

샘플번호: #1

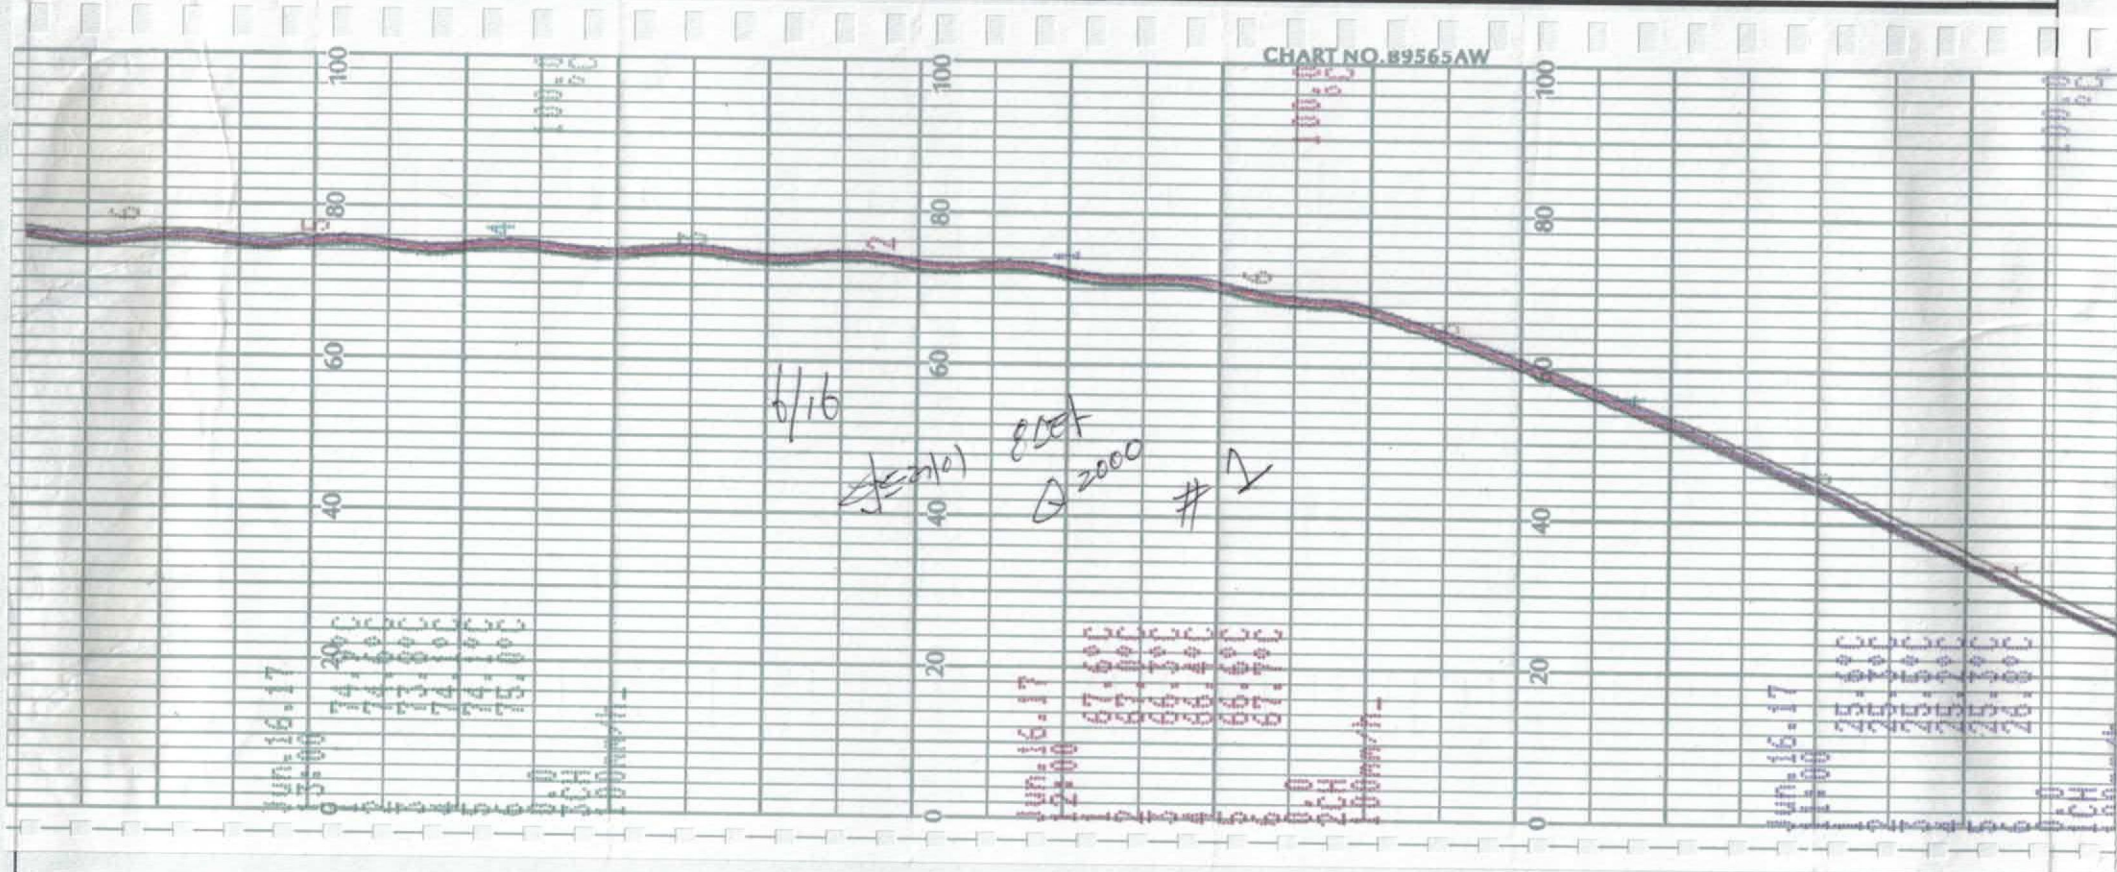

NO	측정시간	조절기	비고
		FND 온도 값	
#1	0분	22°	
	30분	43°	
	60분	70°	
	90분	70°	
	120분	70°	


온도검사 및 조절기 온도 값

MAT TEMPERATURE CONTROLLER TEST RESULT

담당	부장	대표이사

측정일자: 2017. 6. 29

Model : 스피레이 온타 디나 샘플번호: #1, #2, #3

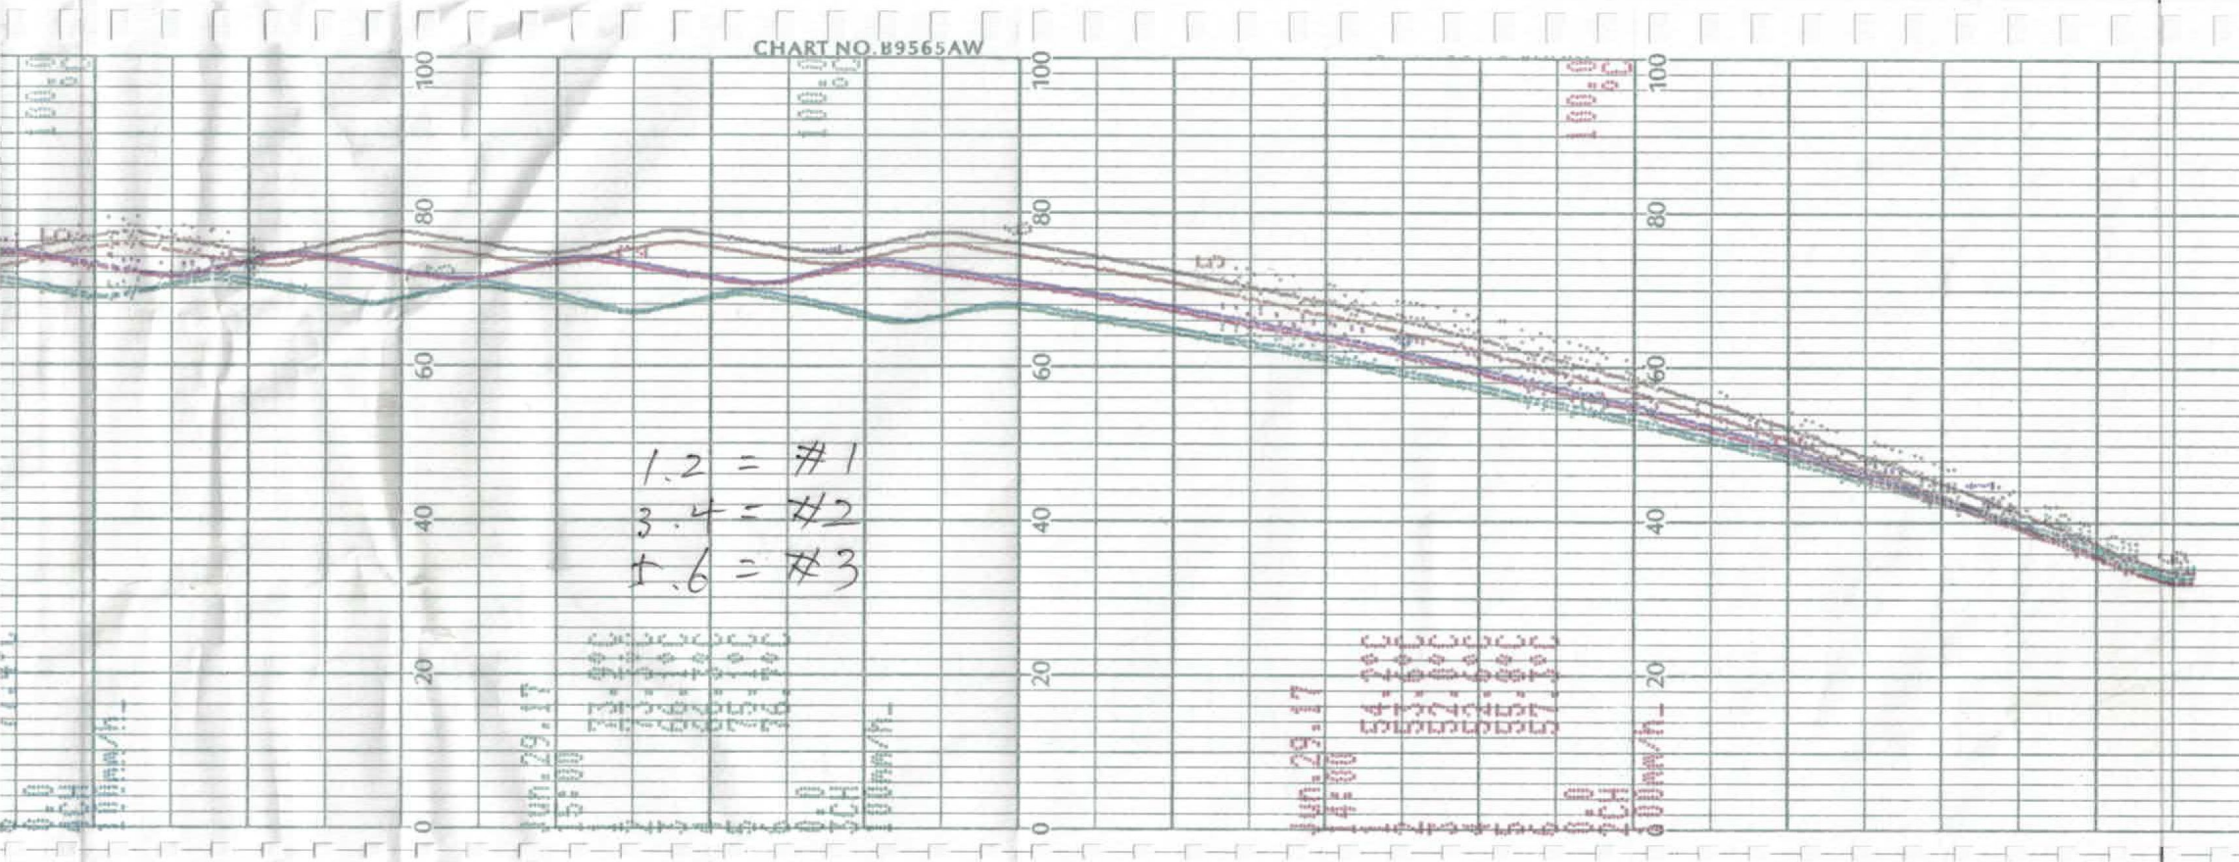

NO	측정시간	조절기	비고
		FND 온도 값	
	0분	.	
	30분	.	
	60분	.	
	90분	.	
	120분	.	