


Digital Basal Thermometer

BT-A23

User Manual

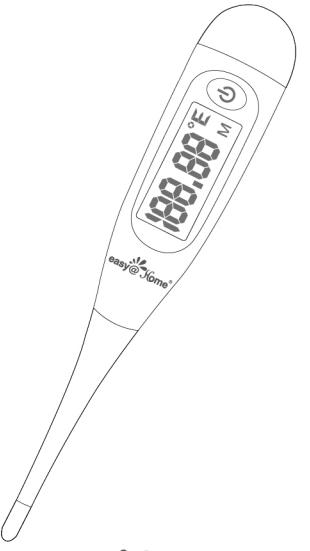


easy@Home®

Powered by premOM APP
Electronic Clinical Thermometer
- EN -

Digitales Basalthermometer

BT-A23

Gebrauchsanweisung

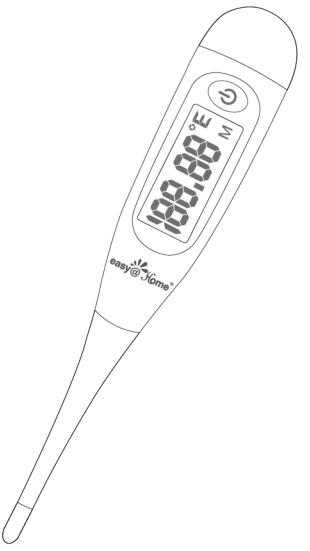


easy@Home®

Angetrieben durch die premOM APP
Elektronisches klinisches Thermometer
- DE -

Termometro Digitale Basale

BT-A23

Manuale d'uso

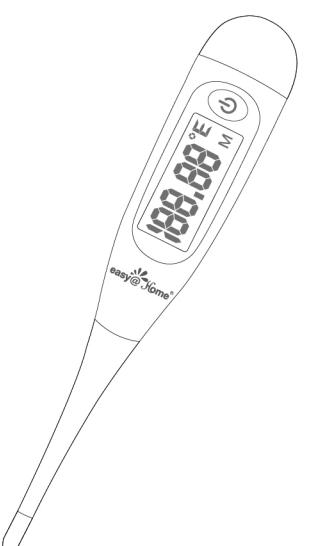


easy@Home®

Alimentato dall'applicazione premOM®
Termometro Clinico Elettronico
- IT -

Thermomètre basal numérique


BT-A23

Manuel d'utilisation

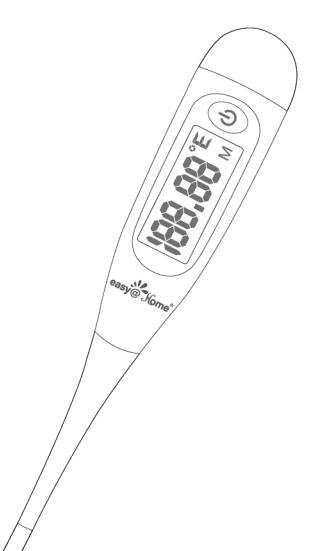

easy@Home®

Alimentato dall'applicazione premOM®
Thermomètre Clinique Électronique
- FR -

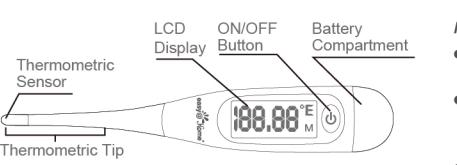

The Digital Basal Thermometer (BT-A23) is used for the measurement of basal body temperature (BBT).

What is basal body temperature, and why do you need a digital basal thermometer?

Basal body temperature is your temperature when you are fully at rest. It is taken immediately upon awakening before any activity. Unlike traditional thermometers, basal body thermometers can measure with increased accuracy to easily detect your fertile window. The BT-A23 Digital Basal Thermometer is sensitive enough to measure subtle changes in body temperature with high precision of 1/100th and takes about 90 seconds to finish a reading when used properly.

Note: It is important to record your temperature every day to identify your BBT trend.

How does your BBT help you pinpoint ovulation? What do you need to know?

Your BBT temps will likely surge right after ovulation, with a 0.2°C – 0.6°C or more shift. The free Premom app can automatically chart your reading inputs and draw your coverline, a visual tool to help you identify your BBT shift. And with Premom you will have unlimited measurements in the cloud.

Note: Users MUST manually enter temperature in the Premom app with this non-Bluetooth enabled model.

How Does The Premom App Help?

1. Tap the button "Log BBT" on the main screen.
2. Choose "Manual" to log your BBT.
3. Tap the degree $^{\circ}$ area to enter your current numerical BBT and tap "Save".



Das Digitale Basalthermometer (BT-A23) wird für die Messung der Basaltemperatur (BBT) verwendet.

Was ist die Basaltemperatur und warum benötigen Sie ein digitales Basalthermometer?

Die Basaltemperatur ist Ihre Temperatur, wenn Sie völlig entspannt sind. Sie wird sofort nach dem Aufwachen vor jeglicher Aktivität gemessen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Thermometern können Basalthermometer mit erhöhter Genauigkeit messen, um ihr fruchtbaren Fenster leicht zu erkennen. Das digitale Basalthermometer BT-A23 ist empfindlich genug, um subtile Veränderungen der Körpertemperatur mit hoher Genauigkeit von 1/100 zu messen und dauert bei richtiger Verwendung etwa 90 Sekunden, um eine Messung abzuschließen.

HINWEIS: Es ist wichtig, Ihre Temperatur jeden Tag aufzuzeichnen, um Ihren BBT-Trend zu identifizieren.


Wie hilft Ihnen BBT, den Eisprung zu ermitteln? Was müssen Sie wissen?

Ihre BBT-Werte werden wahrscheinlich direkt nach dem Eisprung steigen, mit einer Verschiebung von 0,2°C–0,6°C oder mehr. Die kostenlose Premom-App kann Ihre Leseeingaben automatisch grafisch darstellen und Ihre Coverline zeichnen, ein visuelles Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihre BBT-Verschiebung zu identifizieren. Und mit Premom haben Sie unbegrenzte Messungen in der Cloud.

HINWEIS: Berufen MÜSEN die Temperatur in der Premom-App mit diesem non-Bluetooth Modell manuell eingehen.

Wie hilft Ihnen Premom App?

1. Klicken Sie auf den Button "BBT" auf dem Hauptbildschirm.
2. Wählen Sie "manuell", um Ihre Basalkörpertemperatur aufzuzeichnen.
3. Klicken Sie auf Grad $^{\circ}$ um Ihre aktuelle, numerische Basalkörpertemperatur einzugeben und klicken Sie auf "speichern".

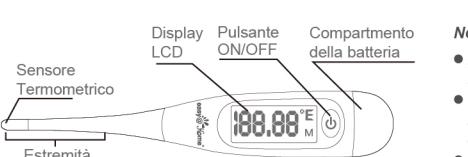

Il Termometro Digitale Basale (BT-A23) è un termometro utilizzato per la misurazione della temperatura basale (o BBT).

Che cos'è la temperatura basale, e perché dovrei utilizzare un termometro basale digitale?

La temperatura basale è la temperatura del corpo umano che si registra in condizioni basali, cioè al momento del risveglio, prima di iniziare qualunque attività. A differenza dei termometri convenzionali, i termometri basali possono essere utili alle donne per individuare i loro giorni più fertili. Il termometro basale digitale BT-A23 è abbastanza sensibile da misurare lievi variazioni della temperatura corporea con un'elevata precisione di 1/100 e impiega circa 90 secondi per completare una lettura se utilizzato correttamente.

Nota: Al fine di monitorare le variazioni della BBT, è di fondamentale importanza eseguire la misurazione della temperatura basale tutti i giorni.


In che modo la misurazione della BBT può aiutarmi a prevedere quando avverrà la prossima ovulazione? Cosa è importante sapere al riguardo?

La temperatura basale incrementa notevolmente dopo l'ovulazione, con variazioni comprese tra 0,2°C e 0,6°C. L'app gratuita Premom genererà per te il grafico delle ovulazioni e la coverline, strumenti visivi molto utili per monitorare le variazioni della tua temperatura basale.

Nota: Gli utenti DEVONO inserire manualmente la temperatura nell'app Premom con questo modello non abilitato Bluetooth.

Come ti aiuta l'app Premom?

1. Toccare il tasto "Registra BBT" presente sulla schermata principale.
2. Scegliete "Manuale" per registrare il vostro BBT.
3. Toccate la zona dei gradi $^{\circ}$ per inserire il vostro attuale BBT numerico e toccate su "Salva".

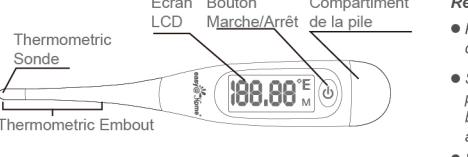

Le thermomètre basal numérique (BT-A23) est utilisé pour la mesure de la température basale du corps (TBC).

Quelle est la température basale corporelle et pourquoi avez-vous besoin d'un thermomètre basal numérique?

La température basale corporelle est votre température lorsque vous êtes complètement au repos. Elle est prise immédiatement au réveil avant toute activité. Contrairement aux thermomètres traditionnels, les thermomètres basaux numériques mesurent avec une précision accrue pour détecter facilement votre période fertile. Le thermomètre basal numérique BT-A23 est suffisamment sensible pour mesurer les changements subtiles de la température corporelle avec une grande précision de 1/100e et prend environ 90 secondes pour terminer une lecture lorsqu'il est utilisé correctement.

Remarque: Il est important d'enregistrer chaque jour votre température pour identifier la tendance de votre TBC.

Comment votre TBC vous aide-t-elle à repérer l'ovulation? Que devez-vous savoir?

La température de votre TBC augmentera très probablement juste après l'ovulation, de 0,2°C à 0,6°C ou plus. L'application gratuite Premom peut automatiquement établir un graphique de vos mesures et tracer votre ligne de couverture, un outil visuel pour vous aider à identifier votre montée de TBC.

Remarque: Les utilisatrices DOIVENT saisir manuellement la température dans l'application Premom avec ce modèle non compatible Bluetooth.

Comment fonctionne l'application 'Premom' Help?

1. Appuyez sur le bouton «Enregistrer la TBC» sur l'écran principal.
2. Choisissez «Manuel» pour enregistrer votre TBC.
3. Appuyez sur le degré $^{\circ}$ pour entrer votre TBC numérique actuel et appuyez sur «Enregistrer».

Note:

- To change the time, tap the current time and scroll to the previous time and press save.
- If you would like to log the temp from a previous day, simply tap the arrow down on the top of the screen, then choose the date and tap "Done".
- If you would like to edit or delete a logged temp, just tap charts on the bottom of the main home screen. Tap "BBT" on the top of that next screen. After you access the table, swipe left and it will show you "Edit" or "Del" to proceed for a given temp.

NOTE: As we are constantly improving and updating the Premom app to offer the best user experience for our customers, the interface may be different from the illustrations included but all features mentioned should be still available and similar.

What's Included:

- Thermometer
- Manual
- Protective case

Operating Instructions

1. Open battery chamber cover, remove the insulation plastic sheet before use.

2. Disinfect the probe before using with 70% ethyl alcohol on a damp cloth.

3. Press the ON/OFF button to switch the device on.

A short beep will sound indicating that the thermometer is operational. Initially, 188.88 (the calibrator number) appears for 2 seconds, followed by your last temperature reading for two seconds; finally, dotted lines will appear. When a flashing "°F" or "°C" is displayed, the thermometer is ready for use.

4. Place the thermometer tip under the tongue and close your mouth.

The thermometer tip should remain in constant contact with the tissue under the tongue, and the mouth should remain closed during measuring. Avoid eating or drinking just before measuring the temperature, as this will result in an inaccurate temperature reading. The average measuring time is about 90 seconds.

Hinweis:

- Um die Zeit zu verändern, klicken Sie auf die aktuelle Zeit, scrollen zur vorherigen Zeit und drücken auf speichern.
- Wenn Sie die Temperatur von einem vorherigen Tag aufzeichnen wollen, klicken Sie einfach auf den Pfeil unten oben auf dem Bildschirm, wählen das Datum aus und klicken "fertig".
- Wenn Sie gerne eine aufgezeichnete Temperatur bearbeiten oder löschen wollen, klicken Sie einfach auf die Tabelle unten auf dem Hauptbildschirm. Klicken Sie "BBT" oben auf dem nächsten Bildschirm. Nachdem Sie Zugang zur Tabelle haben, wischen Sie nach links und es wird "bearbeiten" oder "löschen" anzeigen, um mit der angezeigten Bilder aussehen, aber alle erwähnten Funktionen sollten verfügbar und ähnlich sein.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass das Thermometer nach der Messung so lange im Mund halten, bis das Piepton nachlass (direkt nach dem letzten Piepton aus dem Mund entfernen), damit es richtig speicht. Der Bildschirm leuchtet auf, sobald die Messung abgeschlossen ist.

Wie wechselt man zwischen Celsius und Fahrenheit?

Schalten Sie das Thermometer ein; das Thermometer führt für 2 Sekunden eine Bildschirmkalibrierung durch (im Bild unten gezeigt). Halten Sie den AN/AUS-Schalter während dieses 2-Sekunden-Intervalls für 3 Sekunden erneut gedrückt, um zwischen den Maßeinheiten °F und °C zu wechseln.


Batteriesymbol:

- - - Temperatur liegt unter 89,6°F (32°C).

Hi°F oder Hi°C Temperatur liegt über 109,38°F (42,99°C).

ERR Fehlercode. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.

Die Batterie ist leer.



Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, entfernen Sie die Isolierfolie vor Gebrauch.

2. Desinfizieren Sie die Messsonde vor Gebrauch.


3. Drücken Sie die AN/AUS-Taste, um es anzusehen.

Ein kurzer Piepton zeigt an, dass das Thermometer betriebsbereit ist. Zuerst erscheint 188.88 (die Kalibrationsnummer) für 2 Sekunden, gefolgt von Ihrem letzten Temperaturmesswert für 2 Sekunden und schließlich erscheinen gestrichelte Linien. Wenn ein blinkendes °F oder °C angezeigt wird, ist das Thermometer mit der Ein/AUS-Taste manuell ausschalten.

HINWEIS: Berufen MÜSEN die Temperatur in der Premom-App mit diesem non-Bluetooth Modell manuell eingehen.

Wie hilft Ihnen Premom App?

1. Klicken Sie auf den Button "BBT" auf dem Hauptbildschirm.
2. Wählen Sie "manuell", um Ihre Basalkörpertemperatur aufzuzeichnen.
3. Klicken Sie auf Grad $^{\circ}$ um Ihre aktuelle, numerische Basalkörpertemperatur einzugeben und klicken Sie auf "speichern".



Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, entfernen Sie die Isolierfolie vor Gebrauch.

2. Desinfizieren Sie die Messsonde vor Gebrauch.


3. Drücken Sie die AN/AUS-Taste, um es anzusehen.

Ein kurzer Piepton zeigt an, dass das Thermometer betriebsbereit ist. Zuerst erscheint 188.88 (die Kalibrationsnummer) für 2 Sekunden, gefolgt von Ihrem letzten Temperaturmesswert für 2 Sekunden und schließlich erscheinen gestrichelte Linien. Wenn ein blinkendes °F oder °C angezeigt wird, ist das Thermometer mit der Ein/AUS-Taste manuell ausschalten.

HINWEIS: Berufen MÜSEN die Temperatur in der Premom-App mit diesem non-Bluetooth Modell manuell eingehen.

Wie hilft Ihnen Premom App?

1. Klicken Sie auf den Button "BBT" auf dem Hauptbildschirm.
2. Wählen Sie "manuell", um Ihre Basalkörpertemperatur aufzuzeichnen.
3. Klicken Sie auf Grad $^{\circ}$ um Ihre aktuelle, numerische Basalkörpertemperatur einzugeben und klicken Sie auf "speichern".



Bedienungsanleitung

1. Aprire il coperchio della batteria, rimuovere il foglio di plastica isolante prima dell'uso.

2. Disinfetta l'estremità del termometro prima di ogni utilizzo.

3. Premi il pulsante ON/OFF per accendere il termometro.



Un breve beep indica quando il termometro è operativo. Inizialmente comparirà sullo schermo il numero 188.88 (numero del calibratore) per 2 secondi, seguito dal valore dell'ultima temperatura rilevata (sempre per 2 secondi). Infine compariranno delle linee tratteggiate. Il termometro è pronto per essere utilizzato quando compare il simbolo "°F" o "°C" lampeggiante sullo schermo.

4. Posiziona l'estremità del termometro sotto la lingua e chiudi le labbra.

L'estremità del termometro dovrebbe rimanere costantemente a contatto con il tessuto che si trova sotto la lingua e la bocca dovrebbe rimanere chiusa per tutto il tempo di misurazione. Evitare di bere o mangiare prima dell'uso, in quanto questo potrebbe influenzare l'esito del test. Il tempo medio di misurazione è di circa 9

Termómetro Basal Digital BT-A23

Manual de Usuario

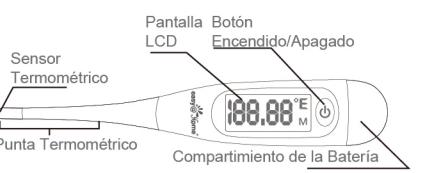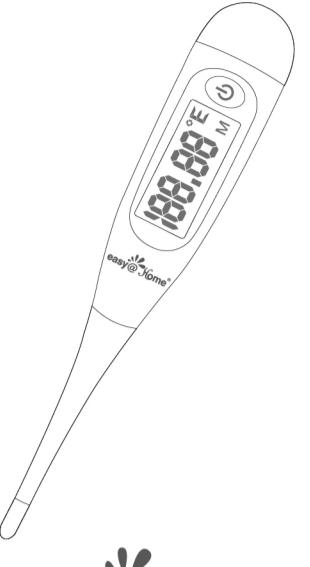

El Termómetro Basal Digital (BT-A23) es utilizado para la medición de la Temperatura Basal Corporal (TBC).

¿Qué es la temperatura basal corporal y por qué necesitas un termómetro basal digital?

La temperatura basal corporal es tu temperatura cuando estás completamente en descanso. Es tomada inmediatamente al despertar antes de cualquier actividad. A diferencia de los termómetros tradicionales, los termómetros basales corporales pueden medir con mayor precisión para detectar fácilmente tu ventana de fertilidad. El termómetro basal digital BT-A23 es lo suficientemente sensible como para medir cambios sutiles en la temperatura corporal con alta precisión de 1/100 y tarda unos 90 segundos en finalizar una lectura cuando se usa correctamente.

Nota: Es importante grabar tu temperatura todos los días para identificar la evolución de tu TBC.


¿Cómo tu TBC te ayuda a establecer tu ovulación? ¿Qué necesitas saber?

Las temperaturas de TBC aumentaran justo después de la ovulación con un 0,2°C-0,6°C o más cambios. La App gratuita Premom puede automáticamente graficar las lecturas de tus entradas y dibujar tu línea de cumbre una herramienta visual que te ayudará a visualizar los cambios de temperatura.

Nota: Los usuarios DEBEN ingresar manualmente la temperatura en la aplicación Premom con este modelo habilitado para Bluetooth.

¿Cómo te puede ayudar la aplicación de Premom?

1. Haz click en el botón "Guardar la TBC" de la pantalla principal.
2. Escoge "manual" para introducir tu TBC.
3. Haz click en la zona de los grados $^{\circ}\text{F}$ para introducir tu TBC numérico actual y después, pulsa en "guardar".

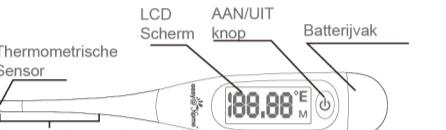

De Digitale Basale Thermometer (BT-A23) wordt gebruikt voor het meten van de basale lichaamstemperatuur (BBT).

Wat is de basale lichaamstemperatuur en waarom gebruik je daar voor een digitale basale thermometer?

Basale lichaamstemperatuur is de temperatuur wanneer je aan het rusten bent. Het begint onmiddellijk met het meten na het ontwaken en voor elke activiteit. Vergelijken met traditionele thermometers, kunnen basale lichaamstemperaturen met grotere nauwkeurigheid meten om uw vruchtbaarheidspériode gemakkelijk te detecteren. De BT-A23 digitale basaalthermometer is gevengen om subtiele veranderingen in lichaamstemperatuur te meten met een hoge precisie van 1/100s en duurt bij correct gebruik ongeveer 90 seconden om een meting te voltooien.

Opmerking: Voor het identificeren van uw BBT-trend is het belangrijk om elke dag uw temperatuur te meten.

Hoe helpt uw BBT bij het bepalen van de ovulatie? Wat wilt u weten?

Uw BBT-temperaturen zullen waarschijnlijk direct na de ovulatie stijgen, met een verandering van 0,2°C - 0,6°C of meer. De gratis Premom App kan automatisch de gemeten gegevens en uw progresieve kaart brengen, een visueel hulpmiddel om u te helpen uw BBT-verandering te identificeren. En met Premom heeft u onbeperkte metingen in een cloud.

Opmerking: gebruikers MOETEN handmatig de temperatuur invullen in de Premom-app.

Hoe kan De Premom App u Helpen?

1. Druk op de knop "Log BBT" op het hoofdscherm.
2. Kies "Handmatig" om uw BBT te loggen.
3. Druk op de graden $^{\circ}\text{C}$ gebied om uw huidige numerieke BBT in te vullen en druk op "Opslaan".

Notas:

- Para cambiar la hora, haz click en la hora actual y desliza hasta alcanzar la hora anterior, después haz click en guardar.
- En caso de que quieras guardar la temperatura de un día anterior, simplemente haz click en la flecha hacia abajo □ de la parte superior de la pantalla, luego selecciona la fecha y haz click en "hecho".
- En caso de quieras editar o borrar una temperatura que ya hayas introducido, simplemente haz click en gráficos en la parte inferior de la pantalla inicial. Luego pulsa "TBC" en la parte superior de la siguiente pantalla. Una vez hecho esto, y cuando hayas accedido a la tabla, desliza la pantalla hacia la izquierda y aparecerá la opción de "Editar" o "Eliminar" una temperatura concreta.

Nota: Como parte de nuestra actividad constante de mejorar de la aplicación Premom para que ésta sea más fácil de manejar para el usuario, es posible que la interfaz gráfica sea distinta de las imágenes que se han incluido; sin embargo, todas las funciones descritas seguirán siendo las mismas y estarán disponibles.

Preguntas y Lineamientos

1. Antes del uso haga el favor de abrir la tapa de batería y quitar la lámina de plástico aislante.

2. Desinfecte la sonda antes de usar.

3. Presione el botón de Encendido/Apagado para encender.

Sonará un pequeño tono indicando que el termómetro está operacional. Inicialmente 188,88 (el número del calibrador) aparece por 2 segundos, seguido por tu última lectura de temperatura por dos segundos; finalmente, aparecerán líneas de puntos. Cuando se visualiza una "F" o una "C" intermitente, el termómetro está listo para usarse.

4. Coloque la punta del termómetro debajo de la lengua y cierra la boca.

La punta del termómetro debería permanecer en constante contacto con el tejido debajo de la lengua, y la boca debería permanecer cerrada durante la medición. Evite comer o tomar justo antes de la medición de la temperatura, ya que esto resultará en una lectura de temperatura imprecisa. El tiempo medio de medición es de unos 90 segundos.

Opmerking:

● Om de tijd te wijzigen, tik je op de huidige tijd, ga je naar de vorige tijd en druk je op Opslaan.

● Als je de temperatuur van een vorige dag wilt loggen, tik je gewoon op de pijl □ bovenaan het scherm, kies je de datum en tik je op "Klaar".

● Als u een gelagde temperatuur wilt bewerken of verwijderen, tik u gewoon op grafeiken onderaan het hoofdscherm. Druk op "BBT" bovenaan het volgende scherm. Nadat je de tabel hebt geopend, wordt automatisch uitgeschakeld na 3 minuten nadat de meting is voltooid of u kunt de thermometer handmatig uitschakelen met de AAN/UIT-knop.

OPMERKING: aangezien we de Premom app voortdurend aan het verbeteren en updaten zijn om zo de beste gebruikservaring voor onze klanten te bieden, kan de interface verschillen van de opgegeven illustraties, maar alle genoemde functies moeten beschikbaar en vergelijkbaar zijn.

Wat is ingebrepen:

- Thermometer
- Handeling
- Beschermende hoes

Bedieningsaanwijzingen

1. Open het deksel van het batterijvak, verwijder voor gebruik de isolerende plastic folie.

2. Desinfecteer de sonde voor gebruik.

3. Druk op de AAN / UIT-knop om het in te schakelen.

Er klinkt een korte piepton om aan te geven dat de thermometer werkt. Aanvankelijk verschijnt 188,88 (het kalibratienummer) voor 2 seconden, gevolgd door uw laatste temperatuurmeting voor twee seconden; tot slot verschijnen er stippenlijnen. Wanneer een knipperrende "F" of "C" wordt weergegeven, is de thermometer klaar voor gebruik.

4. Plaats de thermometerpunt onder de tong en sluit uw mond.

De punt van de thermometer moet constant in contact blijven met het weefsel onder de tong en de mond moet tijdens het meten gesloten blijven. Vermijd eten of drinken vlak voor de temperatuur meet, omdat dit resulteert in uw laatste temperatuurmeting voor twee seconden; tot slot verschijnen er stippenlijnen. Wanneer een knipperrende "F" of "C" wordt weergegeven, is de thermometer klaar voor gebruik.

5. Twee opeenvolgende pieptonen geven aan dat de meting is voltooid.

Cok stopt het symbool "F" of "C" met knipperen wanneer de meting is voltooid. De hoogte gemeten temperatuur van de meting zal op het LCD scherm verschijnen. De weergegeven temperatuur kan licht stijgen als de meting doorgaat na de piepton. Als de meting hoger is dan 100 °F (37,8 °C), zal de piepton 2 keer klinken met een sneller soortgevergelijkaardig om koarts te geven. De thermometer wordt automatisch uitgeschakeld na 3 minuten nadat de meting is voltooid of u kunt de thermometer handmatig uitschakelen met de AAN/UIT-knop.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de thermometer in uw mond houdt totdat het piepen afneemt (direct na de laatste piepton uit de mond verwijden) na de meting, zodat het de gegevens goed opslaat. Het scherm wordt verlicht zodra de meting is voltooid.

Hoe schakelt u tussen Celsius en Fahrenheit?

Zet de thermometer aan; de thermometer zal gedurende 2 seconden een schemakalibratieproces uitvoeren (zie onderstaande afbeelding). Druk gedurende dit interval van 2 seconden gedurende 3 seconden opnieuw op de AAN/UIT-knop om de meeteenheid te wisselen tussen °F en °C.

Geheugen Oproepen

Tervrij de thermometer is uitgeschakeld, houdt u de AAN/UIT-knop ongeveer 4 seconden ingedrukt om de Geheugenoproepmodus te activeren. Druk kort op de AAN/UIT-knop om door elke opgeslagen meting te bladeren, te beginnen bij de meest recente. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om ongewenste records over te slaan. Nadat u de oudste geregistreerde meting hebt bereikt - of als u gedurende 8 seconden geen enkele knop indrukt - verlaat de thermometer de geheugenoproepmodus. Geheugen kan tot 30 metingen oproepen.

Reiniging en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.

Verpakking en Ontsmetting

De thermometer kan het beste worden gereinigd door een ontsmettingsmiddel (bv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek aan te brengen. Dompel de thermometer niet onder in water of een andere vloeistof. Reinig het nooit met verdunners, benzine of benzene.