

Merci d'avoir acheté le thermomètre de haute précision avec Bluetooth de BIOS Diagnostics^{MC}. Afin de tirer pleinement profit de tous les avantages offerts par ce produit, veuillez vous familiariser avec ce mode d'emploi avant d'utiliser le thermomètre pour la première fois. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr à des fins de référence future.

INDICATIONS POUR L'UTILISATION :

Ce thermomètre numérique (modèle 239DI) est destiné à mesurer la température du corps humain en mode régulier, par voie orale, rectale ou axillaire (sous le bras). Cet appareil réutilisable a été conçu pour un usage clinique ou domestique par des personnes de tous âges.

INFORMATION DE SÉCURITÉ :

- Une fièvre élevée et prolongée nécessite des soins médicaux, en particulier pour les jeunes enfants. Veuillez contacter votre médecin si une fièvre élevée et prolongée se présente.
- Ce thermomètre comprend de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne pas laisser les enfants prendre leur propre température sans surveillance.
- Gardez la pile hors de portée des enfants; celle-ci est nocive si ingérée.
- N'ouvrez pas le thermomètre sauf pour remplacer la pile.
- Afin d'éviter des dommages à la sonde, ne pas la plier au-delà d'un angle de 45°.
- L'utilisation d'un couvre-sonde peut entraîner un écart de 0,1 °C (0,2 °F) par rapport à la température réelle.
- **Ne pas** faire bouillir la sonde pour la désinfecter.
- **Ne pas** entreposer le thermomètre sous la lumière directe du soleil ou dans des zones de chaleur extrême.

UNITÉS DE MESURE COMMUTABLES (°C/°F)

Les mesures de température sont disponibles en degrés Celsius ou Fahrenheit (°C/°F situé dans le coin supérieur droit du champ d'affichage). Lorsque l'appareil est hors tension, appuyer sur le bouton On/Off (marche/arrêt) et le maintenir enfoncé pendant environ 3 secondes. L'écran affichera **188.88**, brièvement et émettra un bip. L'écran suivant affichera **LO** et le nouveau symbole (°C ou °F) clignotera, indiquant que le changement d'unité de mesure a été effectué. Vous pouvez maintenant mettre l'appareil hors tension.

BLUETOOTH ET APPLICATION MEDILINK

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation Android et iOS compatibles avec les applications de nos appareils, visiter : biosmedical.com, Apple Store ou Play Store.

VEUILLEZ NOTER: Les mises à jour du système et du logiciel Android et iOS peuvent rendre l'application obsolète sur les appareils plus anciens.

Ce thermomètre et l'application MediLink peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Cependant, vous voudrez jumeler le thermomètre et l'application avant d'utiliser le thermomètre, car il transmettra la lecture à l'application une fois complétée.

1. Pour commencer à utiliser l'application MediLink gratuite, veuillez la télécharger et l'installer dans votre téléphone intelligent ou votre tablette.



2. Activer la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil.
 3. Lancer l'application MediLink. Les nouveaux utilisateurs devront s'inscrire et créer un mot de passe.
 4. À partir de l'onglet « Temperature » (température) de l'application, sélectionner « Add Thermometers » (ajouter des thermomètres) (**figure 1**).
 5. Sélectionner votre appareil à partir de la liste des thermomètres (**figure 2**).
 6. Suivre les instructions affichées à l'écran de votre téléphone pour jumeler l'appareil. Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant « Is this your thermometer? » (est-ce votre thermomètre?). Sélectionnez « Yes » (oui) (**figure 3**).
- *Remarque :** S'assurer que les paramètres Bluetooth sont activés sur votre téléphone avant de tenter le jumelage.
7. L'appareil s'est jumelé avec succès lorsqu'il est possible de voir l'appareil répertorié au bas de l'écran d'accueil de l'application (**figure 4**).



Figure 1



Figure 2



Figure 3

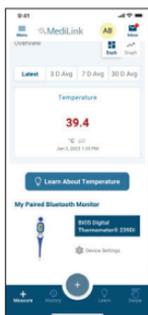


Figure 4

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'application et son utilisation, visitez notre site Web www.biosmedical.com ou appelez notre ligne d'assistance téléphonique BIOS Medical: 1-866-536-2289

COMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE


1. Appuyer sur le bouton « On/Off » marche/arrêt du thermomètre. Il émettra un bip et l'affichage indiquera : **188.88**. Ceci est une vérification fonctionnelle qui indique si l'appareil fonctionne correctement. S'il y a une mesure en mémoire, elle apparaîtra, puis « Lo°C », l'icône Bluetooth et les icônes °C ou °F seront visibles et il est prêt à prendre une mesure.
IMPORTANT : **LO** ne fait pas référence au niveau de la pile.
2. Au moment de prendre une température, le symbole °C/°F clignote tant que la température augmente.
3. Un bip de 10 secondes indiquera que la température maximale a été atteinte.
Remarque : Ce thermomètre de haute précision est programmé avec un temps de mesure de 60 secondes. Cependant le temps de mesure varie et peut augmenter au-delà de 60 secondes selon la méthode utilisée.
4. Pour prolonger la durée de vie de la pile, éteindre le thermomètre après chaque utilisation en appuyant brièvement sur le bouton **On/Off (marche/arrêt)**, sinon l'appareil s'éteindra automatiquement dans environ 10 minutes.

Remarque : L'écran ACL affichera « LO » si la mesure prise est inférieure à 32,0 °C/89,60 °F. Il affichera « HI » si la mesure est supérieure à 42,99 °C/109,38 °F.

Remarque : Lorsque l'écran ACL affiche « ---- », cela signifie que le thermomètre attend la connexion Bluetooth, vous n'avez que 30 secondes pour connecter votre thermomètre, sinon il sautera la connexion Bluetooth et passera à l'écran de mesure de température normal avec un bip.

USAGE PAR VOIE ORALE :

- **Ne pas** boire de liquides chauds ou froids, ne pas faire d'exercice, ne pas fumer et ne pas faire d'autres activités avant une mesure. Ces actions augmenteront ou diminueront la mesure de température par rapport à votre température moyenne normale. La bouche doit rester fermée jusqu'à 5 minutes avant d'effectuer une mesure.
- Bien placer la sonde sous la langue et attendre qu'un bip se fasse entendre. Demandez aux enfants de ne pas mordre la sonde.



USAGE AXILLAIRE :

- Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche.
- Placer la pointe de la sonde dans le creux de l'aisselle et ramener le bras contre le corps et attendre qu'un bip se fasse entendre.

USAGE PAR VOIE RECTALE :

- Cette méthode est couramment utilisée pour la mesure de la température des bébés et des enfants en bas âge ou lorsqu'il est difficile de mesurer la température par voie orale ou sous l'aisselle.
- Lubrifier le thermomètre à l'aide d'un lubrifiant personnel hydrosoluble ou de gelée de pétrole.
- Insérer délicatement la pointe de la sonde de 1,3 cm/0,5 po (maximum) dans le rectum et attendre qu'un bip se fasse entendre.

IMPORTANT : En présence de résistance ne pas forcer la pointe du thermomètre dans le rectum.

QU'EST-CE QUE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE « NORMALE » ?

La température corporelle « normale » varie d'une personne à l'autre et change en fonction de l'heure de la journée et de l'emplacement du corps. Le tableau suivant indique les plages de température :

	Température de fièvre	Plage de températures
Voie rectale*	Plus de 38 °C/100,4 °F	36,6 °C à 38 °C/97,8 °F à 100,4 °F
Voie orale*	Plus de 37,5 °C/99,5 °F	35,5 °C à 37,5 °C/95,9 °F à 99,5 °F
Axillaire (sous l'aisselle)*	Plus de 37,2 °C/99 °F	36,5 °C à 37,2 °C/97,7 °F à 99 °F

* Les définitions de la fièvre proviennent de la Société canadienne de pédiatrie

IMPORTANT : Il est recommandé de mesurer la température corporelle lorsqu'on est en bonne santé afin d'établir la température « normale » spécifique.

RAPPEL DE LA MESURE MÉMORISÉE :

Ce thermomètre possède une mémoire qui rappelle la dernière température prise. Pour obtenir ces informations, thermomètre éteint, appuyer sur le bouton de On/Off (marche/arrêt). L'écran affichera la dernière mesure, qui sera supprimée après la prochaine prise de température.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :

Avant et après chaque utilisation, nettoyer le thermomètre avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux. Désinfecter à l'aide d'une boule de coton humidifiée avec de l'alcool. Ne jamais plonger dans de l'eau chaude ou utiliser des solutions nettoyantes abrasives.

REMPACEMENT DE LA PILE :

Lorsque le symbole  apparaît à l'écran, la pile est à plat et doit être remplacée. À l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis à tête plate, retirer le couvercle du compartiment de la pile situé à l'arrière du thermomètre. Jeter l'ancienne pile et insérer une pile neuve modèle CR2032 de 3 V. Veiller à ce que la pile soit positionnée avec le « + » orienté vers le haut ou vers l'arrière de l'unité. Replacer le couvercle du compartiment à pile.

DÉPANNAGE :

Message d'erreur	Problème	Solution
Lo	La température mesurée est inférieure à 32,00 °C (89,60 °F)	Éteindre le thermomètre, attendre une minute et reprendre une mesure
Hi	La température mesurée est supérieure à 42,99 °C (109,38 °F)	Éteindre le thermomètre, attendre une minute et reprendre une mesure
Err	Le système a un fonctionnement défectueux	Enlever la pile, attendre une minute et remettre sous tension
	La pile est morte	Remplacer la pile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	Thermomètre numérique (non prédictif)
Plage de température :	32 °C à 42,9 °C (89,6 °F à 109,3 °F)
Précision :	±0,05 °C (±0,1 °F) pour des températures de 35,00 °C à 38,00 °C (95,00 °F à 100,40 °F) ±0,1 °C (±0,2 °F) pour des températures <35,00 °C (95,00 °F) ou >38,00 °C (100,40 °F)
Mode d'opération :	Mode direct
Écran :	Affichage à cristaux liquides, 4,5 chiffres
Mémoire :	Mémoire la dernière mesure
Pile :	Une pile bouton 3,0 V CC de type CR2032
Autonomie de la pile :	Huit mois à 3 mesures par jour
Dimensions :	13,4 (L) × 3,1 (l) × 1,6 cm (H) cm
Poids :	Environ 26 grammes avec la pile
Durée de vie utile anticipée	Trois ans
Plage de température ambiante :	Température : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) Humidité relative : 15 % ~95 % HR Pression atmosphérique : 700 hPa ~ 1060 hPa
Conditions de transport et d'entreposage	Température : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) Humidité relative : 15 % ~95 % HR Pression atmosphérique : 700 hPa ~ 1060 hPa
Indice de protection :	IP 27
Classification :	Type BF

 Suivre les instructions d'utilisation. Ce document fournit des informations importantes sur le produit et la sécurité. Veuillez lire ce document soigneusement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence future.

 Type BF pièce appliquée.

 Les piles et les appareils électroniques doivent être éliminés conformément à la réglementation locale applicable, et non avec les rejets ménagers.

IP22 : Protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm de diamètre et plus. Protégé contre les chutes d'eau verticales lorsque l'appareil est incliné jusqu'à 15 °.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) :

Attention : Tout changement et toute modification apportés non expressément approuvés par la partie responsable pour la conformité pourrait annuler l'autorisation à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement. Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette à ces deux conditions :

- (1) Cet appareil ne peut provoquer des interférences néfastes.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, incluant les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer

une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence. Si cet équipement venait à provoquer des interférences néfastes pour la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous vous conseillons d'essayer de corriger les interférences par les mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien d'expérience en radio/télévision afin d'obtenir de l'aide.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS :

Ce thermomètre de haute précision avec Bluetooth a une garantie limitée de 2 ans contre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale par le propriétaire d'origine. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une altération.

Garantie de satisfaction à 100 %

Si, à tout moment, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de cet appareil, appelez notre ligne d'assistance BIOS Medical et parlez à un représentant du service à la clientèle, qui prendra les dispositions nécessaires pour que l'appareil soit testé ou remplacé à votre entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre thermomètre, appelez **la ligne d'assistance BIOS Medical: 1-866-536-2289**

Si une réparation s'avérait nécessaire, renvoyez l'appareil avec tous les composants. Joignez une preuve d'achat et 5,00 \$ pour les frais d'expédition de retour et l'assurance. Expédiez l'appareil prépayé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

Service des retours
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Veuillez inclure votre nom, votre adresse de retour, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. Thermor Ltd. testera ou remplacera (au choix de Thermor) gratuitement toutes les pièces nécessaires pour corriger le défaut de matériau ou de fabrication.

Veuillez prévoir 10 jours pour l'expédition de retour.



BIOS | Medical
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM